CONELOG®
SYSTEM

Catalogue produits
Système d'implants CONELOG®

Valable à partir de Janvier 2021

biohorizons
camlog

Sommaire

Informations sur le système

Le système d'implants CONELOG® 2

Chirurgie

Planification 16
PROGRESSIVE-LINE Implants et instruments 19
PROGRESSIVE-LINE Flex Instruments 24
PROGRESSIVE-LINE Système Guide 28
SCREW-LINE Implants et instruments 33
SCREW-LINE Système Guide 38
Instruments chirurgicaux 42
Set d'ostéotomie 49
Set ALTApin 53
Vis de fermeture 55
Piliers de cicatrisation 55

Système prothétique

Prise d'empreinte 58
Enregistrement de l'occlusion 59
Fabrication du modèle 59
Piliers provisoires 60
Piliers Esthomic® 60
Prothèses CFAO 62
Bloc titane CFAO 64
Piliers universels 65
Pilier or-plastique 65
Système prothétique Logfit® 66
Système COMFOUR® 67
Système d'ancrage sphérique 71
Système d'ancrage Locator® 72
Restaurations télescopiques 77
Accessoires pour piliers 77
Instruments prothétiques 78
Instruments dentaires 82
Piliers de sélection 83

Articles complémentaires

Implants factices 86
Modèles de démonstration 87
Macro modèles 87
Littérature 88

Informations complémentaires

Aperçu des Indications 90
Gammes d'implants 93
Aperçu du système prothétique 94
Vue d'ensemble des vis 100
Aperçu couple de serrage 104
Materiaux 106

Index

Alphabétique 108
Par numéro d'article 112

Documentation complémentaire 122

Le système d'implants CONELOG®

Le système d'implants CONELOG® est fondé sur des années d'expérience clinique et de techniques de laboratoire. Il s'agit d'un système d'implants agréable à utiliser pour le praticien et dédié à la prothèse.

Tous les produits CONELOG® sont fabriqués selon les techniques les plus récentes. Le système d'implants CONELOG® est continuellement développé par l'équipe de recherche et de développement interne à l'entreprise, en étroite collaboration avec des cliniciens, des universités et des prothésistes : ceci permet au système d'être toujours à la pointe de la technologie.

Les systèmes d'implants CAMLOG® et CONELOG® sont bien documentés sur le plan scientifique. Notamment par des études* consacrées aux paramètres les plus variés, par exemple la surface de l'implant, le moment de l'implantation et/ou de la mise en charge de l'implant, la stabilité primaire et le design de la connexion. Les résultats à long terme enregistrés pour la surface Promote® sont pleinement convaincants.

Les descriptions qui suivent sont insuffisantes pour permettre une utilisation immédiate du système d'implants CONELOG®.

Nous recommandons une initiation au maniement du système d'implants faite par un opérateur expérimenté. L'utilisation des produits CONELOG® est réservée aux dentistes, médecins, chirurgiens et prothésistes dentaires formés pour le système. Des cours et des travaux pratiques correspondants sont proposés par Camlog.

Des erreurs de méthode dans le traitement peuvent entraîner la perte des implants et une forte diminution de la substance osseuse péri-implantaire.

Tous les produits et services Camlog ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Unités d'emballage : sauf indication contraire, chaque emballage contient un produit.

Les images figurant dans le présent document ne servent qu'à des fins d'illustration et peuvent être différents du produit réel.

* Voir « documentation complémentaire » à la page 122

Implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE

Les nouveaux implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE facilitent la mise en oeuvre des concepts thérapeutiques modernes, p. ex. les restaurations ou les mises en charge immédiates, qui exigent une stabilité primaire élevée [1, 2]*.
La géométrie de l'implant est conçue pour développer une stabilité primaire élevée:

- La partie apicale de l'implant est en forme de cone et est autotaraudant ce qui lui permet d'atteindre une excellente stabilité primaire même en cas de faible densité osseuse [1, 2]*.
- Filetage s'étendant jusqu'à l'apex pour un bon ancrage des implantations immédiates [1, 2]*.
- Filetage crestal pour une amélioration de l'assise en cas de hauteurd'os limitée [2]*.

Les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sont disponibles avec la surface Promote® sablée et mordancée à l'acide qui couvre tout le corps de l'implant jusqu'à l'épaulement conique de l'implant mordancé à l'acide (45°). En fonction de la situation clinique, cette finition de surface permet ainsi un positionnement de l'implant en juxta-crestal ou légerement sous-crestal comme un implant Bone Level classique.
Les implants PROGRESSIVE-LINE avec porte implant vissé peuvent être utilisés pour l'implantation guidée.
Les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sont pourvus de la connexion implant-pilier CONELOG® conique de haute précision avec Platform Switching intégré. La restauration prothétique est réalisée avec des piliers CONELOG®.

CONELOG® PROGRESSIVE-LINE
Implant Promote® plus

* Voir « documentation complémentaire » à la page 122

Diamètres de l'implant

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Longueurs de l'implant

7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm

CONELOG® SCREW-LINE
Implant Promote® plus

Implants CONELOG® SCREW-LINE

Les implants CONELOG® SCREW-LINE sont des implants légèrement coniques vissés et autotaraudants. La forme des implants permet une insertion facile par autocentrage avec un contact continu à l'os offrant ainsi une stabilité primaire importante.
Les implants CONELOG® sont disponibles avec la surface Promote® sablée et mordancée à l'acide jusqu'à l'épaulement conique de l'implant à 45° mordancé à l'acide et offrent ainsi une flexibilité maximale lors de la détermination de la position verticale de l'implant.
L'arrondi optimal de la géométrie apicale garantit la préservation de l'os lors de la pose des implants CONELOG® SCREW-LINE, même à proximité du sinus maxillaire.

Les implants SCREW-LINE avec porte implant vissé peuvent être utilisés pour l'implantation guidée.

Les implants CONELOG® SCREW-LINE sont pourvus de la connexion implant-pilier conique de haute précision avec Platform Switching intégré. La restauration prothétique est réalisée avec des piliers CONELOG®.

Diamètres de l'implant

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Longueurs de l'implant

7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm

Tous les implants CONELOG® sont conditionnés en emballage stérile et et sont prémontés sur un pilier d'insertion avec un code couleur correspondant à leur diamètre.

Connexion implant-pilier CONELOG®

La géométrie de la connexion implant-pilier CONELOG® permet un Platform Switching intégré et convainc par un excellent retour tactile lors de la mise en place du pilier. L'indexation via les trois rainures/cames permet une légère rotation du pilier jusqu'à ce que les cames s'enclenchent nettement dans les rainures de l'implant, indiquant que le pilier a atteint sa position définitive. Ceci garantit une orientation simple, rapide et sûre dans l'axe longitudinal de l'implant. La connexion conique précise, minimise les micromouvements et montre une stabilité supérieure par rapport aux autres connexions coniques [3, 4]*.

* Voir « documentation complémentaire » à la page 122

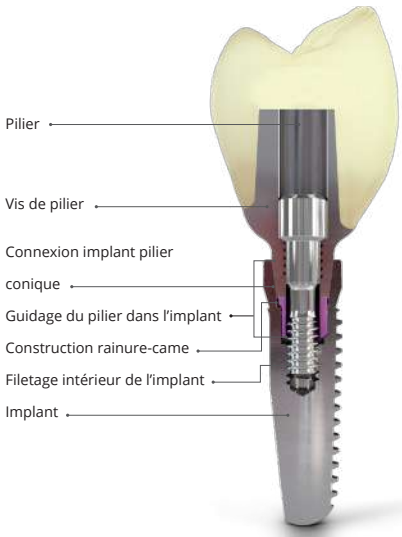

Avantages et bénéfices de la connexion CONELOG®

- Positionnement facile, rapide et précis du pilier avec retour tactile nettement perceptible
- Connexion implant-pilier conique précise montrant une stabilité supérieure par rapport aux autres connexions coniques
- Platform Switching intégré

Pour un positionnement optimal du pilier, l'implant doit être orienté dans l'os de telle sorte que l'une des trois rainures soit placée du côté vestibulaire. Les instruments de pose des implants CONELOG® sont pourvus de repères correspondant aux trois rainures de la configuration interne de l'implant.

Surface Promote®

Les implants CONELOG® sont disponibles avec la surface Promote® sablée et mordancée à l'acide. La surface correspond aux résultats les plus récents de la recherche scientifique et favorise une ostéointégration rapide. Les résultats scientifiques établis à partir d'études de cultures cellulaires, de l'histologie osseuse et des essais de dèvissage le soulignent de façon saisissante.

Précision de fabrication

Les formes intérieures et extérieures des implants et des piliers CONELOG® sont en grande partie usinées par tournage. Les tolérances peuvent ainsi être limitées au minimum. Il en résulte une exceptionnelle précision d'ajustage des pièces, sans altération de la structure des matériaux. La connexion implant-pilier CONELOG® assure ainsi une connexion très précise, stable et anti-rotationnelle des composants prothétiques.

Composants prothétiques CONELOG®

Les implants CONELOG® sont compatibles avec une vaste gamme de composants prothétiques polyvalents, adaptés aux conditions anatomiques. Les piliers CONELOG® portent un code couleur correspondant au diamètre de l'implant.

Effet de la conception Platform Switching

Le système d'implant CONELOG® présente une fonction Platform Switching intégrée dans la mesure où l'épaulement d'implant n'est pas recouvert par le pilier de cicatrisation et le pilier prothétique. La fonction Platform Switching permet de soutenir les tissus durs et mous dans les zones esthétiques péri-implantaires. La distance entre l'interface implant-pilier et la crête osseuse alvéolaire est agrandie et l'impact d'une infiltration de cellules inflammatoires doublée d'une résorption osseuse est réduit.

Piliers de cicatrisation CONELOG®

Les piliers de cicatrisation CONELOG® reposent sur l'épaulement d'implant usiné, mais ne le recouvrent pas entièrement. Par conséquent, les tissus mous peuvent venir s'adapter par-dessus l'épaulement. Les surfaces coniques n'entrent pas en contact avec.

Les piliers de cicatrisation sont utilisés en fonction de l'indication pour les procédures à une ou deux phases. Les piliers de cicatrisation sont proposés avec trois géométries (cylindrique, evasées et bottleneck) et sont vissés directement dans l'implant.

Prise d'empreinte CONELOG®

La prise d'empreinte de l'implant CONELOG® peut être réalisée avec des piliers de prise d'empreinte, avec un porte-empreinte ouvert ou fermé. Tous les composants de prise d'empreinte correspondent au code-couleur du diamètre de l'implant. Les composants ultra-précis garantissent le bon transfert de la situation intra-orale.

Les piliers de prise d'empreinte CONELOG® ne s'imbriquent pas dans le cône de l'implant CONELOG®, mais reposent sur l'épaulement de l'implant. Il est ainsi possible d'éviter le décalage de hauteur lors de la prise d'empreinte. Le système anti-rotationnel repose sur la géométrie cames-rainures CONELOG®.

Piliers provisoires CONELOG®

Les piliers provisoires CONELOG® en alliage de titane existent dans les versions couronne et bridge pour les restaurations provisoires. Les piliers peuvent être utilisés pour une implantation immédiate ou après réouverture du site implantaire.

Base en titane CFAO CONELOG®

Les bases en titane CFAO CONELOG® servent de base de collage pour les restaurations dentaires personnalisées implanto-portées en matériaux appropriés. Les reconstructions sont réalisées à l'aide de techniques de CFAO. Les bases en titane CFAO CONELOG® sont proposées dans les versions couronne et bridge pour les hauteurs gingivales de 0.8 et 2.0 mm.

Piliers CONELOG® Esthomic®

Les piliers à forme anatomique permettent une conception optimale de moignon. Les piliers CONELOG® Esthomic® existent aussi bien droits que angulés dans différentes hauteurs gingivales, avec un épaulement ovale de forme anatomique. Les piliers Esthomic® angulés sont disponibles en versions A et B, lesquelles se distinguent par une disposition des cames déplacée de 60°. De cette manière, six positions de rotation orientées par rapport à la prothèse sont possibles, pour obtenir un axe prothétique optimal.

Orientation des cames du pilier CONELOG® Esthomic®

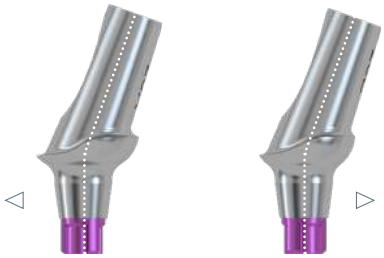

Type A
Orientation des cames à contresens de l'angulation

Type B
Orientation des cames dans le sens de l'angulation



Type A

Type B
Cames orientées à 60°

Pilier or-plastique CONELOG®

Le pilier or-plastique CONELOG® permet de réaliser à l'aide de la technique de surcoulée différentes restaurations implantaires individuelles telles que des couronnes unitaires, des mésostructures pour des bridges scellés, et des piliers primaires permettant de compenser les divergences d'axes d'implant dans les restaurations à coiffes télescopiques.

Piliers CONELOG® Logfit®

Avec le système prothétique CONELOG® Logfit®, on peut réaliser des restaurations sur couronnes et bridges à sceller. Le système prothétique Logfit® comprend des composants préfabriqués et parfaitement adaptés les uns aux autres, permettant de standardiser la procédure clinique et technique. Il en résulte un gain de temps au fauteuil et au laboratoire dentaire.

Piliers universel et télescopique CONELOG®

Les piliers télescopique et universel CONELOG® peuvent être utilisés avec des restaurations de type couronne ou bridge personnalisées à sceller et des restaurations à coiffes télescopiques. Les piliers sont fabriqués en alliage de titane et peuvent être personnalisés par meulage.

Structures à ancrage sphérique CONELOG®, Locator® et sur pilier barre droit

Des structures à ancrage sphérique, Locator® et sur barre droite sont disponibles pour le système d'implant CONELOG®. Elles se distinguent des piliers par différents types de connexion au niveau apical. Les structures à ancrage sphérique, Locator® et sur barre droite sont monoblocs et dotées au niveau apical d'un filetage qui s'engrène dans le filetage interne de l'implant CONELOG®. Ces structures sont vissées sur l'implant CONELOG® avec les instruments de pose d'implant correspondants.

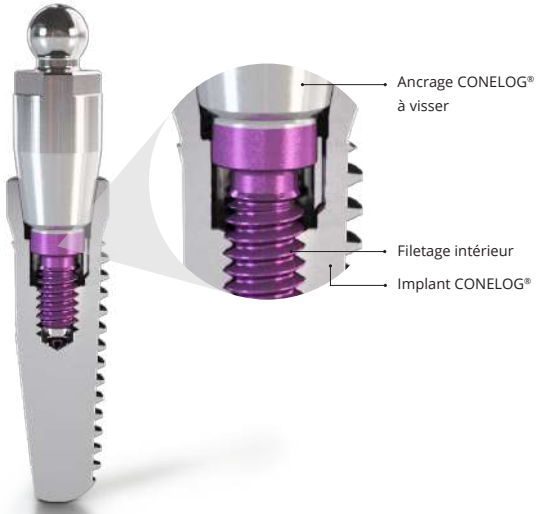

Exemple : Pilier pour ancrage sphérique CONELOG® (Ø 4.3 mm) dans un implant CONELOG® SCREW-LINE

Instrument de retrait CONELOG® pour piliers CONELOG®

Pour faciliter le retrait des piliers CONELOG® des implants CONELOG® ou des analogues de laboratoire, un instrument spécial de retrait CONELOG® est proposé.
La vis de pilier définitive CONELOG® ou la vis de laboratoire est tout d'abord retirée, puis l'instrument de retrait est serré dans le canal de la vis jusqu'à ce que le pilier soit libéré du cône interne de l'implant ou de l'analogue de laboratoire CONELOG®.

Le système COMFOUR®

Les restaurations vissées intègrent des structures de pointe. Le système COMFOUR® est la possibilité pour vos patients édentés d'accéder immédiatement à une restauration confortable et fixe avec quatre ou six implants en général – et par conséquent de gagner nettement en qualité de vie. Pour le praticien, ce nouveau système est également synonyme d'un confort accru et d'une meilleure marge de manoeuvre. COMFOUR® permet d'envisager plusieurs concepts de traitement. Outre les couronnes et bridges vissés occlusaux utilisés dans le cadre d'une mise en charge immédiate ou différée, ce système à option multiple permet aussi la restauration avec structure sur barre droite et angulée. COMFOUR® offre une multitude d'options et vous aide à relever les défis du quotidien plus rapidement. Outre sa diversité, le système prothétique COMFOUR® séduit aussi par son design compact et élégant.
Des lignes épurées caractérisent tous les composants pour les dentistes et prothésistes, le système simplifie grandement la restauration prothétique. Par ailleurs, avec ses nombreuses innovations techniques, COMFOUR® n'est pas seulement un nom, c'est aussi un programme pour utilisateurs et patients.

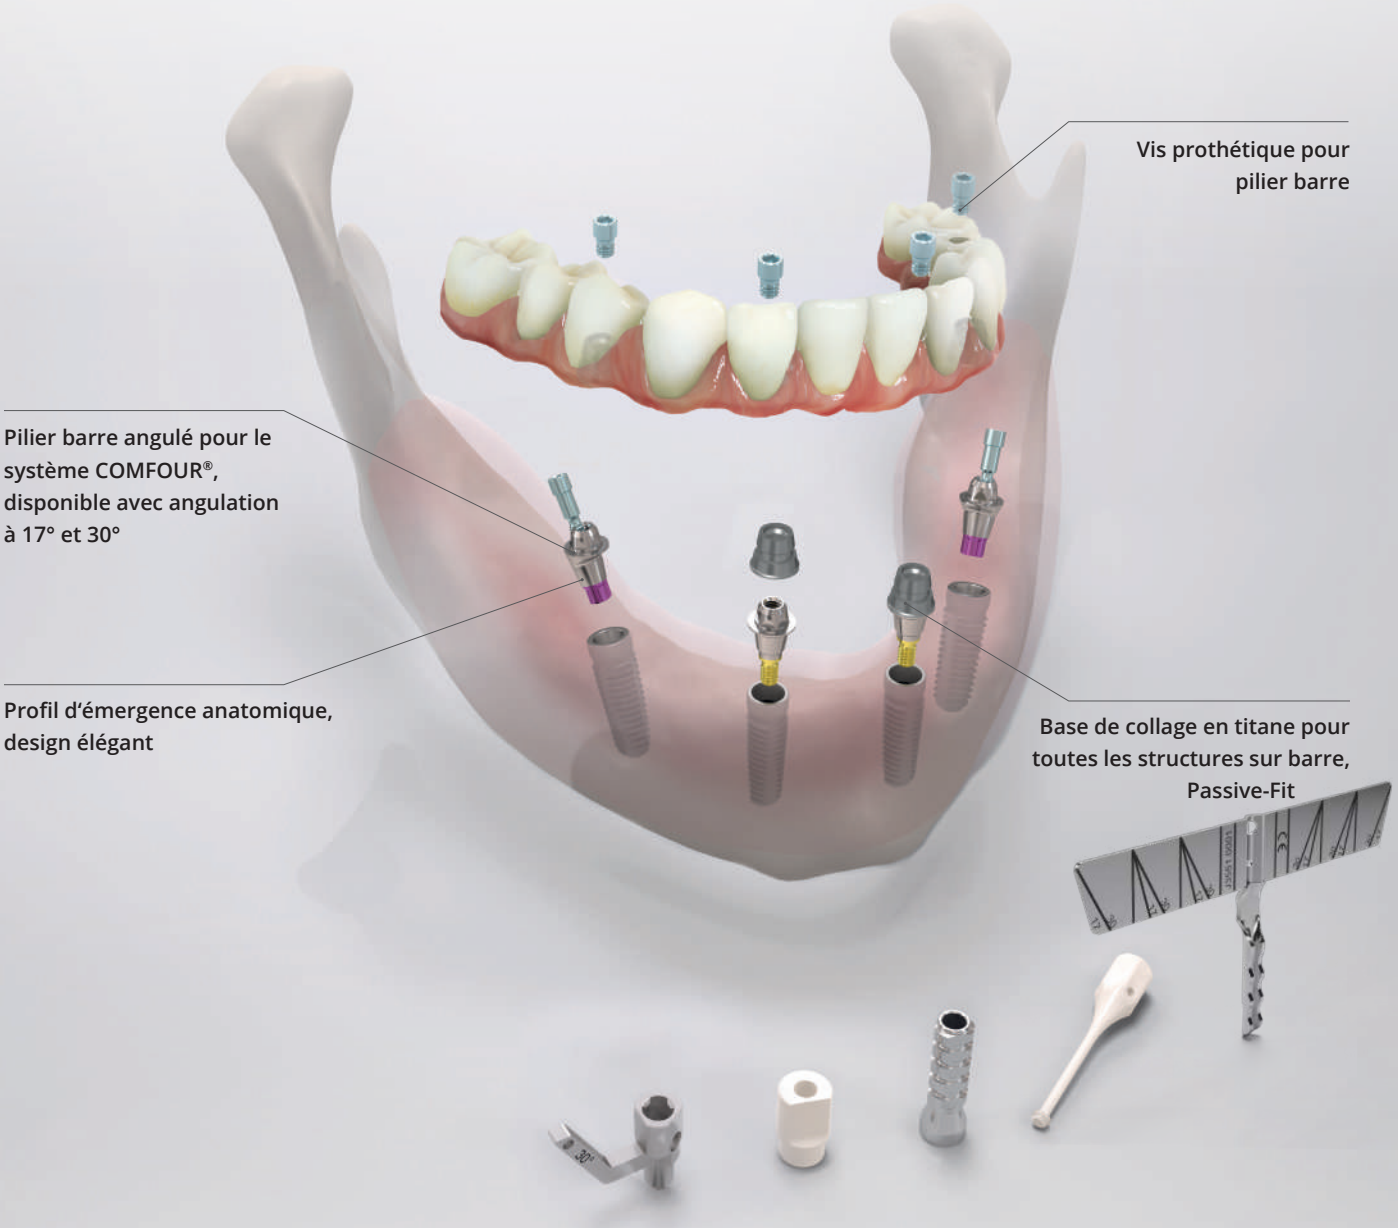

COMFOUR® offre une large gamme d'options pour répondre aux exigences de votre cabinet. Avec simplicité et gain de temps.

Services numériques

DEDICAM® est le partenaire dédié de Camlog à la fabrication de prothèses individuelles réalisées par CFAO, aux services de numérisation et de modélisation, à la planification 3D des implants ainsi qu'à l'impression de guides de forage et de modèles. L'assistance personnalisée avec la compétence habituelle de nos collaborateurs ainsi que les processus optimisés jusque dans les moindres détails garantissent une fiabilité élevée des résultats associée à la plus grande liberté individuelle possible. De nombreuses bibliothèques pour les systèmes de CAO, 3Shape, Exocad et Dental Wings sont disponibles pour les restaurations sur implants.
Découvrez vos possibilités et prenez le départ vers l'avenir numérique avec DEDICAM®.
Les services DEDICAM® ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez-vous adresser à votre représentant local Camlog pour plus d'informations.

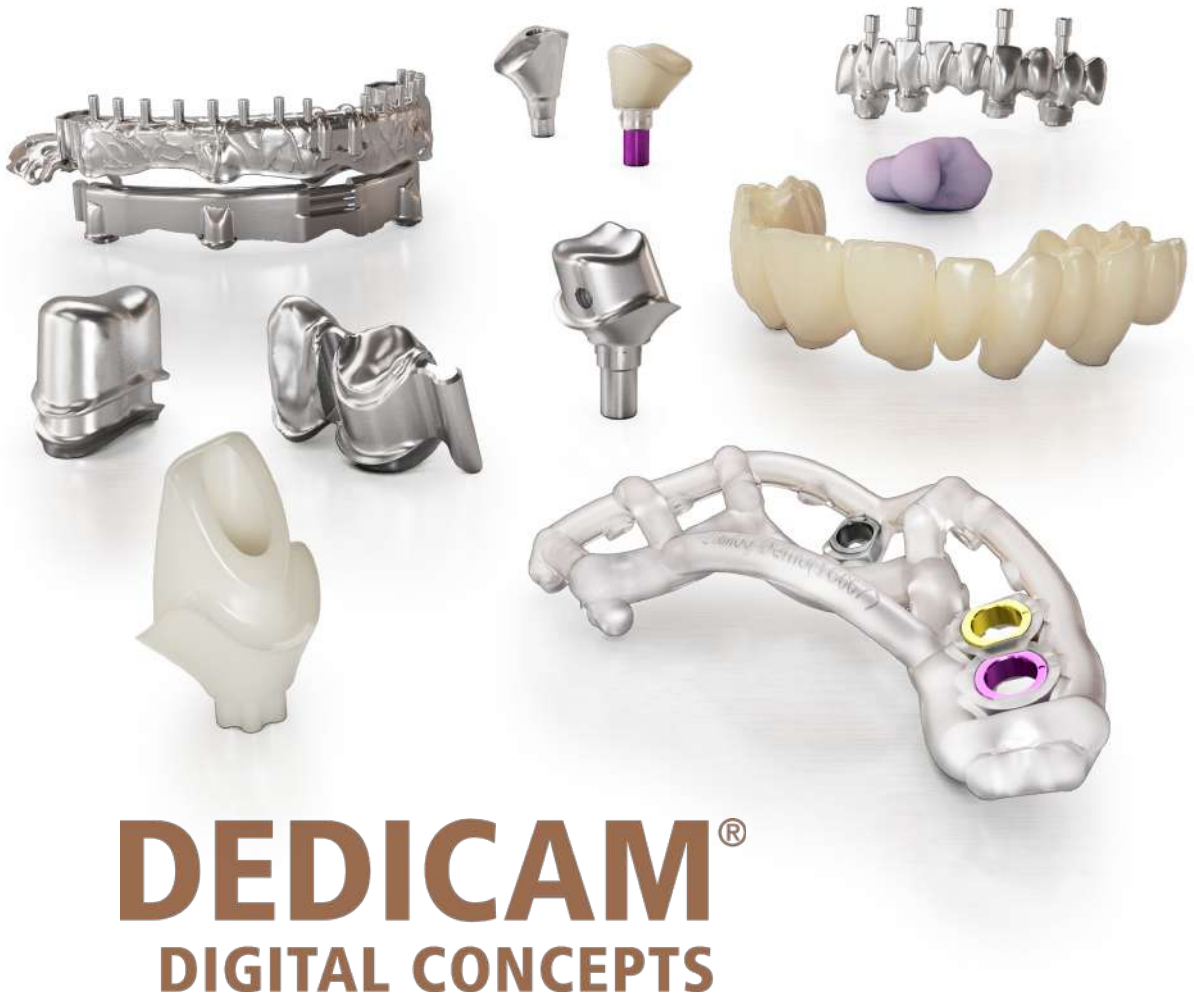

Code couleur des produits chirurgicaux et prothétiques CONELOG®

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Explication des symboles

CE 0123	Marquage CE
	Lire le mode d'emploi
	Attention, respecter les avertissements
MD	Dispositif médical
REF	Numéro d'article
LOT	Désignation du lot
STERILE R	Stérilisé par irradiation
	Barrière stérile simple avec emballage de protection extérieure
NON STERILE	Non stérile
	Date de fabrication
	Date de péremption
STERILIZE	Ne pas restériliser
	Ne pas réutiliser
	Ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé
	Protéger de la lumière du soleil
	Limite de température
	Fabricant
MR	Compatibilité IRM conditionnelle
Rx only	Attention: conformément à la Loi fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu directement qu'à des dentistes qualifiés ou aux personnes mandatées par ceux-ci.

Explication des abréviations

Ø	Diamètre
AØ	Diamètre apical
GØ	Diamètre gingival
PPØ	Diamètre de la plateforme prothétique
L	Longueur
HG	Hauteur gingivale
PEEK	Polyétheréthercéton
POM	Polyoxyméthylène
PPSU	Polyphénylsulfone

Sécurité et mises en garde générales

Les descriptions fournies dans ce catalogue produits sont insuffisantes pour une utilisation immédiate du système d'implants CONELOG®. Nous recommandons une initiation à l'utilisation du système d'implants CONELOG® faite par un opérateur expérimenté.

Emballage des implants PROGRESSIVE-LINE

Emballage secondaire
Scellé, boîte pliante avec étiquette produit à code couleur

Emballage intérieur de l'implant (emballage primaire)
Scellé, codé par couleur

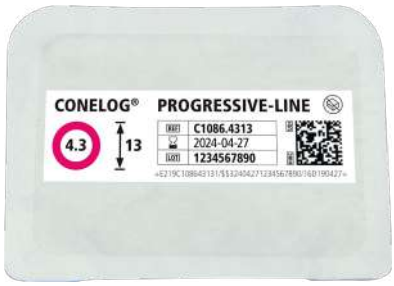

Exemple d'étiquette produit de l'emballage extérieur d'un implant

Emballage des implants SCREW-LINE

Emballage secondaire
Scellé, boîte pliante avec étiquette produit à code couleur

Emballage intérieur de l'implant (emballage primaire)
Scellé, codé par couleur

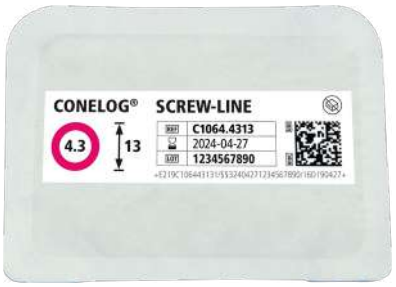

Exemple d'étiquette produit de l'emballage extérieur d'un implant

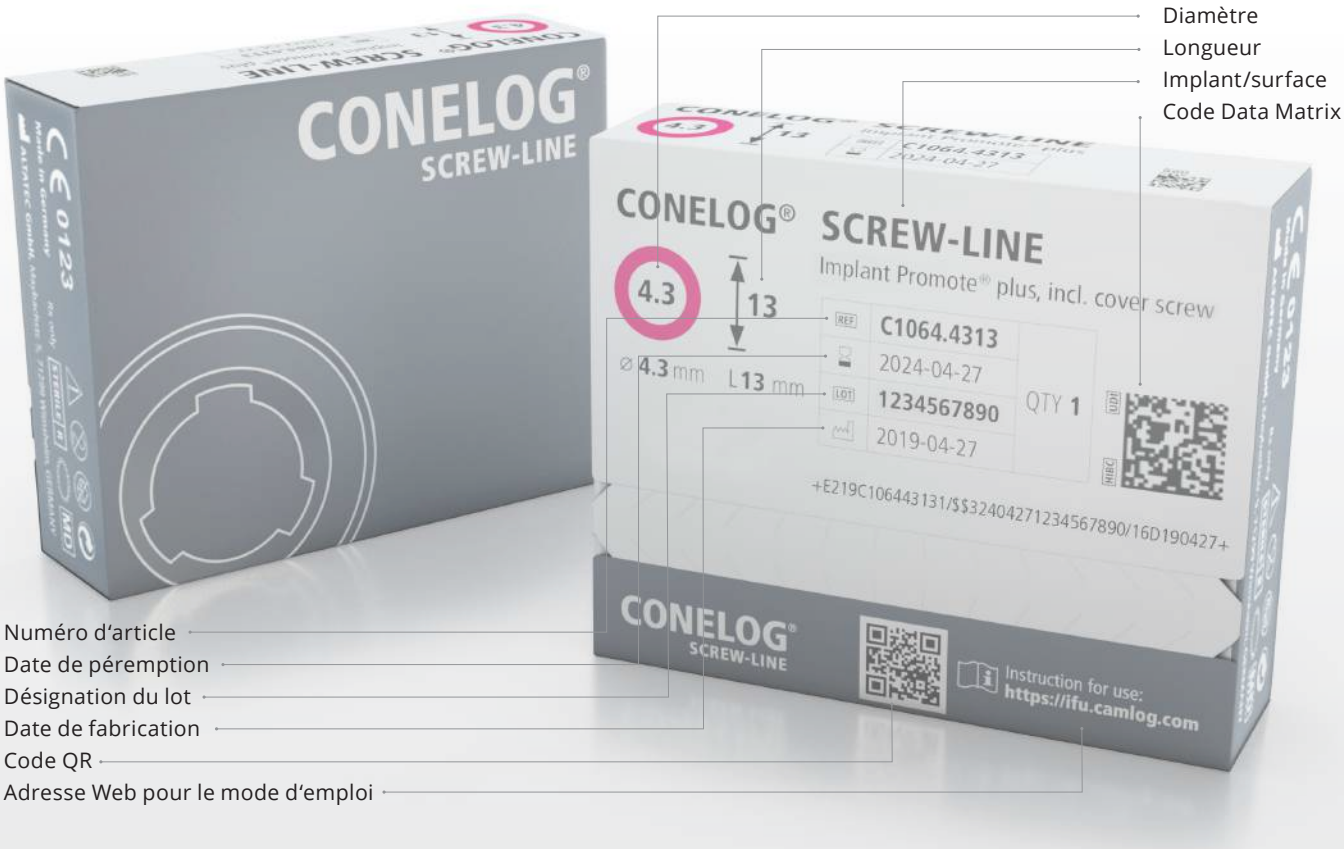

Ø4.3 x 11 SL

Ø4.3 PL

Planification

Grilles de planification radiologique et calques d'implant autocollants

	Article	N° d'article	Ø
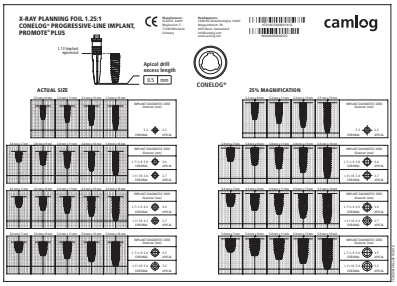	**Grille radio, échelle 1.25:1** **Implants** **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** Grossissement 25%	C5300.9014	-
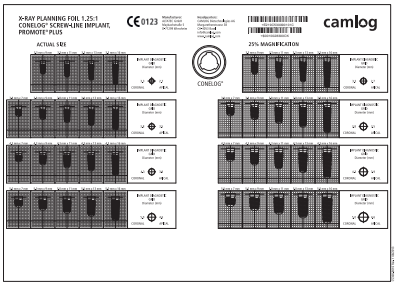	**Grille radio, échelle 1.25:1** **Implants** **CONELOG® SCREW-LINE** Grossissement 25%	C5300.9010	-
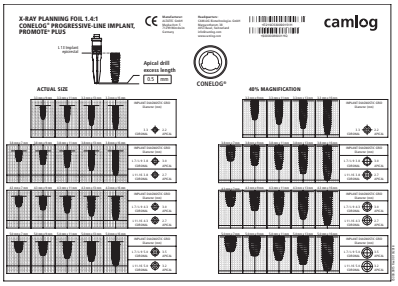	**Grille radio, échelle 1.4:1** **Implants** **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** Grossissement 40 %	C5300.9015	-
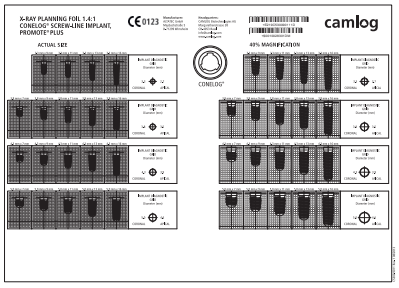	**Grille radio, échelle 1.4:1** **Implants** **CONELOG® SCREW-LINE** Grossissement 40 %	C5300.9011	-
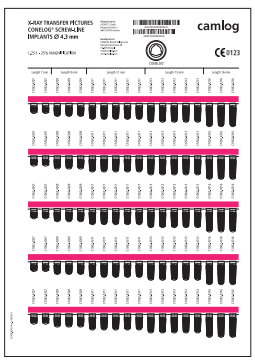	**Calques d'implant 1.25:1** **Implants** **CONELOG® SCREW-LINE** Grilles de planification, autocollantes Grossissement 25 %	C5300.9080	3.3 mm
		C5300.9081	3.8 mm
		C5300.9082	4.3 mm
		C5300.9083	5.0 mm

Planification par tomographie informatisée

pour guides 3D radiographiques et de forage

	Article	N° d'article	L
	Tube pour guide chirurgical pour foret Ø 2.0 mm*, douille de forage cannelée Pack de 10 Diamètre intérieur 2.1 mm Diamètre extérieur 2.5 mm **Matériau** Alliage de titane	A2002.2000	4.0 mm 10.0 mm
	Tube pour guide chirurgical pour foret Ø 2.2 mm, douille de forage cannelée Pack de 10 Diamètre intérieur 2.3 mm Diamètre extérieur 2.7 mm **Matériau** Alliage de titane	A2222.2200	4.0 mm 10.0 mm
	Foret pour mise en place du tube (pour A2002.2000) Ø 2.6 mm **Matériau** Acier inoxydable	A2050.2600	-
	Foret pour mise en place du tube (pour A2222.2200) Ø 2.8 mm **Matériau** Acier inoxydable	A2050.2800	-

* pour foret pilote J5051.2003 et foret pilote SCREW-LINE J5051.2000

PROGRESSIVE-LINE

Implants avec porte implant clipsé

	Article	N° d'article	Ø	L	A Ø
	Implant **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Promote® plus** avec porte implant clipsé et vis de fermeture, stérile **Matériau** Titane Grade 4	C1086.3309	3.3 mm	9 mm	2.2 mm
		C1086.3311		11 mm	
		C1086.3313		13 mm	
		C1086.3316		16 mm	
		C1086.3807	3.8 mm	7 mm	3.0 mm
		C1086.3809		9 mm	
		C1086.3811		11 mm	2.7 mm
		C1086.3813		13 mm	
		C1086.3816		16 mm	
		C1086.4307	4.3 mm	7 mm	3.0 mm
		C1086.4309		9 mm	
		C1086.4311		11 mm	2.7 mm
		C1086.4313		13 mm	
		C1086.4316		16 mm	
		C1086.5007	5.0 mm	7 mm	3.5 mm
		C1086.5009		9 mm	
		C1086.5011		11 mm	3.2 mm
		C1086.5013		13 mm	
		C1086.5016		16 mm	

Implants avec porte implant vissé

	Article	N° d'article	Ø	L	A Ø
	Implant **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Promote® plus** avec porte implant vissé et vis de fermeture, stérile **Matériau** Titane Grade 4	C1085.3309	3.3 mm	9 mm	2.2 mm
		C1085.3311		11 mm	
		C1085.3313		13 mm	
		C1085.3316		16 mm	
		C1085.3807	3.8 mm	7 mm	3.0 mm
		C1085.3809		9 mm	
		C1085.3811		11 mm	2.7 mm
		C1085.3813		13 mm	
		C1085.3816		16 mm	
		C1085.4307	4.3 mm	7 mm	3.0 mm
		C1085.4309		9 mm	
		C1085.4311		11 mm	2.7 mm
		C1085.4313		13 mm	
		C1085.4316		16 mm	
		C1085.5007	5.0 mm	7 mm	3.5 mm
		C1085.5009		9 mm	
		C1085.5011		11 mm	3.2 mm
		C1085.5013		13 mm	
		C1085.5016		16 mm	

PROGRESSIVE-LINE

Set chirugical CAMLOG®/CONELOG®

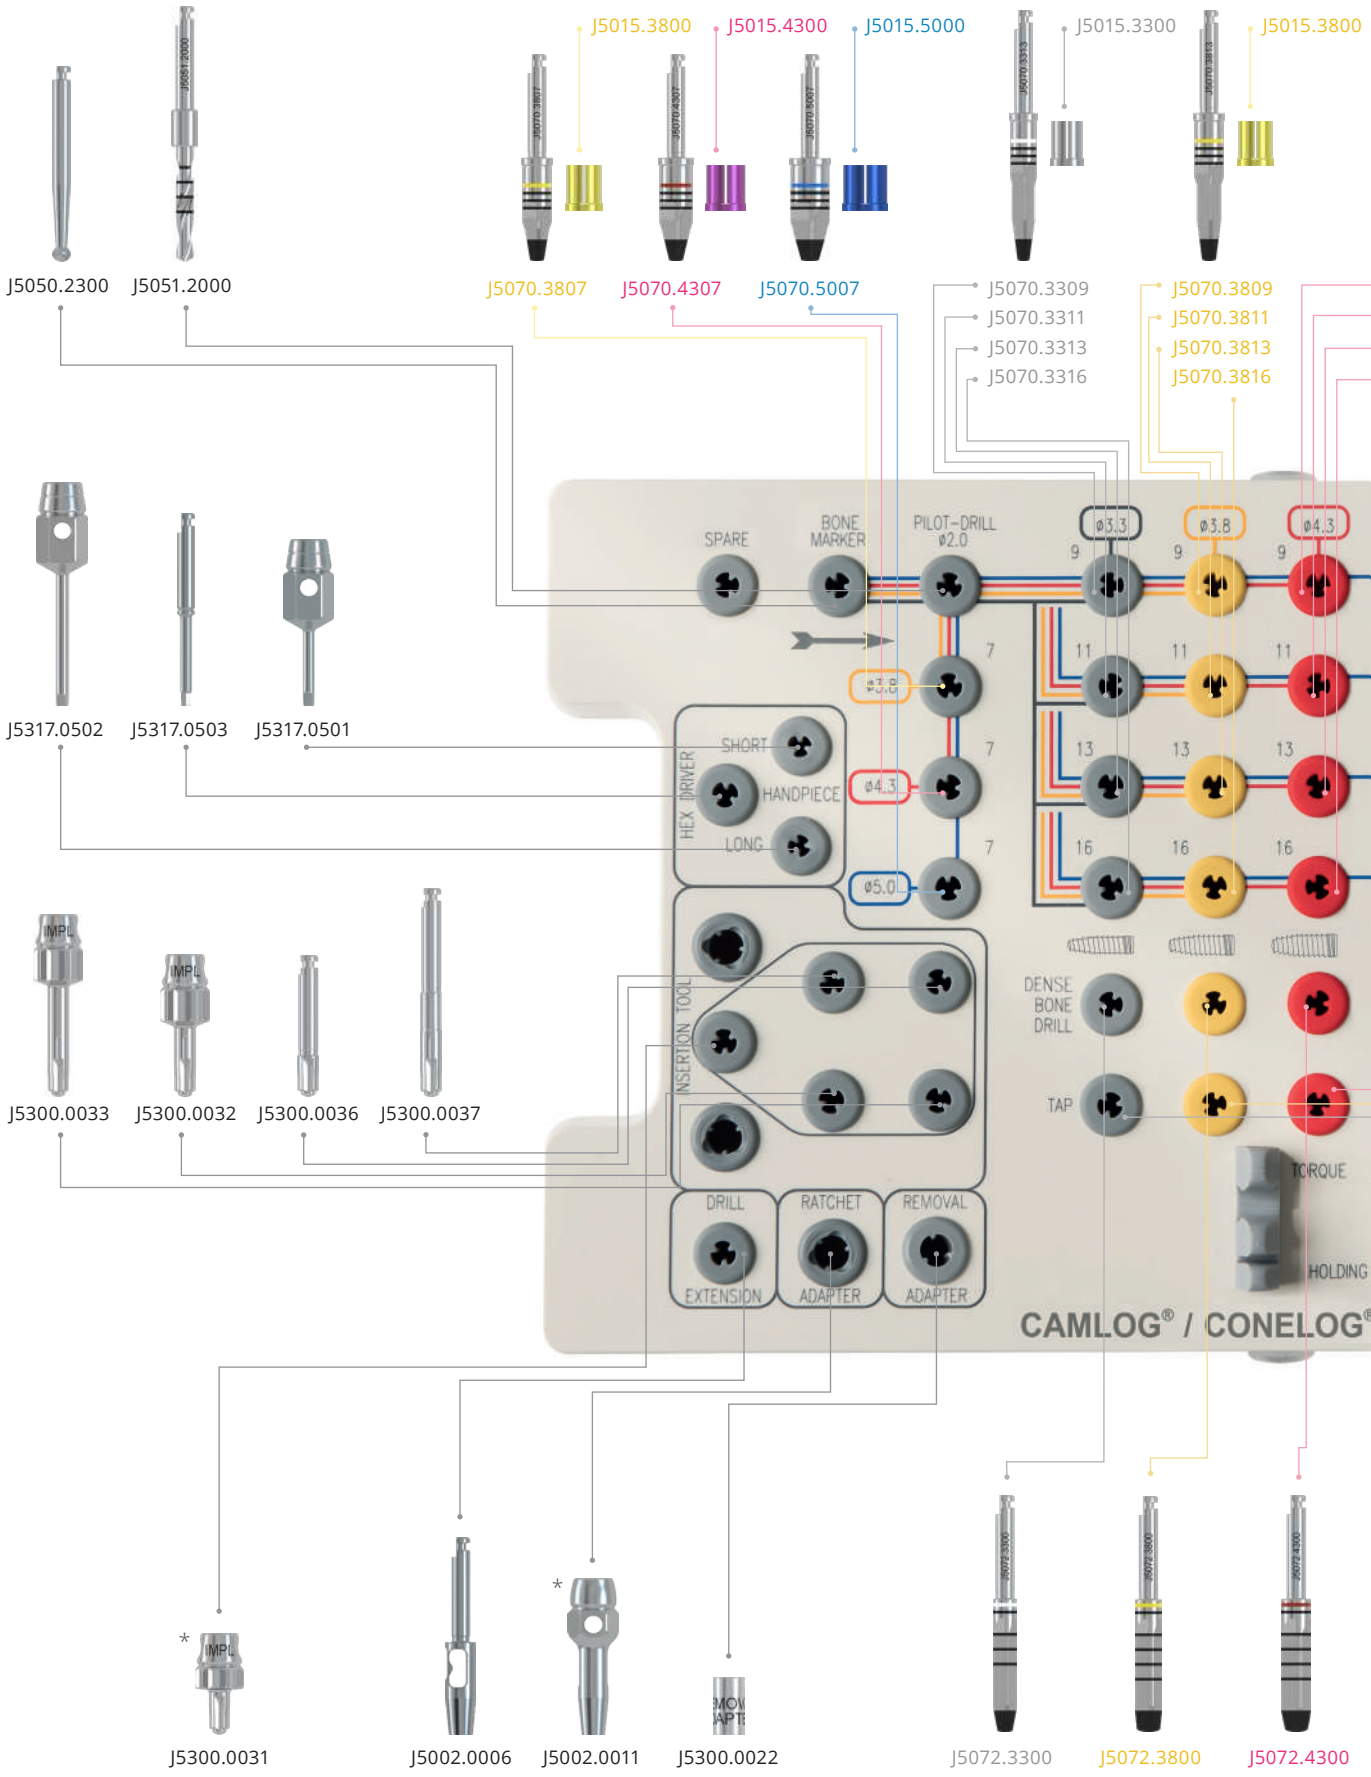

* Ces articles ne sont pas compris dans le set chirurgical et doivent être commandés séparément.

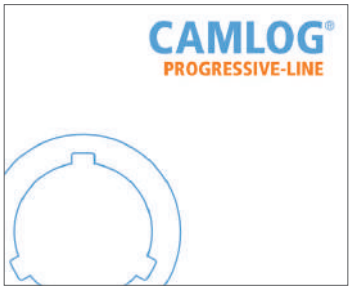

Les forets sont rangés et triés dans le set en fonction de la séquence de traitement. Les lignes de couleur indiquent précisément la séquence de forage.

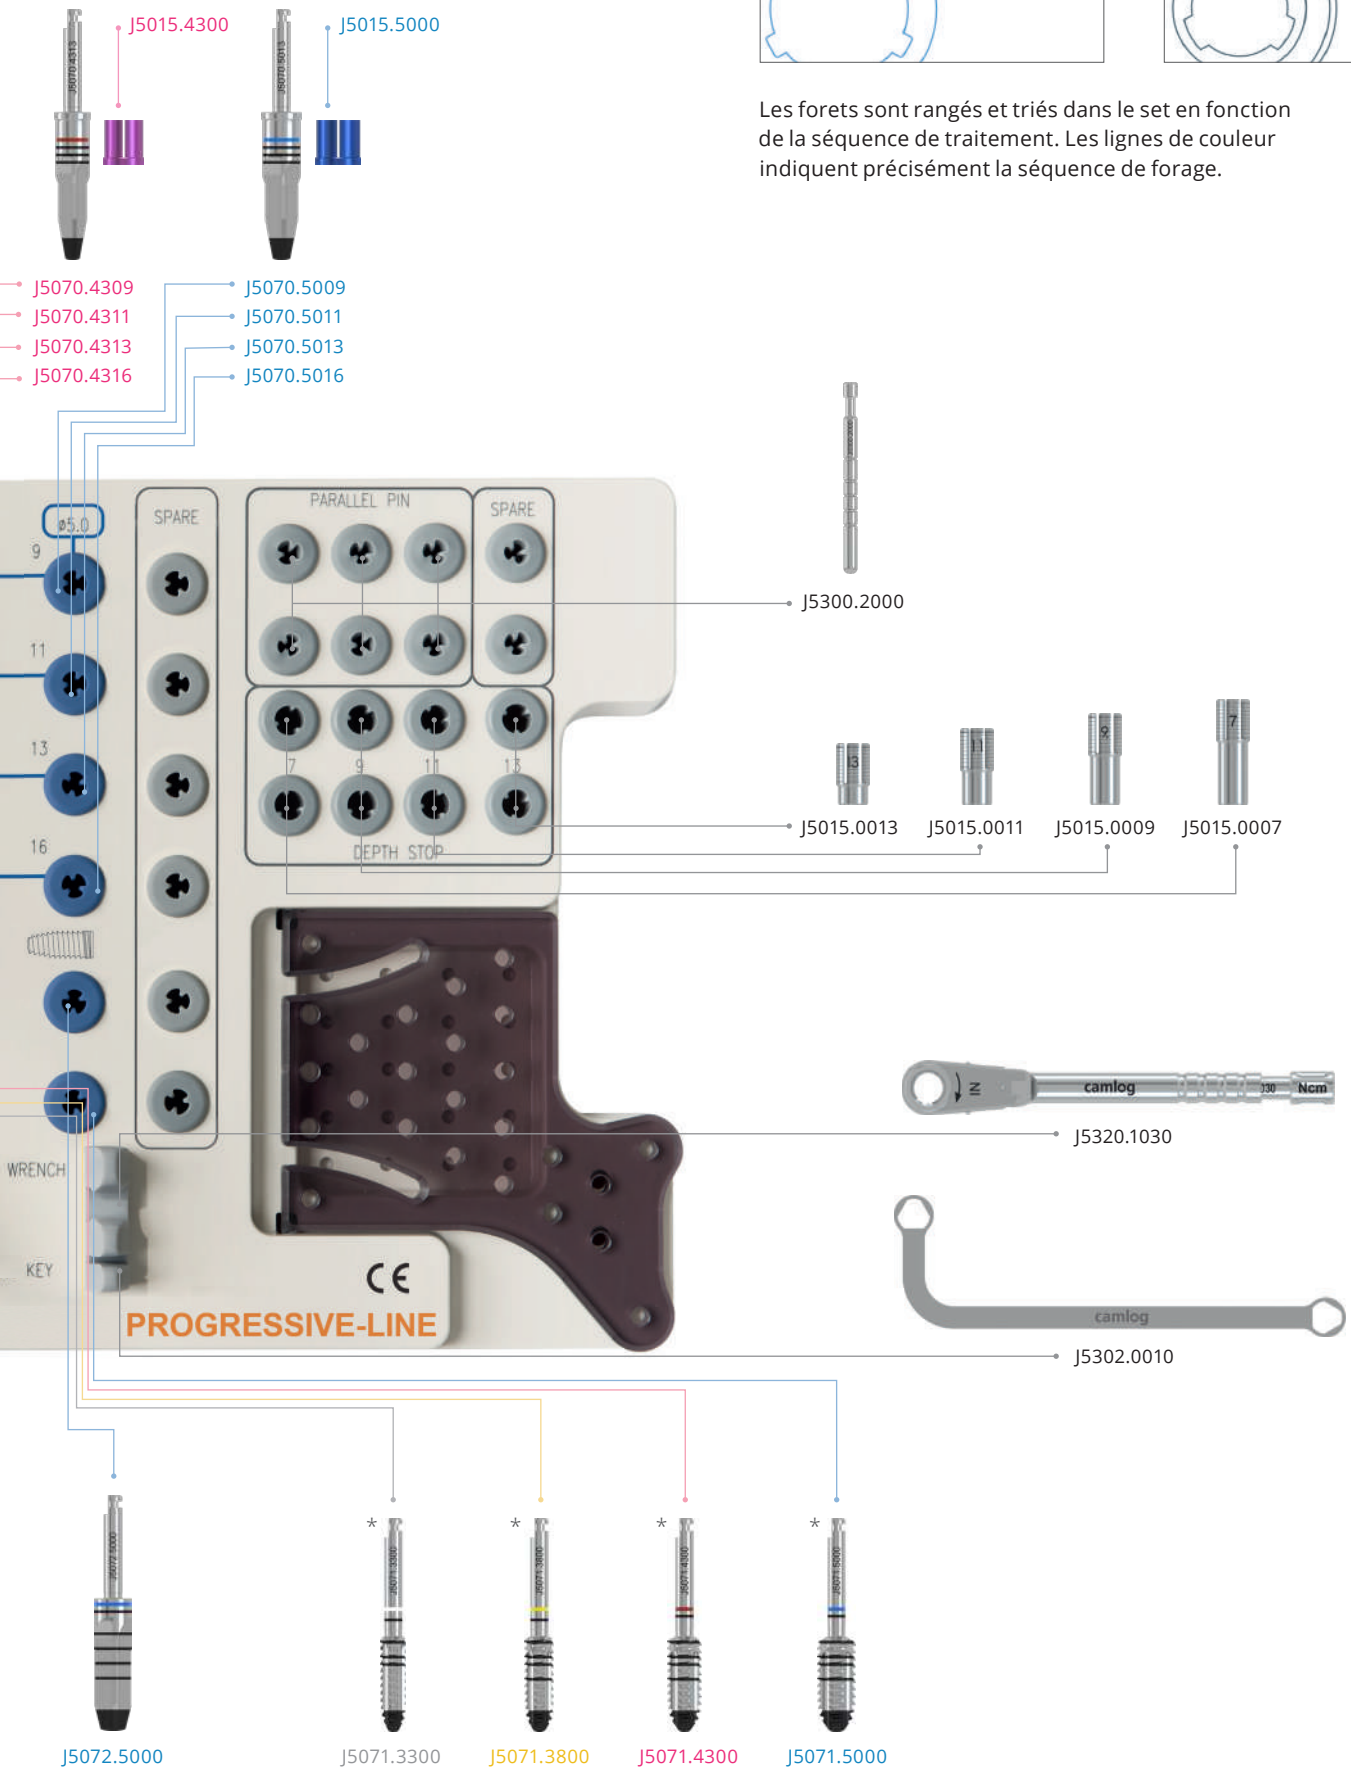

PROGRESSIVE-LINE

Set chirurgical

	Article	N° d'article
	Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE contenant l'ensemble des instruments chirurgicaux nécessaires triés par code couleur, y compris une clé dynamométrique et une clé universelle de contre-couple (les tarauds ne sont pas fournis)	J5300.0065
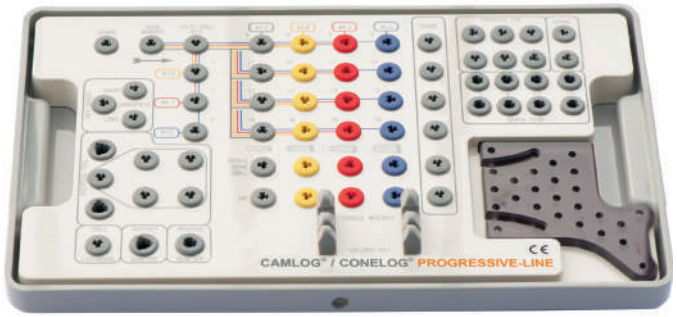	**Trousse chirurgical CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** sans contenu	J5300.8917
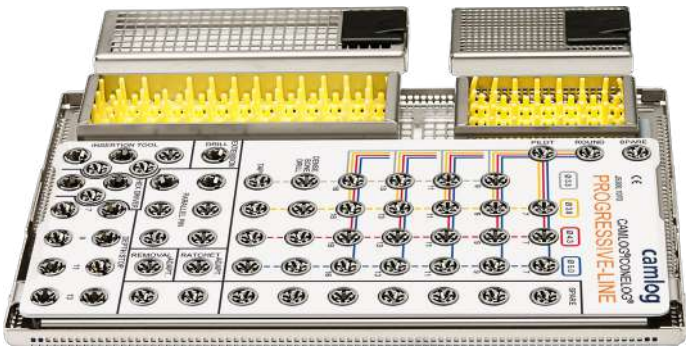	**Trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** pour thermo-désinfection, avec patron, sans contenu	J5300.8970
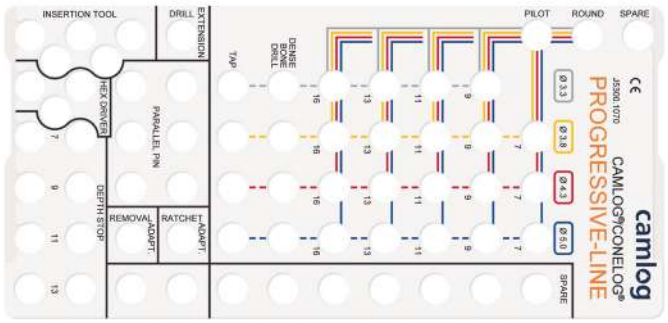	**Patron pour la trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Matériau** PPSU	J5300.1070

La préparation du site implantaire pour les implants CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE et CONELOG® PROGRESSIVE-LINE s'effectue avec les même instruments..

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	Ø	L
	Foret calibré PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5070.3309	3.3 mm	9 mm
		J5070.3311		11 mm
		J5070.3313		13 mm
		J5070.3316		16 mm
		J5070.3807	3.8 mm	7 mm
		J5070.3809		9 mm
		J5070.3811		11 mm
		J5070.3813		13 mm
		J5070.3816		16 mm
		J5070.4307	4.3 mm	7 mm
		J5070.4309		9 mm
		J5070.4311		11 mm
		J5070.4313		13 mm
		J5070.4316		16 mm
		J5070.5007	5.0 mm	7 mm
		J5070.5009		9 mm
		J5070.5011		11 mm
		J5070.5013		13 mm
		J5070.5016		16 mm
	Butée de profondeur pour foret calibré PROGRESSIVE-LINE et SCREW-LINE re-stérilisable **Matériau** Alliage de titane	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
	Foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5072.3300	3.3 mm	-
		J5072.3800	3.8 mm	
		J5072.4300	4.3 mm	
		J5072.5000	5.0 mm	
	Taraud PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5071.3300	3.3 mm	-
		J5071.3800	3.8 mm	
		J5071.4300	4.3 mm	
		J5071.5000	5.0 mm	
	Adaptateur de démontage pour CAMLOG® et CONELOG® adapté à toutes les dimensions d'implants **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0022*	3.3 mm	6.2 mm
			3.8 mm	
			4.3 mm	
			5.0 mm	
	Jauge de parallélisme PROGRESSIVE-LINE avec marquages de profondeur (pour foret pilote Ø 2.0 mm) **Matériau** Alliage de titane	J5300.2000	-	-

* Uniquement pour une utilisation avec les implants PROGRESSIVE-LINE avec porte implant clipsé.

PROGRESSIVE-LINE Flex

Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG®

NOUVEAU

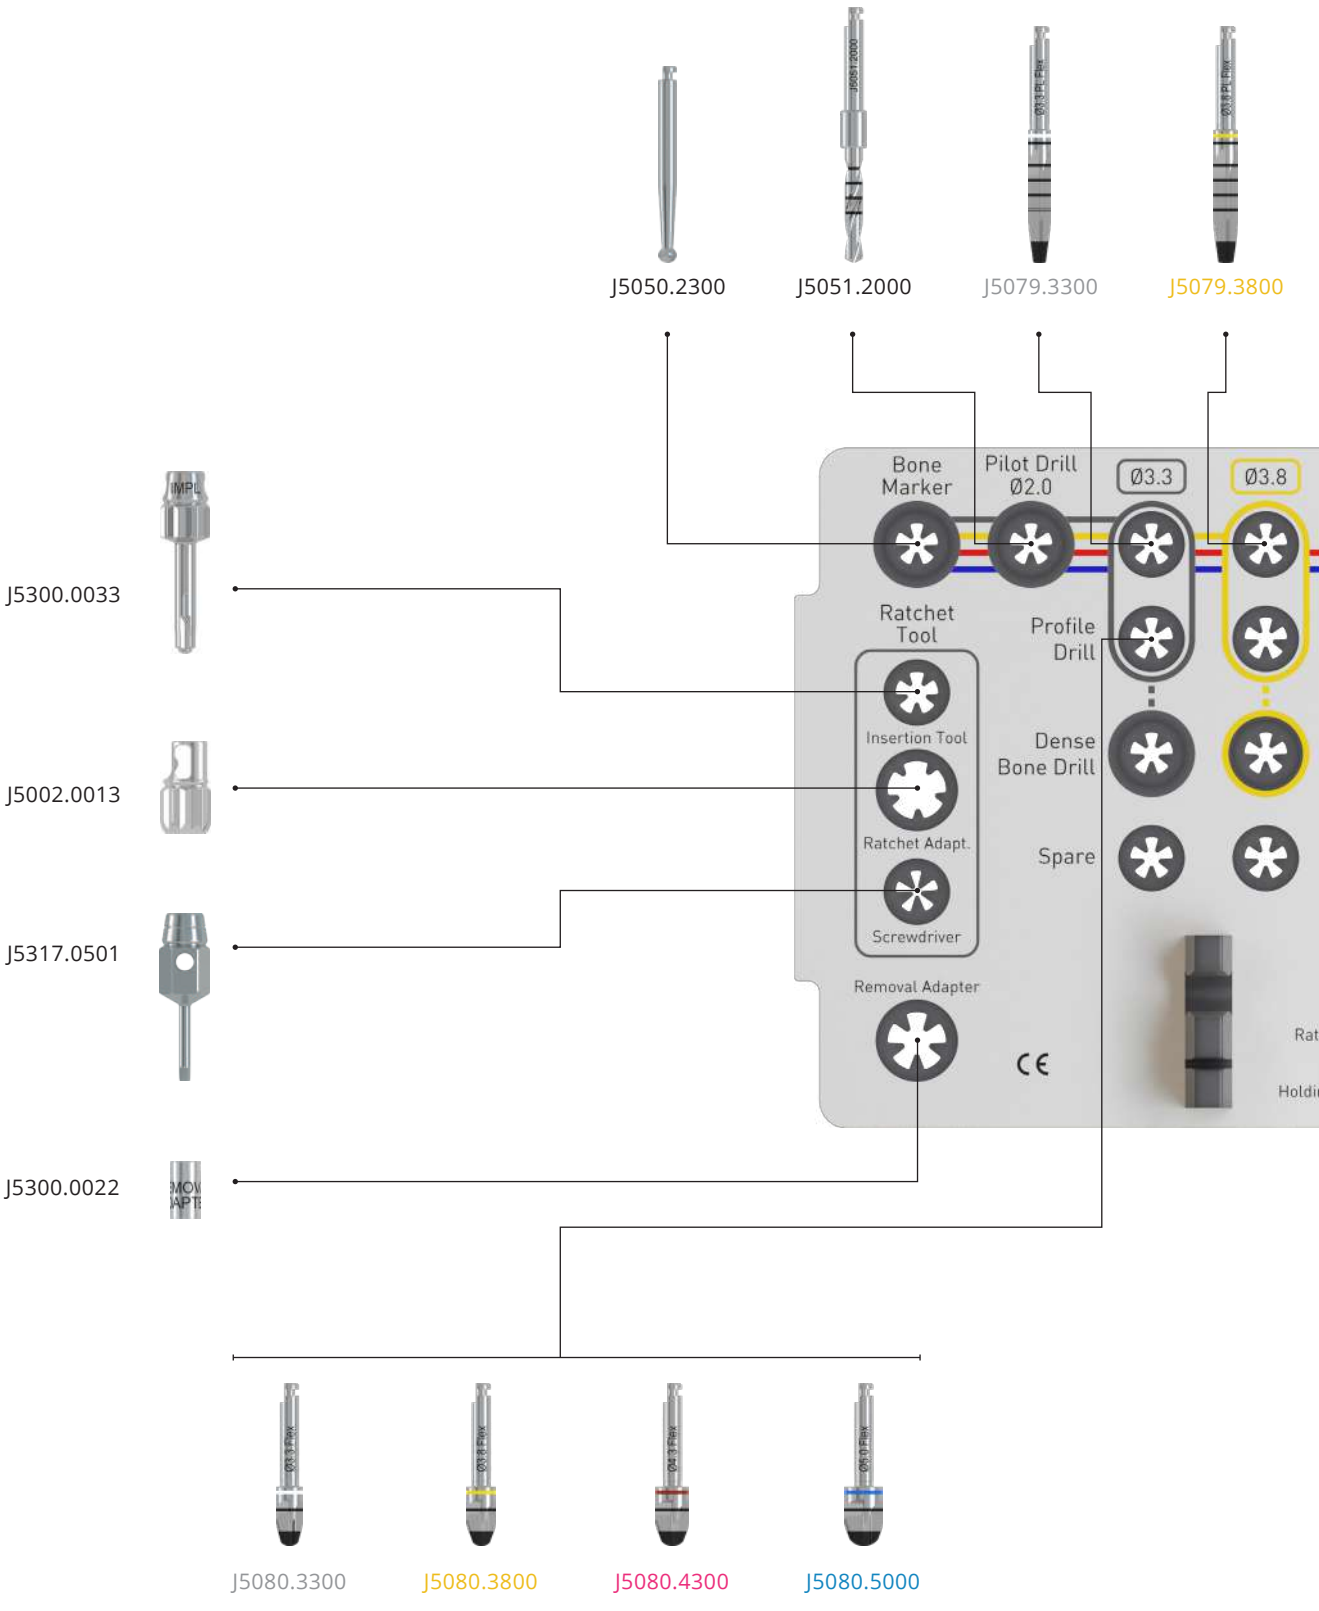

* Articles facultatifs, peuvent être acquis séparément

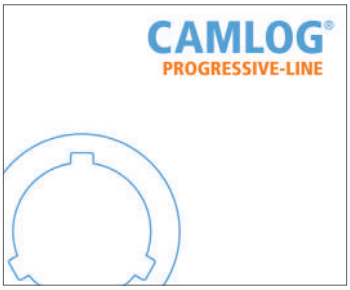

Les forets sont rangés et triés dans le set en fonction de la séquence de traitement. Les lignes de couleur indiquent précisément la séquence de forage.

J5079.4300

J5079.5000

J5300.2000

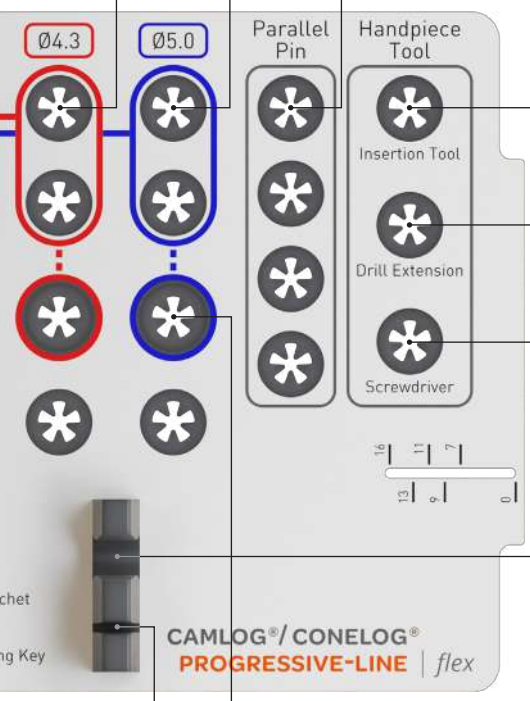

J5300.0036

J5002.0006

J5317.0504

J5320.1030

J5302.0010

J5072.3300

J5072.3800

J5072.4300

J5072.5000

PROGRESSIVE-LINE Flex

Set chirurgical

	Article	N° d'article
	Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex contient tous les instruments chirurgicaux nécessaires, classés par code couleur, y compris une clé dynamométrique et une clé universelle de contre-couple	J5300.0071
	Trousse chirurgicale CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex sans contenu	J5300.8920

Instruments Chirurgicaux

	Article	N° d'article	Ø	L
	Foret PROGRESSIVE-LINE Flex re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5079.3300	3.3 mm	-
		J5079.3800	3.8 mm	
		J5079.4300	4.3 mm	
		J5079.5000	5.0 mm	
	Foret de profil PROGRESSIVE-LINE Flex re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5080.3300	3.3 mm	-
		J5080.3800	3.8 mm	
		J5080.4300	4.3 mm	
		J5080.5000	5.0 mm	
	Adaptateur de clé à cliquet **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0013	-	11 mm

La préparation du site implantaire au moyen des instruments PROGRESSIVE-LINE Flex est identique pour les implants CAMLOG® et CONELOG® PROGRESSIVE-LINE.

PROGRESSIVE-LINE

Système Guide Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG®

NOUVEAU

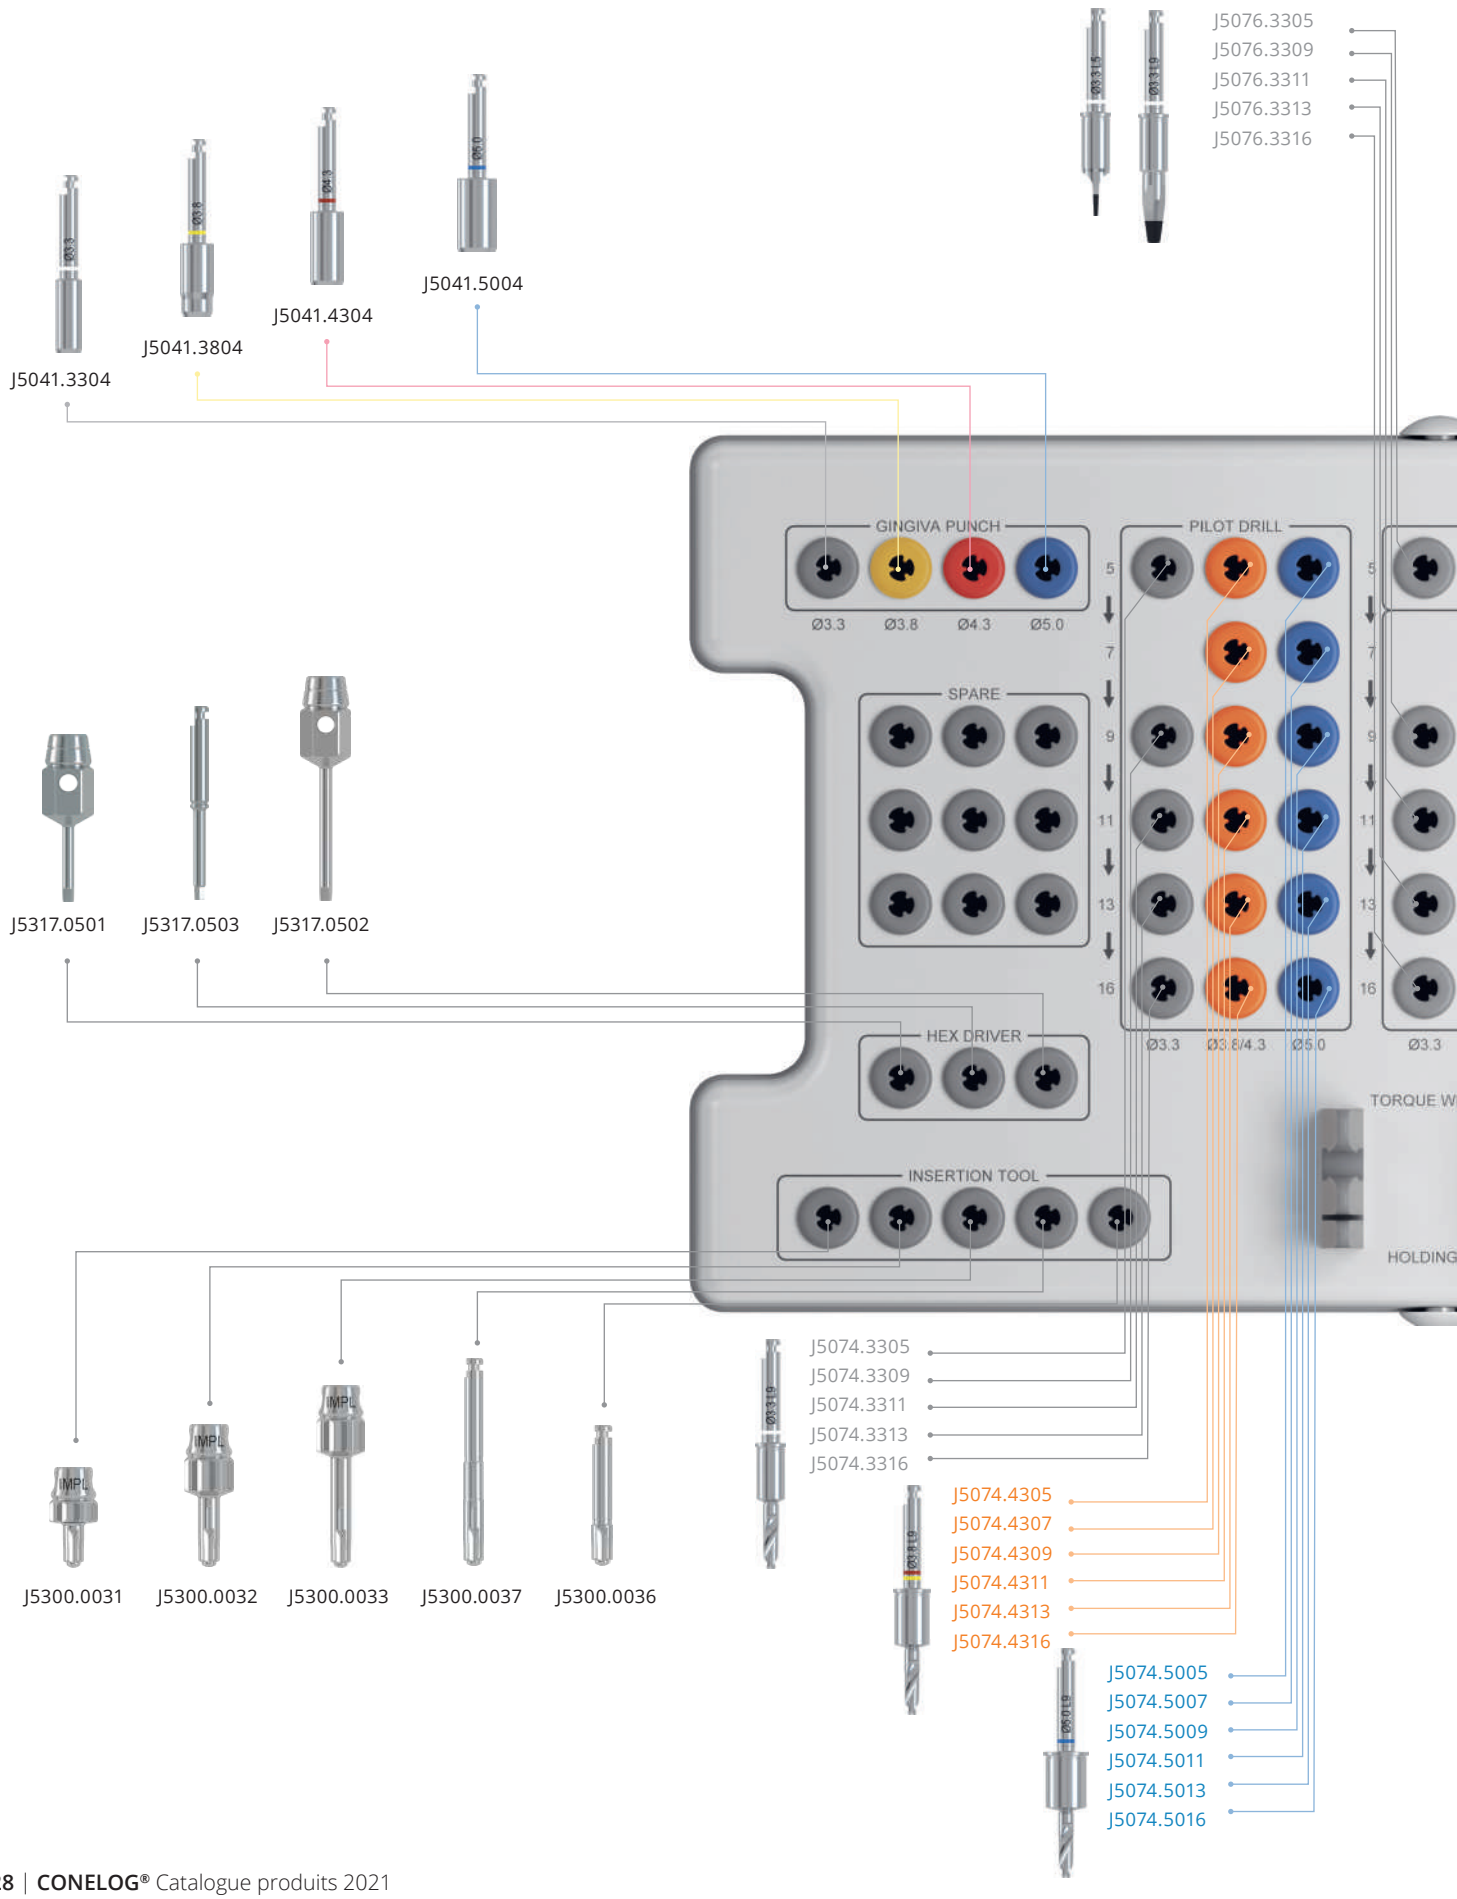

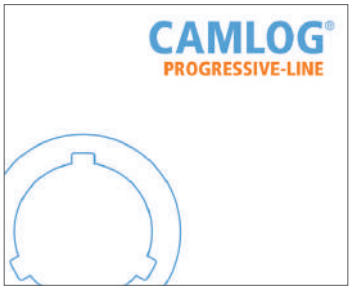

Les forets sont rangés et triés dans le set en fonction de la séquence de traitement. Les lignes de couleur indiquent précisément la séquence de forage.

J5076.3805
J5076.3807
J5076.3809
J5076.3811
J5076.3813
J5076.3816

J5076.4305
J5076.4307
J5076.4309
J5076.4311
J5076.4313
J5076.4316

J5076.5005
J5076.5007
J5076.5009
J5076.5011
J5076.5013
J5076.5016

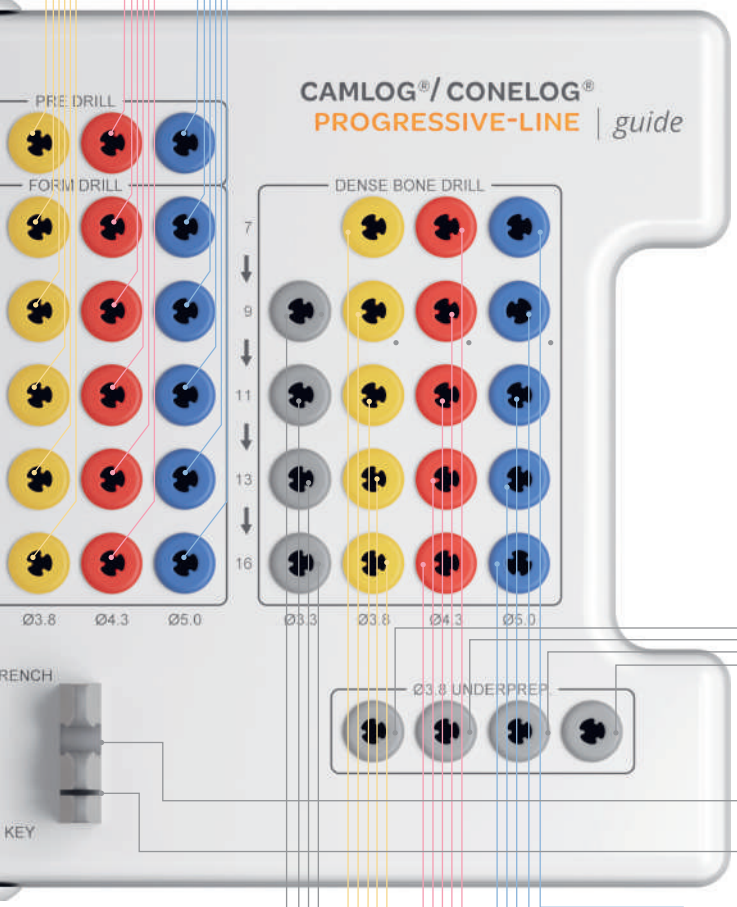

J5077.3316
J5077.3313
J5077.3311
J5077.3309

J5320.1030

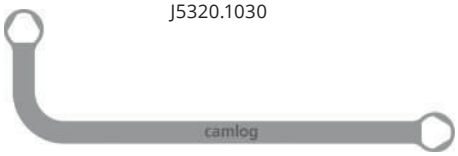

J5302.0010

J5078.3309
J5078.3311
J5078.3313
J5078.3316

J5078.3807
J5078.3809
J5078.3811
J5078.3813
J5078.3816

J5078.4307
J5078.4309
J5078.4311
J5078.4313
J5078.4316

J5078.5007
J5078.5009
J5078.5011
J5078.5013
J5078.5016

PROGRESSIVE-LINE

Système Guide

	Article	N° d'article
	Système Guide trousse chirurgicale CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sans contenu	J5300.8919

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide poinçon gingival PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5041.3304	3.3 mm	-
		J5041.3804	3.8 mm	
		J5041.4304	4.3 mm	
		J5041.5004*	5.0 mm	
	Système Guide foret pilote PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5074.3305	3.3 mm	5 mm
		J5074.3309		9 mm
		J5074.3311		11 mm
		J5074.3313		13 mm
		J5074.3316		16 mm
		J5074.4305	3.8 mm / 4.3 mm	5 mm
		J5074.4307		7 mm
		J5074.4309		9 mm
		J5074.4311		11 mm
		J5074.4313		13 mm
		J5074.4316		16 mm
		J5074.5005*	5.0 mm	5 mm
		J5074.5007*		7 mm
		J5074.5009*		9 mm
		J5074.5011*		11 mm
		J5074.5013*		13 mm
		J5074.5016*		16 mm

* Disponibilité des produits prévue pour la fin du T1/2021

Notes
Les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE avec no d'article C1085.xxxx avec porte implant vissé peuvent être utilisés avec le Système Guide PROGRESSIVE-LINE.

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide pré-foret PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5076.3305	3.3 mm	5 mm
		J5076.3805	3.8 mm	
		J5076.4305	4.3 mm	
		J5076.5005*	5.0 mm	
	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5076.3309	3.3 mm	9 mm
		J5076.3311		11 mm
		J5076.3313		13 mm
		J5076.3316		16 mm
		J5076.3807	3.8 mm	7 mm
		J5076.3809		9 mm
		J5076.3811		11 mm
		J5076.3813		13 mm
		J5076.3816		16 mm
		J5076.4307	4.3 mm	7 mm
		J5076.4309		9 mm
		J5076.4311		11 mm
		J5076.4313		13 mm
		J5076.4316		16 mm
		J5076.5007*	5.0 mm	7 mm
		J5076.5009*		9 mm
		J5076.5011*		11 mm
		J5076.5013*		13 mm
		J5076.5016*		16 mm
	Système Guide foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5078.3309	3.3 mm	9 mm
		J5078.3311		11 mm
		J5078.3313		13 mm
		J5078.3316		16 mm
		J5078.3807	3.8 mm	7 mm
		J5078.3809		9 mm
		J5078.3811		11 mm
		J5078.3813		13 mm
		J5078.3816		16 mm
		J5078.4307	4.3 mm	7 mm
		J5078.4309		9 mm
		J5078.4311		11 mm
		J5078.4313		13 mm
		J5078.4316		16 mm
		J5078.5007*	5.0 mm	7 mm
		J5078.5009*		9 mm
		J5078.5011*		11 mm
		J5078.5013*		13 mm
		J5078.5016*		16 mm
	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE pour Ø 3,8 mm sous préparation re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5077.3309	3.3 mm	9 mm
		J5077.3311		11 mm
		J5077.3313		13 mm
		J5077.3316		16 mm

* Disponibilité des produits prévue pour la fin du T1/2021

PROGRESSIVE-LINE

Système Guide

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J3753.3300	3.3 mm	-
		J3753.4300	3.8 mm / 4.3 mm	
		J3753.5000*	5.0 mm	
	Système Guide douille de guidage PROGRESSIVE-LINE** (2 pièces) **Matériau** Alliage de titane	J3754.3301	3.3 mm	-
		J3754.3801	3.8 mm	
		J3754.4301	4.3 mm	
		J3754.5001*	5.0 mm	
	Système Guide instrument de pose PROGRESSIVE-LINE pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J3717.3300	3.3 mm	-
		J3717.4300	3.8 mm / 4.3 mm	
		J3717.5000*	5.0 mm	
	Système Guide tige PROGRESSIVE-LINE pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J5301.3310	3.3 mm	-
		J5301.4310	3.8 mm / 4.3 mm	
		J5301.5010*	5.0 mm	
	Système Guide pilier d'insertion CONELOG®, vissé pour analogue de laboratoire/analogue d'implant CONELOG®, avec vis de fixation (2 pièces) **Matériau** Alliage de titane	C2026.3303	3.3 mm	-
		C2026.3803	3.8 mm	
		C2026.4303	4.3 mm	
		C2026.5003*	5.0 mm	

* Disponibilité des produits prévue pour la fin du T1/2021

** Uniquement pour l'utilisation avec les implants PROGRESSIVE-LINE avec porte implant vissé.

SCREW-LINE

Implants avec porte implant clipsé

	Article	N° d'article	Ø	L	A Ø
	Implant CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant clipsé et vis de fermeture, stérile **Matériau** Titane Grade 4	C1066.3309*	3.3 mm	9 mm	2.7 mm
		C1066.3311*		11 mm	
		C1066.3313*		13 mm	
		C1066.3316*		16 mm	
		C1066.3807*	3.8 mm	7 mm	3.5 mm
		C1066.3809*		9 mm	
		C1066.3811*		11 mm	
		C1066.3813*		13 mm	
		C1066.3816*		16 mm	
		C1066.4307*	4.3 mm	7 mm	3.9 mm
		C1066.4309*		9 mm	
		C1066.4311*		11 mm	
		C1066.4313*		13 mm	
		C1066.4316*		16 mm	
		C1066.5007*	5.0 mm	7 mm	4.6 mm
		C1066.5009*		9 mm	
		C1066.5011*		11 mm	
		C1066.5013*		13 mm	
		C1066.5016*		16 mm	

* Veuillez noter : les implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec no d'article C1066.xxxx succèdent aux implants avec no d'article C1064.xxxx à partir du mois d'octobre 2020. En fonction de votre pays, les implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec no d'article C1064.xxxx peuvent rester disponibles pendant une durée prolongée.

Implants avec porte implant vissé

	Article	N° d'article	Ø	L	A Ø
	Implant CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant vissé et vis de fermeture, stérile **Matériau** Titane Grade 4	C1065.3309**	3.3 mm	9 mm	2.7 mm
		C1065.3311**		11 mm	
		C1065.3313**		13 mm	
		C1065.3316**		16 mm	
		C1065.3807**	3.8 mm	7 mm	3.5 mm
		C1065.3809**		9 mm	
		C1065.3811**		11 mm	
		C1065.3813**		13 mm	
		C1065.3816**		16 mm	
		C1065.4307**	4.3 mm	7 mm	3.9 mm
		C1065.4309**		9 mm	
		C1065.4311**		11 mm	
		C1065.4313**		13 mm	
		C1065.4316**		16 mm	
		C1065.5007**	5.0 mm	7 mm	4.6 mm
		C1065.5009**		9 mm	
		C1065.5011**		11 mm	
		C1065.5013**		13 mm	
		C1065.5016**		16 mm	

** Veuillez noter : les implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec no d'article C1065.xxxx succèdent aux implants avec no d'article C1063.xxxx à partir du mois d'octobre 2020. En fonction de votre pays, les implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec no d'article C1063.xxxx peuvent rester disponibles pendant une durée prolongée.

Notes
Les implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec les no d'article C1064.xxxx et C1065.xxxx doivent être utilisés exclusivement avec les instruments de pose avec les no d'article J5300.0031, J5300.0032, J5300.0033, J5300.0034, J5300.0035, J5300.0036 ou J5300.0037.

SCREW-LINE

Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG®

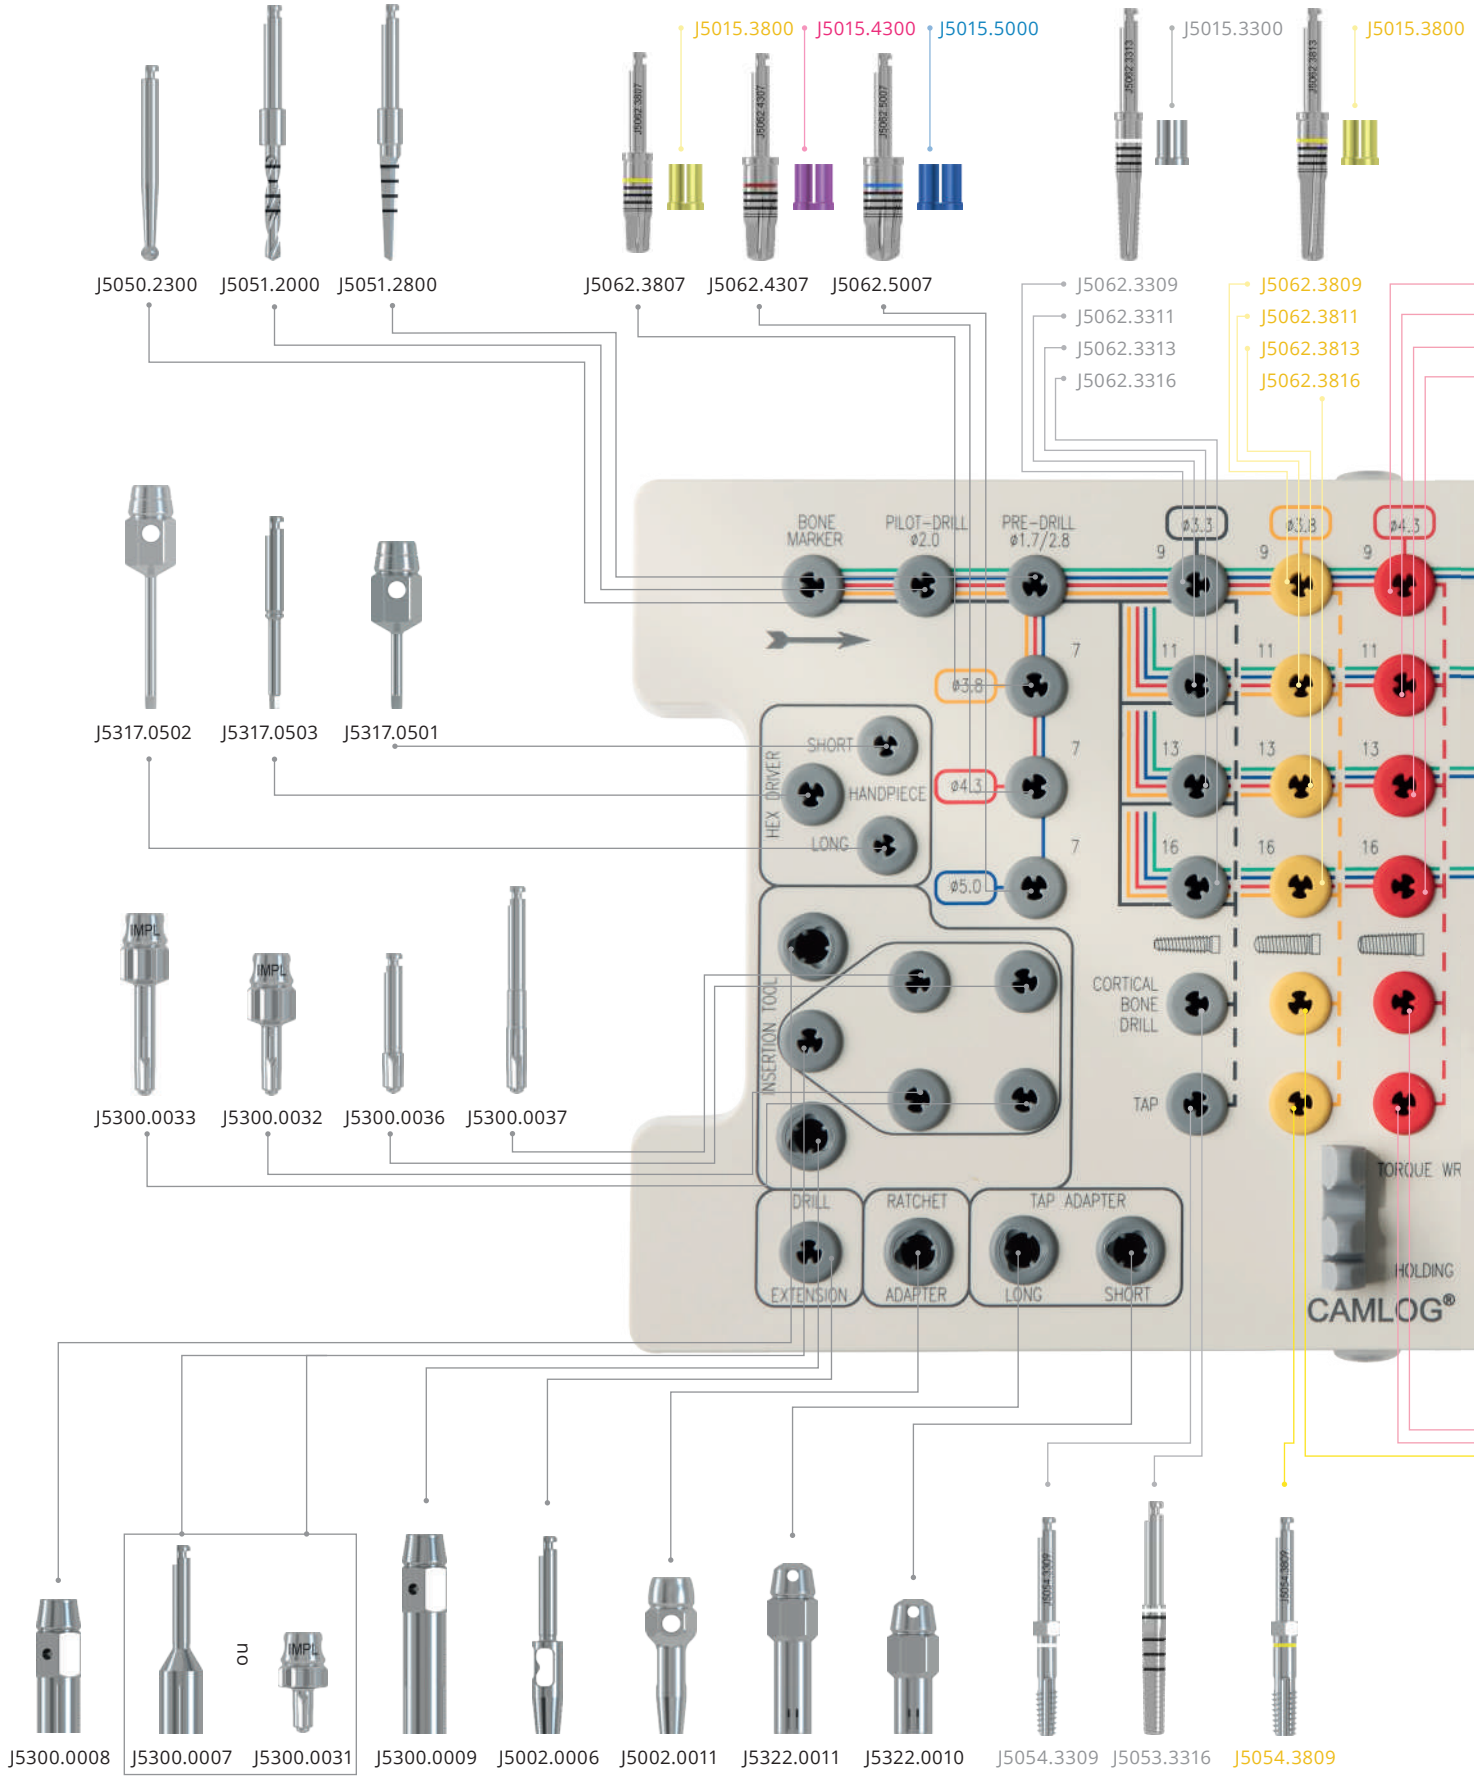

Les forets sont rangés et triés dans le set en fonction de la séquence de traitement. Les lignes de couleur indiquent précisément la séquence de forage.

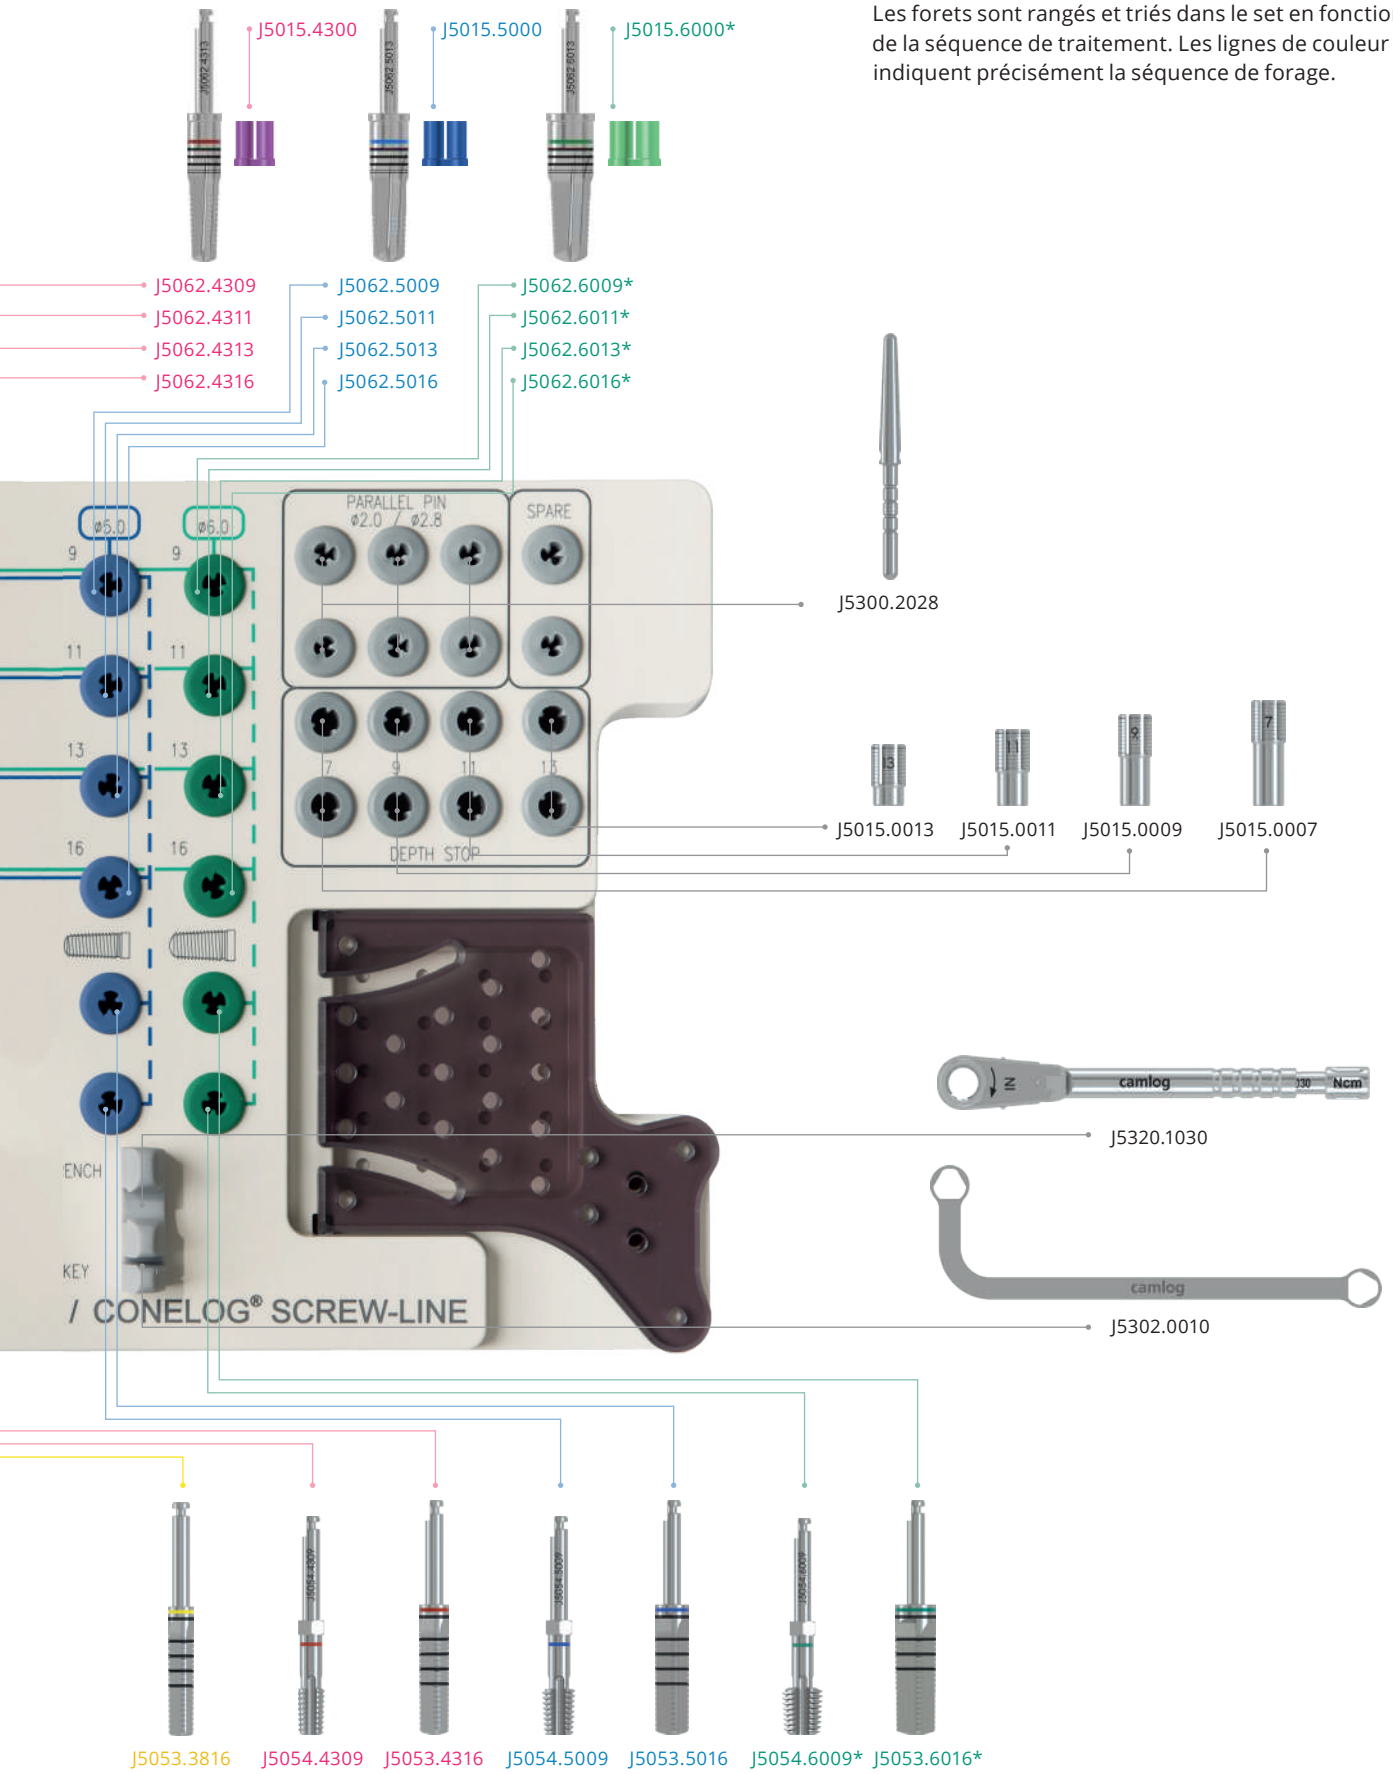

* uniquement pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE Ø 6.0 mm

SCREW-LINE

Set chirurgical

	Article	N° d'article
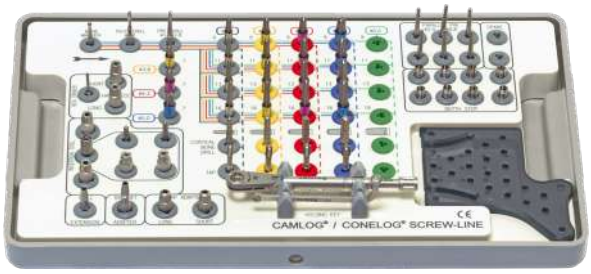	**Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** contenant l'ensemble des instruments chirurgicaux nécessaires triés par code couleur, y compris une clé dynamométrique et une clé universelle de contre-couple (les forets et les tarauds pour le Ø 6,0 mm ne sont pas fournis).	J5300.0063
	Trousse chirurgicale CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE sans contenu	J5300.8916
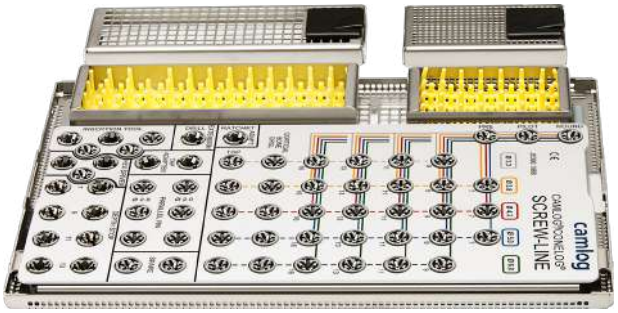	**Trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** avec patron, sans contenu	J5300.8968
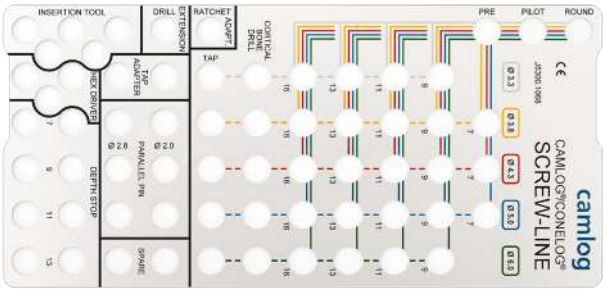	**Patron pour la trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** **Matériau** Aluminium	J5300.1068

La préparation du site de implantaire pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE et CONELOG® SCREW-LINE utilise les même instruments.

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	Ø	L
	Foret calibré SCREW-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5062.3309	3.3 mm	9 mm
		J5062.3311		11 mm
		J5062.3313		13 mm
		J5062.3316		16 mm
		J5062.3807	3.8 mm	7 mm
		J5062.3809		9 mm
		J5062.3811		11 mm
		J5062.3813		13 mm
		J5062.3816		16 mm
		J5062.4307	4.3 mm	7 mm
		J5062.4309		9 mm
		J5062.4311		11 mm
		J5062.4313		13 mm
		J5062.4316		16 mm
		J5062.5007	5.0 mm	7 mm
		J5062.5009		9 mm
		J5062.5011		11 mm
		J5062.5013		13 mm
		J5062.5016		16 mm
	Butée de profondeur pour foret calibré PROGRESSIVE-LINE et SCREW-LINE re-stérilisable **Matériau** Alliage de titane	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
	Foret cortical SCREW-LINE os cortical re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5053.3316	3.3 mm	-
		J5053.3816	3.8 mm	
		J5053.4316	4.3 mm	
		J5053.5016	5.0 mm	
	Taraud SCREW-LINE hex, re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5054.3309	3.3 mm	-
		J5054.3809	3.8 mm	
		J5054.4309	4.3 mm	
		J5054.5009	5.0 mm	

SCREW-LINE

Systèm Guide

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide set de forets pilotes avec irrigation interne, stérile (pour forets pilotes Ø 2.0 mm) **Matériau** Acier inoxydable	J5063.3309	3.3 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
		J5063.3311		11 mm (incl. 5 et 9 mm)**
		J5063.3313		13 mm (incl. 5, 9 et 11 mm)**
		J5064.3316*		16 mm
		J5063.4307	3.8 mm	7 mm (incl. 5 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4309	3.8 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4311	3.8 mm	11 mm (incl. 5 et 9 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4313	3.8 mm	13 mm (incl. 5, 9 et 11 mm)**
			4.3 mm	
		J5064.4316*	3.8 mm	16 mm
			4.3 mm	

* Foret pilote Système Guide requis pour la longueur d'implant 16 mm, après utilisation préalable obligatoire de la longueur 13 mm du set de forets pilotes.

** Tous les sets de forets pilotes Système Guide comprennent un foret pilote de 5 mm ainsi que tous les forets pilotes nécessaires jusqu'à la longueur d'implant sélectionnée.

Tous les forets et poinçons gingivaux Système Guide pour SCREW-LINE sont à usage unique.

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide set chirurgical, SCREW-LINE avec irrigation interne, stérile **Matériau** Acier inoxydable	J5065.3309	3.3 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
		J5065.3311		11 mm (incl. 5 et 9 mm)**
		J5065.3313		13 mm (incl. 5, 9 et11 mm)**
		J5066.3316*		16 mm
		J5065.3807	3.8 mm	7 mm (incl. 5 mm)**
		J5065.3809		9 mm (incl. 5 mm)**
		J5065.3811		11 mm (incl. 5 et 9 mm)**
		J5065.3813		13 mm (incl. 5, 9 et 11 mm)**
		J5066.3816*		16 mm
		J5065.4307	4.3 mm	7 mm (incl. 5 mm)**
		J5065.4309		9 mm (incl. 5 mm)**
		J5065.4311		11 mm (incl. 5 et 9 mm)**
		J5065.4313		13 mm (incl. 5, 9 et 11 mm)**
		J5066.4316*		16 mm
	Système Guide foret calibré, SCREW-LINE, os cortical avec irrigation interne, stérile **Matériau** Acier inoxydable	J5068.3309	3.3 mm	9 mm
		J5068.3311		11 mm
		J5068.3313		13 mm
		J5068.3316		16 mm
		J5068.3807	3.8 mm	7 mm
		J5068.3809		9 mm
		J5068.3811		11 mm
		J5068.3813		13 mm
		J5068.3816		16 mm
		J5068.4307	4.3 mm	7 mm
		J5068.4309		9 mm
		J5068.4311		11 mm
		J5068.4313		13 mm
		J5068.4316		16 mm
	Système Guide poinçon gingival stérile **Matériau** Acier inoxydable	J5041.3303	3.3 mm	-
		J5041.3803	3.8 mm	
		J5041.4303	4.3 mm	

* Foret calibré Système Guide requis pour la longueur d'implant 16 mm, après utilisation préalable obligatoire de la longueur 13 mm du set chirurgical Système Guide.

** Tous les sets chirurgicaux Système Guide comprennent un pré-foret de 5 mm ainsi que tous les forets calibrés nécessaires jusqu'à la longueur d'implant sélectionnée.

Tous les forets et poinçons gingivaux Système Guide pour SCREW-LINE sont à usage unique.

SCREW-LINE

Systèm Guide

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide douille de guidage hauteur 3.0 mm (2 pièces) **Matériau** Alliage de titane	J3734.3303*	3.3 mm	-
		J3734.3803*	3.8 mm	
		J3734.4303*	4.3 mm	
	Système Guide pilier d'insertion CONELOG®, vissé pour analogue de laboratoire/ analogue d'implant CONELOG®, avec vis de fixation (2 pièces) **Matériau** Alliage de titane	C2026.3303	3.3 mm	-
		C2026.3803	3.8 mm	
		C2026.4303	4.3 mm	
	Système Guide foret calibré pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J3733.3300	3.3 mm	-
		J3733.4300	3.8 mm	
			4.3 mm	
	Système Guide instrument de pose pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J3716.3300	3.3 mm	-
		J3716.4300	3.8 mm	
			4.3 mm	

* Uniquement pour l'utilisation avec les implants SCREW-LINE avec porte implant vissé.
Tous les forets et poinçons gingivaux Système Guide pour SCREW-LINE sont à usage unique.

	Article	N° d'article	Ø	L
	Système Guide tige pour Système Guide douille de guidage **Matériau** Acier inoxydable	J5301.3300	3.3 mm	-
		J5301.4300	3.8 mm	
			4.3 mm	
	Système Guide instrument de vissage* pour implant Système Guide Ø 3.3/3.8/4.3 mm, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5303.4300	3.3 mm	-
			3.8 mm	
			4.3 mm	
	Système Guide instrument de vissage* pour implant Système Guide Ø 3.3/3.8/4.3 mm, avec embout ISO pour contre angle **Matériau** Acier inoxydable	J5304.4300	3.3 mm	-
			3.8 mm	
			4.3 mm	
	Prolongateur pour foret norme ISO, pour instruments à irrigation interne **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0005	-	26.6 mm

* Uniquement pour l'utilisation avec les implants CONELOG® SCREW-LINE avec no d'article C1063.xxxx.

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	⌀	L
	Fraise boule re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5050.2300	2.3 mm	-
	Foret pointeur re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	B1012*	1.5 mm	30.0 mm
	Foret pilote sans collet, re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5051.2003	2.0 mm	-
	Foret pilote SCREW-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5051.2000	2.0 mm	-
	Pré-foret SCREW-LINE re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable	J5051.2800	1.7 – 2.8 mm	-

* Fabricant: AXIS biodental SA, Les Rosées 5, 2336 Les Bois, Suisse

	Article		N° d'article	Ø	L
	Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote (J5051.2000) et pré-foret (J5051.2800), re-stérilisable **Matériau** Acier inoxydable		J5015.0007	-	7 mm
			J5015.0009		9 mm
			J5015.0011		11 mm
			J5015.0013		13 mm
	Bone profiler **Matériau** Acier inoxydable	Ø 5.0 mm	J5003.3350	3.3 mm	-
		Ø 6.0 mm	J5003.4360	3.8 mm	
				4.3 mm	
		Ø 7.0 mm	J5003.5070	5.0 mm	
	CONELOG® guide tige de guidage pour bone profiler **Matériau** Alliage de titane		C5002.3300	3.3 mm	-
			C5002.3800	3.8 mm	
			C5002.4300	4.3 mm	
			C5002.5000	5.0 mm	
	Fraise à planer **Matériau** Acier inoxydable	Ø 4.6 mm	J5006.3346	3.3 mm	-
		Ø 5.2 mm	J5006.3852	3.8 mm	
		Ø 5.6 mm	J5006.4356	4.3 mm	
		Ø 6.3 mm	J5006.5063	5.0 mm	
	Fraise pour l'exposition de la vis de fermeture **Matériau** Acier inoxydable		J5004.3300	3.3 mm	-
			J5004.3800	3.8 mm	
			J5004.4300	4.3 mm	
			J5004.5000	5.0 mm	

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	Dimensions
	Pilier de parallélisme SCREW-LINE avec marquages de profondeur **Matériau** Alliage de titane	J5300.2028	Ø 1.7 – 2.8 mm/ 2.0 mm
	Prolongateur pour foret norme ISO (pas pour foret à refroidissement interne) **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0006	26.5 mm
	Adaptateur manuel pour taraud, court pour taraud SCREW-LINE **Matériau** Acier inoxydable	J5322.0010	18.0 mm
	Adaptateur manuel pour taraud, long pour taraud SCREW-LINE **Matériau** Acier inoxydable	J5322.0011	23.0 mm

	Article	N° d'article	Dimensions
	Instrument de pose d'implant, extra court pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0031*	13.7 mm
	Instrument de pose d'implant, court pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0032*	19.2 mm
	Instrument de pose d'implant, long pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0033*	24.8 mm
	Instrument de pose d'implant, court pour implants vissés, avec embout ISO pour contre-angle (sans hexagone sur l'embout) **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0036*	19.1 mm
	Instrument de pose d'implant, long pour implants vissés, avec embout ISO pour contre-angle (sans hexagone sur l'embout) **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0037*	28.2 mm
	Instrument de pose d'implant, court pour implants vissés, avec embout ISO pour contre-angle (avec hexagone sur l'embout) **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0034*	19.1 mm
	Instrument de pose d'implant, long pour implants vissés, avec embout ISO pour contre-angle (avec hexagone sur l'embout) **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0035*	28.2 mm

* Uniquement pour l'utilisation avec les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE avec no d'article C1086.xxxx et les implants CONELOG® SCREW-LINE avec no d'article C1064.xxxx, C1065.xxxx et C1066.xxxx.

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	Dimensions
	Clé à cardans (30°) longueur réglable **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0038*	-
	Instrument pick-up outil pour désinsérer le porte-implant **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0030**	-
	Adaptateur norme ISO de contre-angle/ clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0011	21.0 mm

* Uniquement pour l'utilisation avec les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE avec no d'article C1086.xxxx et les implants CONELOG® SCREW-LINE avec no d'article C1064.xxxx, C1065.xxxx et C1066.xxxx.

** Uniquement pour l'utilisation avec les implants CONELOG® PROGRESSIVE-LINE (avec porte implant clipsé) avec no d'article C1086.xxxx et les implants CONELOG® SCREW-LINE avec no d'article C1062.xxxx et C1066.xxxx.

	Article	N° d'article	Ø	Dimensions
	Clé universelle de contre-couple **Matériau** Acier inoxydable	J5302.0010	-	-
	CONELOG® Instrument d'insertion, court pour implants CONELOG® **Matériau** Acier inoxydable	C5302.3311	3.3 mm	28.1 mm
		C5302.4311	3.8 mm	
			4.3 mm	
		C5302.5011	5.0 mm	
	CONELOG® Instrument d'insertion, long pour implants CONELOG® **Matériau** Acier inoxydable	C5302.3310	3.3 mm	33.1 mm
		C5302.4310	3.8 mm	
			4.3 mm	
	Gaine de maintien pour implants code couleur **Matériau** Alliage de titane	J5302.3300	3.3 mm	-
		J5302.3800	3.8 mm	
		J5302.4300	4.3 mm	
		J5302.5000	5.0 mm	
	Tournevis hex, extra court, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0510	-	14.5 mm
	Tournevis hex, court, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0501	-	22.5 mm
	Tournevis hex, long, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0502	-	30.3 mm

Instruments chirurgicaux

	Article	N° d'article	Dimensions
	Tournevis hex, court, norme ISO **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0504	18.0 mm
	Tournevis hex, long, norme ISO **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0503	26.0 mm
	Tournevis à main, hex sans tête de clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0511	23.0 mm
	Aiguille de nettoyage pour foret à irrigation interne **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0012	-
	Canule de nettoyage pour foret à irrigation interne **Matériau** Acier inoxydable	J5002.0020	-

SCREW-LINE

Set d’ostéotomie

	Article	N° d’article	Ø
	Set d’ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE droit-convex **Matériau** Acier inoxydable	J5418.0020	-
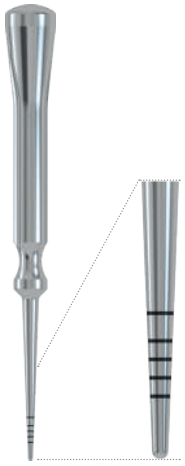	**Pré-ostéotome SCREW-LINE** droit-convex **Matériau** Acier inoxydable	J5417.2800*	1.7 – 2.8 mm
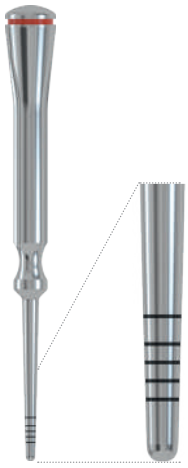	**Ostéotome SCREW-LINE** droit-convex **Matériau** Acier inoxydable	J5418.3300*	3.3 mm
		J5418.3800*	3.8 mm
		J5418.4300*	4.3 mm
		J5418.5000*	5.0 mm

* Ces produits sont également compris dans le set d’ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments droits-convexes.

SCREW-LINE

Set d’ostéotomie

	Article	N° d’article	Ø
	Set d’ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angulé-convexe **Matériau** Acier inoxydable	J5418.0030	-
	Pré-ostéotome SCREW-LINE droit-convex **Matériau** Acier inoxydable	J5417.2800*	1.7 – 2.8 mm
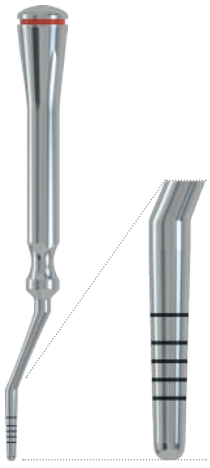	**Ostéotome SCREW-LINE** angulé-convexe **Matériau** Acier inoxydable	J5418.3310*	3.3 mm
		J5418.3810*	3.8 mm
		J5418.4310*	4.3 mm
		J5418.5010*	5.0 mm

* Ces produits sont également compris dans le set d’ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments angulés-convexes.

	Article	N° d'article	Ø
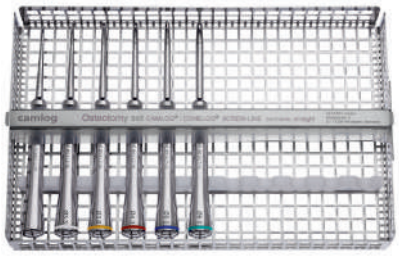	**Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** droit-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5420.0020	-
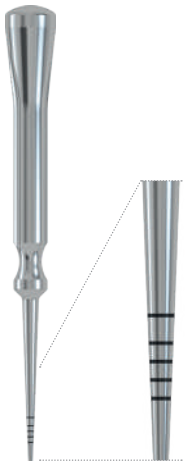	**Pré-ostéotome SCREW-LINE** droit-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5419.2800*	1.7 – 2.8 mm
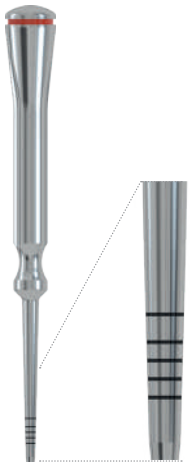	**Ostéotome SCREW-LINE** droit-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5420.3300*	3.3 mm
		J5420.3800*	3.8 mm
		J5420.4300*	4.3 mm
		J5420.5000*	5.0 mm

* Ces produits sont également compris dans le set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments droits-concaves.

SCREW-LINE

Set d'ostéotomie

	Article	N° d'article	Ø
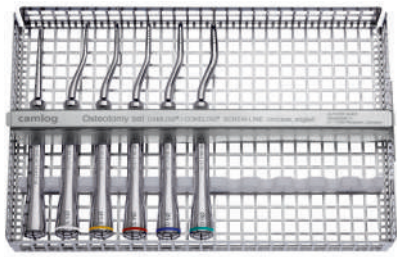	**Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** angulé-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5420.0030	-
	Pré-ostéotome SCREW-LINE droit-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5419.2800*	1.7 – 2.8 mm
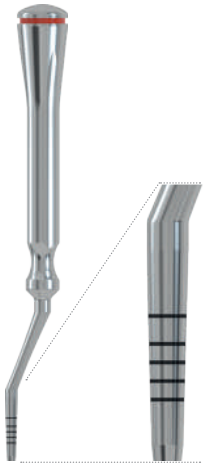	**Ostéotome SCREW-LINE** angulé-concaves **Matériau** Acier inoxydable	J5420.3310*	3.3 mm
		J5420.3810*	3.8 mm
		J5420.4310*	4.3 mm
		J5420.5010*	5.0 mm

* Ces produits sont également compris dans le set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments angulés-concaves.

Set ALTApin

	Article	N° d'article
	Set ALTApin Système de fixation de membrane, re-stérilisable **Matériau** Plastique/Alliage de titane/Acier inoxydable	M5600.0110
	Trousse ALTApin, (vide) **Matériau** Plastique	M5600.0210
	Applicateur ALTApin, droit avec activateur **Matériau** Acier inoxydable	M5100.0010*
	Applicateur ALTApin, angulé 90˚ avec activateur **Matériau** Acier inoxydable	M5100.0030
	Applicateur ALTApin, droit, partie travaillante avec activateur **Matériau** Acier inoxydable	M5200.0010

* Ces produits sont compris dans le set ALTApin.

Set ALTApin

	Article	N° d'article
	Pointeau ALTApin **Matériau** Acier inoxydable	M5100.0050*
	Fixateur de membrane ALTApin **Matériau** Acier inoxydable	M5100.0070*
	Maillet chirurgical ALTApin **Matériau** Acier inoxydable/POM	M5100.0100
	Foret à usage unique ALTApin, norme ISO **Matériau** Acier inoxydable	M5500.0050
	Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin **Matériau** Acier inoxydable	M5200.0055*

* Ces produits sont compris dans le set ALTApin.

	Article	N° d'article
	Distributeurs ALTApin 7 clous en titane, stériles, 1 pièce **Matériau** Alliage de titane	M1000.0050*
	Distributeurs ALTApin 7 clous en titane, stériles, 3 pièces **Matériau** Alliage de titane	M1000.0100

Vis de fermeture

	Article	N° d'article	Ø
	CONELOG® Vis de fermeture pour implant **Matériau** Alliage de titane	C2019.3300	3.3 mm
		C2019.3800	3.8 mm
		C2019.4300	4.3 mm
		C2019.5000	5.0 mm

Piliers de cicatrisation

	Article	N° d'article	Ø	HG	G Ø
	Piliers de cicatrisation CONELOG®, cylindriques sterile **Matériau** Alliage de titane	C2015.3320	3.3 mm	2.0 mm	3.0 mm
		C2015.3340		4.0 mm	3.0 mm
		C2015.3820	3.8 mm	2.0 mm	3.5 mm
		C2015.3840		4.0 mm	3.5 mm
		C2015.3860**		6.0 mm	3.5 mm
		C2015.4320	4.3 mm	2.0 mm	3.8 mm
		C2015.4340		4.0 mm	3.8 mm
		C2015.4360**		6.0 mm	3.8 mm
		C2015.5020	5.0 mm	2.0 mm	4.5 mm
		C2015.5040		4.0 mm	4.5 mm
		C2015.5060**		6.0 mm	4.5 mm
	Piliers de cicatrisation CONELOG®, evasées sterile **Matériau** Alliage de titane	C2014.3340	3.3 mm	4.0 mm	4.8 mm
		C2014.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.3 mm
		C2014.3860		6.0 mm	5.3 mm
		C2014.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.8 mm
		C2014.4360		6.0 mm	5.8 mm
		C2014.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.5 mm
		C2014.5060		6.0 mm	6.5 mm
	Piliers de cicatrisation CONELOG®, bottleneck sterile **Matériau** Alliage de titane	C2011.3340	3.3 mm	4.0 mm	3.3 mm
		C2011.3840	3.8 mm	4.0 mm	3.8 mm
		C2011.3860		6.0 mm	3.8 mm
		C2011.4340	4.3 mm	4.0 mm	4.0 mm
		C2011.4360		6.0 mm	4.0 mm
		C2011.5040	5.0 mm	4.0 mm	4.7 mm
		C2011.5060		6.0 mm	4.7 mm

* Ces produits sont compris dans le set ALTApin.

** Convient pour l'enregistrement de l'occlusion

Ø 3.8 / 4.3

Prise d’empreinte

	Article	N° d’article	Ø
	**Pilier de prise d’empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert** avec vis de fixation (la vis de fixation peut être raccourcie de 3 mm avant l’insertion avec un tournevis, hex) **Matériau** Alliage de titane	C2121.3300	3.3 mm
		C2121.3800	3.8 mm
		C2121.4300	4.3 mm
		C2121.5000	5.0 mm
	**Pilier de prise d’empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé** avec capuchon de repositionnement, capuchon d’enregistrement de l’occlusion et vis de fixation **Matériau** Alliage de titane/POM	C2110.3300	3.3 mm
		C2110.3800	3.8 mm
		C2110.4300	4.3 mm
		C2110.5000	5.0 mm
	Capuchon de repositionnement pour pilier de prise d’empreinte, porte-empreinte fermé (5 pièces) **Matériau** POM	J2111.3300	3.3 mm
		J2111.3800	3.8 mm
		J2111.4300	4.3 mm
		J2111.5000	5.0 mm

Enregistrement de l'occlusion

	Article	N° d'article	Ø
	Pilier d'enregistrement de l'occlusion CONELOG® avec vis de fixation et capuchon d'enregistrement de l'occlusion **Matériau** Alliage de titane/POM	C2140.3300	3.3 mm
		C2140.3800	3.8 mm
		C2140.4300	4.3 mm
		C2140.5000	5.0 mm
	Capuchon d'enregistrement de l'occlusion (5 pièces) **Matériau** POM	J2112.3300	3.3 mm
		J2112.3800	3.8 mm
		J2112.4300	4.3 mm
		J2112.5000	5.0 mm

Fabrication du modèle

	Article	N° d'article	Ø
	Analogue de laboratoire CONELOG® pour modèles coulés **Matériau** Alliage de titane	C3010.3300	3.3 mm
		C3010.3800	3.8 mm
		C3010.4300	4.3 mm
		C3010.5000	5.0 mm
	Analogue d'implant CONELOG® pour modèles imprimés et coulés **Matériau** Alliage de titane	C3025.3300	3.3 mm
		C3025.3800	3.8 mm
		C3025.4300	4.3 mm
		C3025.5000	5.0 mm
	DIM® Analogue pour le système d'implants CONELOG® pour modèles imprimés, avec vis moletée **Matériau** Alliage de titane/Acier inoxydable	C3012.3300	3.3 mm
		C3012.4300	3.8 mm
			4.3 mm
		C3012.5000	5.0 mm

Fabricant de DIM® Analogue: nt-trading GmbH & Co. KG, G.-Braun-Straße 18, 76187 Karlsruhe, Allemagne
DIM® Analogue est une marque déposée de la société nt-trading GmbH & Co. KG.

Piliers provisoires

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Pilier provisoire CONELOG®, pour couronne personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2239.3300	3.3 mm*	-
		C2239.3800	3.8 mm	
		C2239.4300	4.3 mm	
		C2239.5000	5.0 mm	
	Pilier provisoire CONELOG®, pour bridge personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2339.3300	3.3 mm	-
		C2339.3800	3.8 mm	
		C2339.4300	4.3 mm	
		C2339.5000	5.0 mm	

Piliers Esthomic®

Restaurations scellées sur couronnes et bridges

	Article	N° d'article	Ø	HG
	**Piliers CONELOG® Esthomic®, droits** personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2226.3815	3.8 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2226.3830		3.0 – 4.5 mm
		C2226.4315	4.3 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2226.4330		3.0 – 4.5 mm
		C2226.5015	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2226.5030		3.0 – 4.5 mm
	Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type A personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2227.3815	3.8 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2227.3830		3.0 – 4.5 mm
		C2227.4315	4.3 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2227.4330		3.0 – 4.5 mm
		C2227.5015	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2227.5030		3.0 – 4.5 mm

* Uniquement pour les restaurations par couronne dans la région des incisives latérales supérieures et inférieure et des incisives centrales

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type B personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2228.3815	3.8 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2228.3830		3.0 – 4.5 mm
		C2228.4315	4.3 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2228.4330		3.0 – 4.5 mm
		C2228.5015	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2228.5030		3.0 – 4.5 mm
	Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type A personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2231.3815	3.8 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2231.3830		3.0 – 4.5 mm
		C2231.4315	4.3 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2231.4330		3.0 – 4.5 mm
		C2231.5015	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2231.5030		3.0 – 4.5 mm
	Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type B personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2232.3815	3.8 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2232.3830		3.0 – 4.5 mm
		C2232.4315	4.3 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2232.4330		3.0 – 4.5 mm
		C2232.5015	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
		C2232.5030		3.0 – 4.5 mm
	Piliers CONELOG® Esthomic®, Inset personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2235.3320	3.3 mm*	2.0 – 3.3 mm
		C2235.3820	3.8 mm	
		C2235.4320	4.3 mm	
		C2235.5020	5.0 mm	

* Uniquement pour les restaurations par couronne dans la région des incisives latérales supérieures et inférieure et des incisives centrales

Prothèses CFAO

Restaurations sur couronnes, sur bridges et hybrides

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Base en titane CFAO CONELOG®, couronne base de collage pour prothèse individualisée fabriquée CFAO, avec vis de pilier violet foncé anodisé pour base en titane CFAO et aide au collage (POM) **Matériau** Alliage de titane/POM	C2242.3308	3.3 mm*	0.8 mm
		C2242.3808	3.8 mm	
		C2242.4308	4.3 mm	
		C2242.5008	5.0 mm	
	Base en titane CFAO CONELOG®, couronne base de collage pour prothèse individualisée fabriquée CFAO, avec vis de pilier violet foncé anodisé pour base en titane CFAO et aide au collage (POM) **Matériau** Alliage de titane/POM	C2242.3320	3.3 mm*	2.0 mm
		C2242.3820	3.8 mm	
		C2242.4320	4.3 mm	
		C2242.5020	5.0 mm	
	Base en titane CFAO CONELOG®, bridge base de collage pour prothèse individualisée fabriquée CFAO, avec vis de pilier violet foncé anodisé pour base en titane CFAO et aide au collage (POM) **Matériau** Alliage de titane/POM	C2342.3308	3.3 mm	0.8 mm
		C2342.3808	3.8 mm	
		C2342.4308	4.3 mm	
		C2342.5008	5.0 mm	
	Base en titane CFAO CONELOG®, bridge base de collage pour prothèse individualisée fabriquée CFAO, avec vis de pilier violet foncé anodisé pour base en titane CFAO et aide au collage (POM) **Matériau** Alliage de titane/POM	C2342.3320	3.3 mm	2.0 mm
		C2342.3820	3.8 mm	
		C2342.4320	4.3 mm	
		C2342.5020	5.0 mm	

Les formes des bases en titane CFAO CONELOG® dans les bibliothèques CAO pour les principaux systèmes CAO dentaires. Les bibliothèques sont disponibles en téléchargement gratuit sur :
https://www.camlog.fr/fr/mediacenter/bibliotheques-cao/

* Uniquement pour les restaurations sur couronnes dans la zone des incisives latérales supérieures, et des incisives latérales et centrales inférieures

Prothèses CFAO individuelles DEDICAM® de Camlog
Votre représentant local Camlog vous donnera des renseignements complémentaires sur DEDICAM®.

	Article	N° d'article	Ø	Filetage
	Support de modelage CONELOG®, pour base en titane CFAO CONELOG® calcinable, pour la fabrication de mésostructures et de couronnes **Matériau** POM	C2242.3302	3.3 mm	-
		C2242.3802	3.8 mm	
		C2242.4302	4.3 mm	
		C2242.5002	5.0 mm	
	Vis de pilier CONELOG®, pour base en titane CFAO CONELOG® violet foncé anodisé **Matériau** Alliage de titane	C4015.1601	3.3 mm	M 1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4015.2001	5.0 mm	M 2.0
	Vis de laboratoire CONELOG®, pour base en titane CFAO CONELOG® brun anodisé en partie **Matériau** Alliage de titane	C4016.1601	3.3 mm	M 1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4016.2001	5.0 mm	M 2.0
	Scanbody CONELOG®* destiné à la localisation visuelle, tridimensionnelle d'implants CONELOG® dans la bouche du patient ou d'analogues de laboratoire CONELOG® sur le modèle de travail, avec la vis de pilier, stérile Incompatible avec les systèmes CEREC et inLab de Sirona® **Matériau** PEEK	C2600.3310	3.3 mm	-
		C2600.4310	3.8 mm	
			4.3 mm	
		C2600.5010	5.0 mm	
	Piliers de numérisation CONELOG® pour scanbody Sirona® pour l'enregistrement numérique de la postion de l'implant ou de l'analogue de laboratoire CONELOG® et pour la modélisation ultérieure sur les systèmes Sirona® CEREC et inLab, vis de pilier incluse **Matériau** Alliage de titane	C2620.3306	3.3 mm	-
		C2620.3806	3.8 mm	
		C2620.4306	4.3 mm	
		C2620.5006	5.0 mm	

* Veuillez vérifier si le scanbody CONELOG® est disponible dans le logiciel de CAO utilisé. Des bibliothèques de CAO pour certains composants prothétiques CONELOG® sélectionnés sont disponibles en téléchargement gratuit sur : https://www.camlog.fr/fr/mediacenter/bibliotheques-cao/

Scanbodies Sirona® compatibles taille S pour pilier de numérisation CONELOG® et base en titane CONELOG® couronne CFAO Ø 3.3/3.8/4.3 mm: Pour Omnicam®: n° art. 6431311 Pour Bluecam®: n° art. 6431295
Scanbodies Sirona® compatibles taille L pour pilier de numérisation CONELOG® et base en titane CONELOG® couronne CFAO Ø 5.0 mm: Pour Omnicam®: n° art. 6431329 Pour Bluecam®: n° art. 6431303
Les scanbodies Sirona® sont disponibles auprès de la société Dentsply Sirona®.

Bloc titane CFAO

Fabrication par fraisage de piliers monoblocs individualisés et de coiffes de cicatrisation à l'aide de la technologie CFAO

	Article	N° d'article	Ø
	Bloc titane CFAO CONELOG®, type IAC,* Ø 12 mm, longueur 12.5 mm, (2 pièces), fourni avec 2 vis de pilier emballées séparément **Matériau** Alliage de titane	C2411.3313	3.3 mm
		C2411.4313	3.8 mm
			4.3 mm
		C2411.5013	5.0 mm
	Bloc titane CFAO CONELOG®, type ME** Ø 12 mm, longueur 20 mm, (2 pièces), fourni avec 2 vis de pilier emballées séparément **Matériau** Alliage de titane	C2421.3320	3.3 mm
		C2421.3820	3.8 mm
		C2421.4320	4.3 mm
		C2421.5020	5.0 mm

Accessoires pour bloc titane CFAO, type IAC

	Article	N° d'article	Ø
	Manche pour bloc titane CFAO CONELOG®, type IAC*, Ø 6 mm, longueur 17 mm, avec 2 vis pour bloc titane CFAO, type IAC **Matériau** Acier inoxydable	C3720.3300	3.3 mm
		C3720.4300	3.8 mm
			4.3 mm
		C3720.5000	5.0 mm

Type IAC*
Pour l'usinage, une ébauche en titane FAO de type IAC est fixée à la connexion implant-pilier sur le support CONELOG® pour ébauche FAO. Le support spécifique à la machine ou adaptateur de support tout comme les stratégies d'usinage sont fournis par l'utilisateur.

Type ME**
Pour le processus de fraisage, le bloc titane CFAO type ME est fixé avec la rainure avant de sa section cylindrique à l'aide d'un support de fraisage pour piliers PreFace® de Medentika®. Ces supports de fraisage sont disponibles pour des machines sélectionnées de ce fabricant de machines particulier.
Les blocs de titane CFAO requièrent une bibliothèque CFAO spécifique au produit disponible sur demande parmi les logiciels CFAO sélectionnés du fournisseur de logiciels.

Les géométries des blocs en titane CFAO CONELOG® sont disponibles sous forme de bibliothèque de CAO pour les principaux systèmes de CAO dentaire. Les bibliothèques sont disponibles en téléchargement gratuit sur :
https://www.camlog.fr/fr/mediacenter/bibliotheques-cao

Medentika® et PreFace® sont des marques déposées de la société Medentika GmbH, D-Hügelsheim.

Piliers universels

Restaurations scellées sur couronnes et bridges

	Article	N° d'article	Ø	Dimensions
	Pilier universel CONELOG® personnalisable, avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2211.3300	3.3 mm*	-
		C2211.3800	3.8 mm	
		C2211.4300	4.3 mm	
		C2211.5000	5.0 mm	

Pilier or-plastique

Restaurations scellées sur couronnes et bridges

	Article	N° d'article	Ø	Poids du métal précieux
	Pilier or-plastique CONELOG® calcinable pour technique de coulée, avec vis de pilier **Matériau** Alliage d'or pour technique de coulée/ POM	C2246.3300	3.3 mm*	ca. 0.31 g
		C2246.3800	3.8 mm	ca. 0.36 g
		C2246.4300	4.3 mm	ca. 0.36 g
		C2246.5000	5.0 mm	ca. 0.55 g

* Uniquement pour les restaurations sur couronnes dans la zone des incisives latérales supérieures, et des incisives latérales et centrales inférieures (Ø 3.3 mm non compatible avec les restaurations sur coiffes télescopiques)

Système prothétique Logfit®

Restaurations scellées sur couronnes et bridges

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Piliers CONELOG® Logfit® avec vis de pilier **Matériau** Alliage de titane	C2550.3810	3.8 mm	1.0 mm
		C2550.3825		2.5 mm
		C2550.4310	4.3 mm	1.0 mm
		C2550.4325		2.5 mm
		C2550.5010	5.0 mm	1.0 mm
		C2550.5025		2.5 mm
	Coiffes de prise d'empreinte Logfit® **Matériau** POM	J2551.4300	3.8 mm	-
			4.3 mm	
		J2551.6000	5.0 mm	
	Analogues Logfit® **Matériau** Alliage de titane	J2552.4300	3.8 mm	-
			4.3 mm	
		J2552.6000	5.0 mm	
	Coiffes en résine Logfit®, **pour couronnes** **(avec dispositif anti-rotationnel)** calcinables **Matériau** POM	J2553.4302	3.8 mm	-
			4.3 mm	
		J2553.6002	5.0 mm	
	Coiffes en résine Logfit®, **pour bridges** **(sans dispositif anti-rotationnel)** calcinables **Matériau** POM	J2553.4301	3.8 mm	-
			4.3 mm	
		J2553.6001	5.0 mm	

COMFOUR®

Prothèses à vissage occlusal

	Article	N° d'article	Type	Ø	HG	PP Ø
	Pilier barre CONELOG®, droit stérile **Matériau** Alliage de titane	C2254.3310	-	3.3 mm	1.0 mm	4.3 mm
		C2254.3325			2.5 mm	
		C2254.3810		3.8 mm	1.0 mm	4.3 mm
		C2254.3825			2.5 mm	
		C2254.3840			4.0 mm	
		C2254.4310		4.3 mm	1.0 mm	4.3 mm
		C2254.4325			2.5 mm	
		C2254.4340			4.0 mm	
		C2254.5010		5.0 mm	1.0 mm	6.0 mm
		C2254.5025			2.5 mm	
		C2254.5040			4.0 mm	
	Pilier barre CONELOG®, angulé à 17° avec vis pour pilier bleu clair anodisé avec tête étroites, stérile **Matériau** Alliage de titane	C2256.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2256.3340			4.0 mm	
		C2257.3325	B		2.5 mm	
		C2257.3340			4.0 mm	
		C2256.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2256.3840			4.0 mm	
		C2257.3825	B		2.5 mm	
		C2257.3840			4.0 mm	
		C2256.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2256.4340			4.0 mm	
		C2257.4325	B		2.5 mm	
		C2257.4340			4.0 mm	
		C2256.5025	A	5.0 mm	2.5 mm	6.0 mm
		C2256.5040			4.0 mm	
		C2257.5025	B		2.5 mm	
		C2257.5040			4.0 mm	
	Pilier barre CONELOG®, angulé à 30° avec vis pour pilier bleu clair anodisé avec tête étroite, stérile **Matériau** Alliage de titane	C2258.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2258.3340			4.0 mm	
		C2259.3325	B		2.5 mm	
		C2259.3340			4.0 mm	
		C2258.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2258.3840			4.0 mm	
		C2259.3825	B		2.5 mm	
		C2259.3840			4.0 mm	
		C2258.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2258.4340			4.0 mm	
		C2259.4325	B		2.5 mm	
		C2259.4340			4.0 mm	
		C2258.5035	A	5.0 mm	3.5 mm	6.0 mm
		C2258.5050			5.0 mm	
		C2259.5035	B		3.5 mm	
		C2259.5050			5.0 mm	

Types A et B voir page 6

COMFOUR®

Prothèses à vissage occlusal

	Article	N° d'article	Ø	Dimensions
	Modèle d'orientation pour COMFOUR® pour un forage pilote Ø 2.0 mm **Matériau** Nitinol	J3551.0001	-	-
	Jauge de positionnement à pour piliers barre angulés, pour porte-implant **Matériau** Acier inoxydable	J2269.0003*	-	17°
		J2269.0004*	-	30°
		J2269.0005**	-	17°
		J2269.0006**	-	30°
	Jauge de hauteur gingivale, droite **Matériau** Alliage de titane	J3550.3300	3.3 mm	-
		J3550.3800	3.8 mm	
		J3550.4300	4.3 mm	
		J3550.5000	5.0 mm	
	Instrument de vissage pour piliers de prise d'empreinte et coiffes de cicatrisation des structures sur barre **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0027	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	19.1 mm
		J5300.0028	5.0 mm	
	Coiffe de cicatrisation pour pilier barre bleu clair anodisé en partie, stérile **Matériau** Alliage de titane	J2029.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
		J2029.6000	5.0 mm	
	Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, court, porte-empreinte fermé (bridges/barre) bleu clair anodisé en partie, stérile **Matériau** Alliage de titane	J2129.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	6.5 mm
		J2129.6000	5.0 mm	7.0 mm
	Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, long, porte-empreinte fermé (bridges/barre) bleu clair anodisé en partie, stérile **Matériau** Alliage de titane	J2129.4310	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	11.0 mm
		J2129.6010	5.0 mm	
	Analogue de laboratoire pour barre, pour structures sur barre **Matériau** Acier inoxydable	J3020.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
		J3020.6000	5.0 mm	
	Analogue d'implant pour barre pour structures sur barre pour modèles imprimés et fonte **Matériau** Acier inoxydable	J3025.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
		J3025.6000	5.0 mm	
	Coiffe de scannage, pour pilier barre avec vis prothétique, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** PEEK	J2610.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
		J2610.6000	5.0 mm	
	Coiffe en titane pour pilier barre, pour couronne avec vis prothétique, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** Alliage de titane	J2259.4301	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
		J2259.6001	5.0 mm	

* Uniquement pour l´ utilisation avec les implants CONELOG® avec n° d'article C1062.xxxx et C1063.xxxx.

** Uniquement pour l´ utilisation avec les implants CONELOG® avec n° d'article C1064.xxxx et C1086.xxxx.

	Article	N° d'article	Ø			Dimensions
	Coiffe en titane pour pilier barre, pour bridge avec vis prothétique, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** Alliage de titane	J2259.4302	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2259.6002	5.0 mm			
	Coiffe en titane sans rétention pour pilier barre, pour bridge avec vis prothétique, bleu clair anodisé **Matériau** Alliage de titane	J2259.4322	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2259.6022	5.0 mm			
	Coiffe pour couronne pour pilier barre calcinable **Matériau** POM	J2256.4306	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2256.6006	5.0 mm			
	Coiffe pour structure sur barre calcinable **Matériau** POM	J2257.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2257.6001	5.0 mm			
	Coiffe pour structure sur barre calcinable **Matériau** Alliage d'or pour technique de coulée/POM	J2263.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	ca. 0.48 g
		J2263.6000	5.0 mm			ca. 0.70 g
	Coiffe pour structure sur barre soudable **Matériau** Alliage d'or pour technique de brasage	J2258.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2258.6000	5.0 mm			
	Coiffe pour structure sur barre, titane soudable au laser **Matériau** Titane Grade 4	J2262.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2262.6000	5.0 mm			
	Base de collage en titane pour structure sur barre Passive-Fit **Matériau** Alliage de titane	J2260.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2260.6001	5.0 mm			
	Coiffe pour base de collage en titane calcinable, Passive-Fit, avec vis de prothèse, pour structure sur barre, hex (uniquement pour la réalisation de l'armature coulée en association avec les gaines pour base de collage en titane, Passive-Fit) **Matériau** POM	J2261.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2261.6001	5.0 mm			
	Protection de polissage pour coiffes et bases pour pillier barre **Matériau** Alliage de titane	J3021.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	Filetage M 1.6
		J3021.6000	5.0 mm			Filetage M 2.0

COMFOUR®

Prothèses à vissage occlusal

	Article	N° d'article	Ø			Filetage
	Attachement Locator® pour pilier barre **Matériau** Alliage de titane/TiN	J2253.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2253.6001	5.0 mm			
	Vis à tête étroite pour pilier CONELOG® hex, bleu clair anodisé **Matériau** Alliage de titane	C4004.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M 1.6
		C4004.2001	5.0 mm			M 2.0
	Vis de laboratoire à tête étroite CONELOG® hex, bleu clair anodisé en partie **Matériau** Alliage de titane	C4004.1600	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M 1.6
		C4004.2000	5.0 mm			M 2.0
	Vis prothétique, pour pilier barre hex, bleu clair anodisé (pour la fixation définitive de la restauration) **Matériau** Alliage de titane	J4012.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M 1.6
		J4012.2001	5.0 mm			M 2.0
	Vis de laboratoire prothétique, pour pilier barre hex, brun anodisé **Matériau** Alliage de titane	J4013.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M 1.6
		J4013.2001	5.0 mm			M 2.0
	**Vis, hex, longueur 10 mm** peut être raccourcie de 2.5 mm, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** Alliage de titane	J4012.1610	-			M 1.6
		J4012.2010				M 2.0
	**Vis, hex, longueur 15 mm** peut être raccourcie de 2.5 mm, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** Alliage de titane	J4012.1615	-			M 1.6
		J4012.2015				M 2.0
	Vis, hex, longueur 20 mm peut être raccourcie de 2.5 mm, bleu clair anodisé, stérile **Matériau** Alliage de titane	J4012.1620	-			M 1.6
		J4012.2020				M 2.0

Les vis de laboratoire ne doivent pas être utilisées sur le patient.

	Article	N° d'article	Ø	Filetage
	Vis en plastique pour pilier barre hex, longueur 27 mm, stérile **Matériau** PEEK	J4009.1627	-	M 1.6
		J4009.2027		M 2.0

Système d'ancrage sphérique

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Set de pilier pour ancrage sphérique CONELOG®, partie mâle avec bague de stabilisation **Matériau** Alliage de titane/plastique	C2249.3315	3.3 mm	1.5 mm
		C2249.3330		3.0 mm
		C2249.3815	3.8 mm	1.5 mm
		C2249.3830		3.0 mm
		C2249.3845		4.5 mm
		C2249.4315	4.3 mm	1.5 mm
		C2249.4330		3.0 mm
		C2249.4345		4.5 mm
		C2249.5015	5.0 mm	1.5 mm
		C2249.5030		3.0 mm
		C2249.5045		4.5 mm
	Matrice CM Dalbo®-Plus pour ancrage sphérique, avec insert de rétention à lamelles **Matériau** Titane Grade 4/alliage d'or	05003503	3.3 mm	-
			3.8 mm	
			4.3 mm	
			5.0 mm	
	Insert de rétention à lamelles pour matrice CM Dalbo®-Plus **Matériau** Alliage d'or	05003504	3.3 mm	-
			3.8 mm	
			4.3 mm	
			5.0 mm	

Dalbo®-Plus est une marque déposée de la société Cendres + Métaux SA, Biel/Bienne, Suisse.

Système d'ancrage sphérique

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Analogue de pilier pour ancrage sphérique avec bague de stabilisation **Matériau** Laiton/Plastique	C3015.3300	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-
		C3015.5000	5.0 mm	

Système d'ancrage Locator®

CONELOG® Locator R-Tx®

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Pilier CONELOG® Locator R-Tx® avec boîtier de retention avec insert de travail noir, bague de protection blanche et quatre inserts de rétention différents **Matériau** Alliage de titane/nylon	30805-01	3.3 mm	1.0 mm
		30805-02		2.0 mm
		30805-03		3.0 mm
		30805-04		4.0 mm
		30806-01	3.8 mm	1.0 mm
		30806-02		2.0 mm
		30806-03		3.0 mm
		30806-04		4.0 mm
		30806-05		5.0 mm
		30807-01	4.3 mm	1.0 mm
		30807-02		2.0 mm
		30807-03		3.0 mm
		30807-04		4.0 mm
		30807-05		5.0 mm
		30808-01	5.0 mm	1.0 mm
		30808-02		2.0 mm
		30808-03		3.0 mm
		30808-04		4.0 mm
		30808-05		5.0 mm
	Capuchons d'empreinte Locator R-Tx® (4 pièces) **Matériau** Polythène	30017-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Analogue de pilier Locator R-Tx® Ø 3.35 mm (4 pièces) **Matériau** Aluminium	30014-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Analogue de pilier Locator R-Tx® Ø 5.0 mm (4 pièces) **Matériau** Aluminium	30016-01	5.0 mm	-
	Boîtier de retention Locator R-Tx® avec insert de travail noir (4 pièces) **Matériau** Alliage de titane/Polythène	30013-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Insert de travail Locator R-Tx® noir (4 pièces) **Matériau** Polythène	30012-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Bagues de protection Locator R-Tx®, blanche (4 pièces) **Matériau** Polythène	30018-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® gris, SANS RÉTENTION (4 pièces) **Matériau** Nylon	30001-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® bleu, FAIBLE (4 pièces) **Matériau** Nylon	30002-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® rose, MOYENNE (4 pièces) **Matériau** Nylon	30003-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-

Système d'ancrage Locator®

CONELOG® Locator R-Tx®

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Inserts de rétention Locator R-Tx® blanc, FORTE (4 pièces) **Matériau** Nylon	30004-01	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-

Système d'ancrage Locator®

CONELOG® Locator®

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Pilier CONELOG® Locator® **Matériau** Alliage de titane/TiN	C2253.3310	3.3 mm	1.0 mm
		C2253.3320		2.0 mm
		C2253.3330		3.0 mm
		C2253.3340		4.0 mm
		C2253.3810	3.8 mm	1.0 mm
		C2253.3820		2.0 mm
		C2253.3830		3.0 mm
		C2253.3840		4.0 mm
		C2253.3850		5.0 mm
		C2253.4310	4.3 mm	1.0 mm
		C2253.4320		2.0 mm
		C2253.4330		3.0 mm
		C2253.4340		4.0 mm
		C2253.4350		5.0 mm
		C2253.5010	5.0 mm	1.0 mm
		C2253.5020		2.0 mm
		C2253.5030		3.0 mm
		C2253.5040		4.0 mm
		C2253.5050		5.0 mm
	Capuchon d'empreinte Locator® (4 pièces) **Matériau** Aluminium/Polyéthylène	J2253.0200	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-
	Analogue de laboratoire Locator® (4 pièces) **Matériau** Aluminium	J2253.0340	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-

	Article	N° d'article	⌀
	Set de laboratoire Locator® (2 pièces) **Contenu de chaque set:** 1 boîtier de rétention avec insert de travail, 1 espaceur blanc, 1 insert de rétention transparent, 1 insert de rétention rose, 1 insert de rétention bleu **Matériau** Alliage de titane/Polyéthylène/ Teflon/Nylon	J2253.0102	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Set de laboratoire Locator® pour angulation élargie (2 pièces) **Contenu de chaque set:** 1 boîtier de rétention avec insert de travail, 1 espaceur blanc, 1 insert de rétention vert, 1 insert de rétention orange, 1 insert de rétention rouge **Matériau** Alliage de titane/Polyéthylène/ Teflon/Nylon	J2253.0112	3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Espaceur blanc Locator® (20 pièces) **Matériau** Teflon	J2253.0401	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de travail Locator® (4 pièces) **Matériau** Polyethylen	J2253.0402	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® transparent, RÉTENTION FORTE, div.: 0° – 10° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.1005	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm

Système d'ancrage Locator®

CONELOG® Locator®

	Article	N° d'article	Ø
	Insert de rétention Locator® rose, RÉTENTION MOYENNE, div.: 0° – 10° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.1003	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® bleu, RÉTENTION FAIBLE, div.: 0° – 10° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.1002	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® **pour angulation élargie*** vert, RÉTENTION FORTE, div.: 10° – 20° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.2004	3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® **pour angulation élargie*** orange, RÉTENTION MOYENNE, div.: 10° – 20° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.2003	3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® **pour angulation élargie*** rouge, RÉTENTION FAIBLE, div.: 10° – 20° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.2002	3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm
	Insert de rétention Locator® **pour angulation élargie*** gris, AUCUNE RÉTENTION, div.: 0° – 20° (4 pièces) **Matériau** Nylon	J2253.2000	3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm

* non autorisée pour les implants de Ø 3.3 mm

Fabricant de Locator®: Zest Anchors, 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, Californie 92010, USA
Locator® et Locator R-Tx® sont des marques déposées de la société Zest Anchors.

Restaurations télescopiques

	Article	N° d'article	Ø
	Pilier universel CONELOG® pour la technique de la couronne télescopique personnalisable, avec la vis de pilier CONELOG® **Matériau** Alliage de titane	C2211.3800	3.8 mm
		C2211.4300	4.3 mm
		C2211.5000	5.0 mm
	Piliers télescopiques CONELOG® pour la technique de la couronne télescopique personnalisable, avec la vis de pilier CONELOG® **Matériau** Alliage de titane	C2212.3800	3.8 mm
		C2212.4300	4.3 mm
		C2212.5000	5.0 mm

Accessoires pour piliers

	Article	N° d'article	Ø	Filetage
	Vis de pilier CONELOG®, hex pour le vissage définitif dans l'implant **Matériau** Alliage de titane	C4005.1601	3.3 mm	M 1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4005.2001	5.0 mm	M 2.0
	Vis de laboratoire CONELOG®, hex pour la fixation sur le modèle de travail, brun anodisé **Matériau** Alliage de titane	C4006.1601	3.3 mm	M 1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4006.2001	5.0 mm	M 2.0

Les vis de laboratoire ne doivent pas être utilisées sur le patient.

Instruments prothétiques

	Article	N° d'article	L
	Clé dynamométrique avec réglage du couple en continu jusqu'à 30 Ncm max. **Matériau** Acier inoxydable	J5320.1030	-
	Instrument de vissage pour le système d'ancrage sphérique, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0011	18.3 mm
	Tournevis activateur de la matrice du système d'ancrage sphérique CM Dalbo®-Plus **Matériau** Acier inoxydable	07000389	-
	Instrument de vissage, **pour structure sur barre, court** Ø 3.3/3.8/4.3 mm **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0020	18.6 mm
	Instrument de vissage, **pour structure sur barre, court** Ø 5.0 mm **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0025	18.6 mm

	Article	N° d'article	L
	Instrument de pose, long, pour piliers barre droit Ø 3.3/3.8/4.3 mm **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0021	28.0 mm
	Instrument de vissage pour piliers de prise d'empreinte et coiffes de cicatrisation des structures sur barre Ø 3.3/3.8/4.3 mm **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0027	19.1 mm
	Instrument de vissage pour piliers de prise d'empreinte et coiffes de cicatrisation des structures sur barre Ø 5.0 mm **Matériau** Acier inoxydable	J5300.0028	19.1 mm
	Instrument de vissage pour Locator®, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J2253.0001	24.3 mm
	Instrument Locator® démontable en 3 parties **Matériau** Acier inoxydable	J2253.0002	83.0 mm
	Embout pour instrument de pose Locator® pour composant-or de l'instrument Locator® (4 pièces) **Matériau** Polysulfone	08394	-
	Jauge d'angulation Locator® **Matériau** Polyéthylène	J2253.0003	-
	Pilier de parallélisme Locator® (4 pièces) **Matériau** Polyethylene	J2253.0004	-

Instruments prothétiques

	Article	N° d'article	Dimensions
	Instrument de pose pour inserts de retention Locator R-Tx® avec poignée en plastique **Matériau** Acier inoxydable	30021-01	
	Set prothétique Contenu: - J5320.1030 Clé dynamométrique - J5317.0501 Tournevis, hex, court, manuel/clé dynamométrique - J5317.0502 Tournevis, hex, long, manuel/clé dynamométrique - J5317.0504 Tournevis, hex, court, norme ISO - J5317.0503 Tournevis, hex, long, norme ISO	J5330.8600	197 x 108 x 54 mm
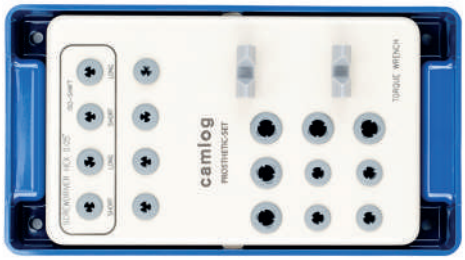	**Trousse prothétique** (vide) **Matériau** Plastique	J5330.8500	197 x 108 x 54 mm
	Trousse prothétique universelle (vide) re-stérilisable **Matériau** Radel®, Silicone	J5330.8700	162 x 73 x 29 mm
	Tournevis hex, extra court, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0510	14.5 mm
	Tournevis hex, court, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0501	22.5 mm

	Article	N° d'article	Ø	Dimensions
	Tournevis hex, long, manuel/clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0502	-	30.3 mm
	Tournevis hex, court, norme ISO **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0504	-	18.0 mm
	Tournevis hex, long, norme ISO **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0503	-	26.0 mm
	Tournevis à main hex, sans tête de clé dynamométrique **Matériau** Acier inoxydable	J5317.0511	-	23.0 mm
	Prise en main pour analogue d'implant CAMLOG®/CONELOG® **Matériau** Acier inoxydable	J3025.0010	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-
		J3025.0015	5.0 mm	
	Déconnecteur CONELOG® pour piliers CONELOG®, court **Matériau** Acier inoxydable	C5300.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	Filetage M 1.6
		C5300.2001	5.0 mm	Filetage M 2.0
	Déconnecteur CONELOG® pour piliers CONELOG®, long **Matériau** Acier inoxydable	C5300.1603	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	Filetage M 1.6
		C5300.2003	5.0 mm	Filetage M 2.0

Instruments dentaires

	Article	N° d'article	Ø
	Manche universel avec 2 vis de laboratoire CONELOG®, hex, et 1 logement support pour pilier CONELOG® Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm **Matériau** Acier inoxydable/Alliage de titane	C3709.0010	-
	Manche universel **Matériau** Acier inoxydable	J3709.0015	-
	Support pour piliers CONELOG® pour manche universel, en vue du meulage de piliers CONELOG® **Matériau** Alliage de titane	C3709.3300	3.3 mm
		C3709.3800	3.8 mm
		C3709.4300	4.3 mm
		C3709.5000	5.0 mm
	Instrument de retouche de l'intrados, pour coiffes de barre surfaces planes/cônes, pour coiffes calcinables **Matériau** Acier inoxydable	J3711.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0015	5.0 mm
	Instrument de retouche de l'intrados, pour coiffes de barre siège de vis, pour coiffes calcinables **Matériau** Acier inoxydable	J3711.0020	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0025	5.0 mm

Piliers de sélection

	Article	N° d'article
	Set de piliers de sélection CONELOG® (Contenu: 2 pièces chacun, voir tableau ci-dessous)	C8011.1000

Contenu: Set de piliers de sélection CONELOG®					
Article	Matériau	Ø			HG
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit*	POM	3.8 mm	4.3 mm	5.0 mm	1.5 – 2.5 mm
					3.0 – 4.5 mm
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A*					1.5 – 2.5 mm
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B*					
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A*					
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B*					

Attention, les piliers de sélection ne doivent pas être utilisés sur les patients!

* Ces produits ne sont pas disponibles séparément.

camlog

Implants factices

	Article	N° d'article	Ø	L
	Implant factice **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** avec porte implant clipsé et vis de fermeture, jaune anodisé **Matériau** Alliage de titane	C1901.3813	3.8 mm	13 mm
	Implant factice **CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** avec porte implant clipsé et vis de fermeture, rouge anodisé **Matériau** Alliage de titane	C1901.4313	4.3 mm	
	Implant factice **CONELOG® SCREW-LINE** avec porte-implant et vis de fermeture, jaune anodisé **Matériau** Alliage de titane	C1069.3813	3.8 mm	13 mm
	Implant factice **CONELOG® SCREW-LINE** avec porte-implant et vis de fermeture, rouge anodisé **Matériau** Alliage de titane	C1069.4313	4.3 mm	

Attention: ne pas utiliser les implants factices sur les patients!

Modèles de démonstration

	Article	N° d'article
	Modèle de démonstration CONELOG®, Plexiglas maxillaire, 4 implants CONELOG® SCREW-LINE, 4 x Ø 4.3 mm **Matériau** Plexiglas/Titane	C8070.1020
	Modèle de démonstration CONELOG®, Plexiglas mandibule, 4 implants CONELOG® SCREW-LINE, 4 x Ø 4.3 mm **Matériau** Plexiglas/Titane	C8050.1040
	Mandibule avec édentation complète avec plaquette de montage **Matériau** Plastique	J8070.2050

Macro modèles

	Article	N° d'article
	Macro modèle CONELOG® PROGRESSIVE-LINE échelle 3:1 **Contenu:** 1 implant CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 1 pilier CONELOG® Esthomic®, droit 1 vis de pilier CONELOG®, hex 1 tournevis, hex 1 couronne prémolaire pour pilier CONELOG® Esthomic®, droit 1 socle en plexiglas **Matériau** Plastique/Acier inoxydable	C8010.1400
	Macro modèle CONELOG® SCREW-LINE échelle 3:1 **Contenu:** 1 implant CONELOG® SCREW-LINE 1 pilier CONELOG® Esthomic®, droit 1 vis de pilier CONELOG®, hex 1 tournevis, hex 1 couronne prémolaire pour pilier CONELOG® Esthomic®, droit 1 socle en plexiglas **Matériau** Plastique/Acier inoxydable	C8010.1010

Littérature

	Article	N° d'article
	Brochure destinée aux patients Questions et réponses concernant les implants dentaires	-
	COMFOUR® Brochure destinée aux patients Bridge plutôt que prothèse amovible – une restauration confortable	-
	Passeport d'implant Documentation individualisée de la restauration par implant Conditionnement : 10 pièces	-
	Feuilles de conseils pour patients Set de 5 feuilles, A4	-
	Pochette de présentation A4, laminée	-

	Article	N° d'article
	Poster Format: 50 x 70 cm	-
	Carnet de rendez-vous 50 feuilles/carnet, A7 Conditionnement : 5 pièces	-

Aperçu des indications

Restauration unitaire		Définitive pour bridge
Scellée	**Vissée**	**Scellée**
	Piliers provisoires, alliage de titane, couronne	
Piliers Esthomic®		Piliers Esthomic®
	Piliers pour barre	
Base en titane CFAO, couronne	Base en titane CFAO, couronne	Base en titane CFAO, bridge
Pilier Logfit®		Pilier Logfit®
Pilier universel Bloc titane CFAO		Pilier universel Bloc titane CFAO
Pilier or-plastique	Pilier or-plastique	Pilier or-plastique

Définitive pour bridge	Restaurations hybrides	
Vissée	**Amovible (prothèse totale)**	
Piliers provisoires, alliage de titane, bridge		
Piliers pour barre	Piliers pour barre	
Base en titane CFAO, bridge		
	Pilier Locator®	
	Pilier pour ancrage sphérique	
	Technique de la coiffe télescopique	Pilier universel Bloc titane CFAO
		Pilier télescopique
		Pilier or-plastique
		Base en titane CFAO, couronne

Gammes d'implants

Article	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	L
	N° d'article A Ø				
Implant CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Promote® plus avec porte implant vissé	-	C1085.3807 A Ø 3.0 mm	C1085.4307 A Ø 3.0 mm	C1085.5007 A Ø 3.5 mm	7 mm
	C1085.3309 A Ø 2.2 mm	C1085.3809 A Ø 3.0 mm	C1085.4309 A Ø 3.0 mm	C1085.5009 A Ø 3.5 mm	9 mm
	C1085.3311 A Ø 2.2 mm	C1085.3811 A Ø 2.7 mm	C1085.4311 A Ø 2.7 mm	C1085.5011 A Ø 3.2 mm	11 mm
	C1085.3313 A Ø 2.2 mm	C1085.3813 A Ø 2.7 mm	C1085.4313 A Ø 2.7 mm	C1085.5013 A Ø 3.2 mm	13 mm
	C1085.3316 A Ø 2.2 mm	C1085.3816 A Ø 2.7 mm	C1085.4316 A Ø 2.7 mm	C1085.5016 A Ø 3.2 mm	16 mm
Implant CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Promote® plus avec porte implant clipsé	-	C1086.3807 A Ø 3.0 mm	C1086.4307 A Ø 3.0 mm	C1086.5007 A Ø 3.5 mm	7 mm
	C1086.3309 A Ø 2.2 mm	C1086.3809 A Ø 3.0 mm	C1086.4309 A Ø 3.0 mm	C1086.5009 A Ø 3.5 mm	9 mm
	C1086.3311 A Ø 2.2 mm	C1086.3811 A Ø 2.7 mm	C1086.4311 A Ø 2.7 mm	C1086.5011 A Ø 3.2 mm	11 mm
	C1086.3313 A Ø 2.2 mm	C1086.3813 A Ø 2.7 mm	C1086.4313 A Ø 2.7 mm	C1086.5013 A Ø 3.2 mm	13 mm
	C1086.3316 A Ø 2.2 mm	C1086.3816 A Ø 2.7 mm	C1086.4316 A Ø 2.7 mm	C1086.5016 A Ø 3.2 mm	16 mm

Article	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	L
	A Ø 2.7 mm	A Ø 3.5 mm	A Ø 3.9 mm	A Ø 4.6 mm	
Implant CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant clipsé	-	C1066.3807	C1066.4307	C1066.5007	7 mm
	C1066.3309	C1066.3809	C1066.4309	C1066.5009	9 mm
	C1066.3311	C1066.3811	C1066.4311	C1066.5011	11 mm
	C1066.3313	C1066.3813	C1066.4313	C1066.5013	13 mm
	C1066.3316	C1066.3816	C1066.4316	C1066.5016	16 mm
Implant CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant vissé	-	C1065.3807	C1065.4307	C1065.5007	7 mm
	C1065.3309	C1065.3809	C1065.4309	C1065.5009	9 mm
	C1065.3311	C1065.3811	C1065.4311	C1065.5011	11 mm
	C1065.3313	C1065.3813	C1065.4313	C1065.5013	13 mm
	C1065.3316	C1065.3816	C1065.4316	C1065.5016	16 mm

Aperçu du systeme prothétique

Prise d’empreinte de l’implant

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Article		N° d’article				HG
	Pilier de prise d’empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert	C2121.3300	C2121.3800	C2121.4300	C2121.5000	-
	Pilier de prise d’empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé	C2110.3300	C2110.3800	C2110.4300	C2110.5000	-
	Capuchon de repositionnement pour pilier de prise d’empreinte, porte-empreinte fermé	J2111.3300	J2111.3800	J2111.4300	J2111.5000	-

Enregistrement de l’occlusion

	Pilier d’enregistrement de l’occlusion CONELOG®, avec capuchon d’enregistrement de l’occlusion	C2140.3300	C2140.3800	C2140.4300	C2140.5000	-

Fabrication du modèle

	Article	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	HG
		N° d'article				
	Analogue de laboratoire CONELOG® pour modèles coulés	C3010.3300	C3010.3800	C3010.4300	C3010.5000	-
	Analogue d'implant CONELOG® pour modèles imprimés et coulés	C3025.3300	C3025.3800	C3025.4300	C3025.5000	-
	DIM® Analogue pour le système d'implants CONELOG®, pour modèles imprimés	C3012.3300	C3012.4300	C3012.4300	C3012.5000	-

Piliers pour restaurations sur couronnes et bridges

	Pilier provisoire CONELOG®, couronne, Alliage de titane	C2239.3300	C2239.3800	C2239.4300	C2239.5000	-
	Pilier provisoire CONELOG®, bridge, Alliage de titane	C2339.3300	C2339.3800	C2339.4300	C2339.5000	-
	Pilier CONELOG® Esthomic® droit	-	C2226.3815	C2226.4315	C2226.5015	1.5 – 2.5
			C2226.3830	C2226.4330	C2226.5030	3.0 – 4.5
	Pilier CONELOG® Esthomic® angulé 15°, type A	-	C2227.3815	C2227.4315	C2227.5015	1.5 – 2.5
			C2227.3830	C2227.4330	C2227.5030	3.0 – 4.5
	Pilier CONELOG® Esthomic® angulé 15°, type B	-	C2228.3815	C2228.4315	C2228.5015	1.5 – 2.5
			C2228.3830	C2228.4330	C2228.5030	3.0 – 4.5
	Pilier CONELOG® Esthomic® angulé 20°, type A	-	C2231.3815	C2231.4315	C2231.5015	1.5 – 2.5
			C2231.3830	C2231.4330	C2231.5030	3.0 – 4.5
	Pilier CONELOG® Esthomic® angulé 20°, type B	-	C2232.3815	C2232.4315	C2232.5015	1.5 – 2.5
			C2232.3830	C2232.4330	C2232.5030	3.0 – 4.5

Aperçu du systeme prothétique

Piliers pour restaurations sur couronnes et bridges

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Article		N° d'article				HG
	Pilier CONELOG® Esthomic® Inset	C2235.3320	C2235.3820	C2235.4320	C2235.5020	2.0 – 3.3 mm
	Pilier universel CONELOG®	C2211.3300	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000	-
	Pilier or-plastique CONELOG®	C2246.3300	C2246.3800	C2246.4300	C2246.5000	-
	Base en titane CFAO CONELOG®, couronne	C2242.3308	C2242.3808	C2242.4308	C2242.5008	0.8 mm
		C2242.3320	C2242.3820	C2242.4320	C2242.5020	2.0 mm
	Base en titane CFAO CONELOG®, bridge	C2342.3308	C2342.3808	C2342.4308	C2342.5008	0.8 mm
		C2342.3320	C2342.3820	C2342.4320	C2342.5020	2.0 mm
	Pilier CONELOG® Logfit®	-	C2550.3810	C2550.4310	C2550.5010	1.0 mm
			C2550.3825	C2550.4325	C2550.5025	2.5 mm
	Capuchon d'empreinte Logfit®	-	J2551.4300	J2551.4300	J2551.6000	-
	Analogue de laboratoire Logfit®	-	J2552.4300	J2552.4300	J2552.6000	-
	Coiffe calcinable Logfit®, pour couronnes	-	J2553.4302	J2553.4302	J2553.6002	-
	Coiffe calcinable Logfit®, pour bridges	-	J2553.4301	J2553.4301	J2553.6001	-

COMFOUR® – Piliers pour restaurations sur couronnes, bridges et hybrides

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Article	N° d'article				HG
Pilier barre CONELOG®, droit	C2254.3310	C2254.3810	C2254.4310	C2254.5010	1.0 mm
	C2254.3325	C2254.3825	C2254.4325	C2254.5025	2.5 mm
	-	C2254.3840	C2254.4340	C2254.5040	4.0 mm
Pilier barre CONELOG®, angulé à 17°, type A	C2256.3325	C2256.3825	C2256.4325	C2256.5025	2.5 mm
	C2256.3340	C2256.3840	C2256.4340	C2256.5040	4.0 mm
Pilier barre CONELOG®, angulé à 17°, type B	C2257.3325	C2257.3825	C2257.4325	C2257.5025	2.5 mm
	C2257.3340	C2257.3840	C2257.4340	C2257.5040	4.0 mm
Pilier barre CONELOG®, angulé à 30°, type A	C2258.3325	C2258.3825	C2258.4325	C2258.5035*	2.5 mm/ 3.5 mm*
	C2258.3340	C2258.3840	C2258.4340	C2258.5050*	4.0 mm/ 5.0 mm*
Pilier barre CONELOG®, angulé à 30°, type B	C2259.3325	C2259.3825	C2259.4325	C2259.5035*	2.5 mm/ 3.5 mm*
	C2259.3340	C2259.3840	C2259.4340	C2259.5050*	4.0 mm/ 5.0 mm*
Coiffe de cicatrisation pour pilier barre	J2029.4300	J2029.4300	J2029.4300	J2029.6000	-
Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, court, porte-empreinte fermé (bridges/barre)	J2129.4300	J2129.4300	J2129.4300	J2129.6000	-
Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, long, porte-empreinte fermé (bridges/barre)	J2129.4310	J2129.4310	J2129.4310	J2129.6010	-
Coiffe de scannage, pour pilier barre	J2610.4300	J2610.4300	J2610.4300	J2610.6000	-
Coiffe en titane pour pilier barre, pour couronne et pour prise d'empreinte, porte empreinte ouvert	J2259.4301	J2259.4301	J2259.4301	J2259.6001	-
Coiffe en titane pour pilier barre, pour bridge et pour prise d'empreinte, porte empreinte ouvert	J2259.4302	J2259.4302	J2259.4302	J2259.6002	-
Coiffe en titane sans rétention pour pilier barre, pour bridge	J2259.4322	J2259.4322	J2259.4322	J2259.6022	-
Coiffe pour couronne pour pilier barre, calcinable	J2256.4306	J2256.4306	J2256.4306	J2256.6006	-
Coiffe pour structure sur barre, calcinable	J2257.4301	J2257.4301	J2257.4301	J2257.6001	-
Coiffe pour structure sur barre, calcinable	J2263.4300	J2263.4300	J2263.4300	J2263.6000	-

Aperçu du systeme prothétique

COMFOUR® – Piliers pour restaurations sur couronnes, bridges et hybrides

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Article		N° d'article				HG
	Coiffe pour structure sur barre, soudable	J2258.4300	J2258.4300	J2258.4300	J2258.6000	-
	Coiffe pour structure sur barre, titane, soudable au laser	J2262.4300	J2262.4300	J2262.4300	J2262.6000	-
	Base de collage en titane pour structure sur barre, Passive-Fit	J2260.4301	J2260.4301	J2260.4301	J2260.6001	-
	Coiffe pour base de collage en titane, calcinable, Passive-Fit	J2261.4301	J2261.4301	J2261.4301	J2261.6001	-
	Attachement Locator® pour pilier barre	J2253.4301	J2253.4301	J2253.4301	J2253.6001	-

Restaurations hybrides

	Set de pilier pour ancrage sphérique, CONELOG®, partie mâle	C2249.3315	C2249.3815	C2249.4315	C2249.5015	1.5 mm
		C2249.3330	C2249.3830	C2249.4330	C2249.5030	3.0 mm
		-	C2249.3845	C2249.4345	C2249.5045	4.5 mm
	Matrice CM Dalbo®-Plus	05003503	05003503	05003503	05003503	-
	Analogue de pilier pour ancrage sphérique	C3015.3300	C3015.3300	C3015.3300	C3015.5000	-
	Pilier CONELOG® Locator R-Tx®	30805-01	30806-01	30807-01	30808-01	1.0 mm
		30805-02	30806-02	30807-02	30808-02	2.0 mm
		30805-03	30806-03	30807-03	30808-03	3.0 mm
		30805-04	30806-04	30807-04	30808-04	4.0 mm
		-	30806-05	30807-05	30808-05	5.0 mm
	Capuchons d'empreinte Locator R-Tx®	30017-01	30017-01	30017-01	30017-01	-
	Analogue de pilier Locator R-Tx®	30014-01	30014-01	30014-01	30016-01	-
	Boîtier de retention Locator R-Tx®	30013-01	30013-01	30013-01	30013-01	-
	Insert de travail Locator R-Tx®	30012-01	30012-01	30012-01	30012-01	-
	Bagues de protection Locator R-Tx®	30018-01	30018-01	30018-01	30018-01	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® gris, SANS RÉTENTION	30001-01	30001-01	30001-01	30001-01	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® bleu, FAIBLE	30002-01	30002-01	30002-01	30002-01	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® rose, MOYENNE	30003-01	30003-01	30003-01	30003-01	-
	Inserts de rétention Locator R-Tx® blanc, FORTE	30004-01	30004-01	30004-01	30004-01	-

	Article	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	HG
		N° d'article				
	Pilier CONELOG® Locator®	C2253.3310	C2253.3810	C2253.4310	C2253.5010	1.0 mm
		C2253.3320	C2253.3820	C2253.4320	C2253.5020	2.0 mm
		C2253.3330	C2253.3830	C2253.4330	C2253.5030	3.0 mm
		C2253.3340	C2253.3840	C2253.4340	C2253.5040	4.0 mm
		-	C2253.3850	C2253.4350	C2253.5050	5.0 mm
	Capuchon d'empreinte Locator®	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	-
	Analogue de laboratoire Locator®	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0340	-
	Set de laboratoire Locator®	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	-
	Set de laboratoire Locator® pour angulation élargie	-	J2253.0112	J2253.0112	J2253.0112	-
	Pilier universel CONELOG®	-	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000	-
	Pilier télescopique CONELOG®	-	C2212.3800	C2212.4300	C2212.5000	-

Prothèses CFAO

	Scanbody CONELOG®	C2600.3310	C2600.4310	C2600.4310	C2600.5010	-
	Piliers de numérisation CONELOG® pour scanbody Sirona®	C2620.3306	C2620.3806	C2620.4306	C2620.5006	-
	Bloc titane CFAO CONELOG®, type IAC	C2411.3313	C2411.4313	C2411.4313	C2411.5013	-
	Bloc titane CFAO CONELOG®, type ME	C2421.3320	C2421.3820	C2421.4320	C2421.5020	-
	Coiffe de scannage, pour pilier barre	J2610.4300	J2610.4300	J2610.4300	J2610.6000	-

Prothèses CFAO individuelles DEDICAM® de Camlog
Votre représentant local Camlog vous donnera des renseignements complémentaires sur DEDICAM®.

Vue d'ensemble des vis Vis de pilier et vis prothétiques – utilisation intraorale

Connexion implant-pilier

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
		M 1.6		M 2.0	
Article	**Vis de pilier CONELOG®**				**Couple de serrage**
Scanbody Piliers de numérisation pour scanbody Sirona®					Vissage à la main**
Piliers provisoires titane, couronne et bridge					
Piliers Esthomic®		8.9 mm C4005.1601		8.9 mm  C4005.2001	20 Ncm*
Pilier universel Pilier télescopique Pilier or-plastique Pilier Logfit®					
Piliers Vario SR droit, angulé à 20° et 30°					
Bloc titane CFAO, type IAC et ME					
	Vis de pilier CONELOG®, pour base en titane CFAO CONELOG®, violet foncé anodisé				
Base en titane CFAO, couronne et bridge		8.9 mm C4015.1601		8.9 mm C4015.2001	20 Ncm*
	Vis de pilier CONELOG® Vario SR				
Pilier Vario SR, droit		10.6 mm C4007.1600		10.6 mm C4007.2000	20 Ncm*
	Vis à tête étroite de pilier CONELOG®, bleu clair anodisé				
COMFOUR® Piliers pour barre, angulé à 17° et 30°		7.8 mm C4004.1601		7.8 mm C4004.2001	20 Ncm*

* avec clé dynamométrique J5320.1030
** En option pour les piliers provisoires en titane: couple de serrage après la phase de cicatrisation 20 Ncm.
Toutes les vis doivent être resserrées 5 minutes après le premier serrage en utilisant le couple adéquat!

Connexion pilier-prothétique

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
		M 1.6		M 2.0	
Article	**Vis prothétique pour pilier barre, bleu clair anodisé**				**Couple de serrage**
COMFOUR® Piliers pour barre droit et angulé à 17° et 30°		3.6 mm J4012.1601		3.8 mm J4012.2001	15 Ncm*
	Vis prothétique Vario SR, jaune anodisé				
Piliers Vario SR droit et angulé à 20° et 30°		4 mm J4005.2004			15 Ncm*

Vis auxiliaires Usage intra- et extraoral

Connexion pilier-prothétique

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
		M 1.6		M 2.0	
Article	**Vis prothétique pour pilier barre, bleu clair anodisé**				**Couple de serrage**
Coiffe de scannage, pour pilier barre		3.6 mm J4012.1601		3.8 mm J4012.2001	Vissage à la main
	Vis pour pilier barre, pour porte-empreinte ouvert et soudage, bleu clair anodisé				
COMFOUR® Piliers pour barre droit et angulé à 17° et 30°		12 mm J4012.1610		12.2 mm J4012.2010	Vissage à la main
		17 mm J4012.1615		17.2 mm  J4012.2015	
		22 mm J4012.1620		22.2 mm J4012.2020	
	Vis en plastique pour pilier barre, aide à la fixation et au collage, beige				
		29 mm J4009.1627		29.2 mm J4009.2027	Vissage à la main

* avec clé dynamométrique J5320.1030
Toutes les vis doivent être resserrées 5 minutes après le premier serrage en utilisant le couple adéquat!

Vue d'ensemble des vis Vis de laboratoire – utilisation extraorale

Connexion pilier-analogue de laboratoire

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
		M 1.6		M 2.0	
Article	**Vis de laboratoire CONELOG®*, brun anodisé**				**Couple de serrage**
Scanbody Piliers de numérisation pour scanbody Sirona®	8.9 mm  C4006.1601			8.9 mm C4006.2001	Vissage à la main
Piliers provisoires Titane, couronne et bridge					
Piliers Esthomic®					
Pilier universel Pilier télescopique Pilier or-plastique					
Piliers Vario SR, angulé à 20° et 30°					
Bloc titane CFAO, type IAC et ME					
	Vis de laboratoire CONELOG®, pour bases en titane CFAO*, brun anodisé en partie				
Base en titane CFAO, couronne et bridge	8.9 mm  C4016.1601			8.9 mm  C4016.2001	Vissage à la main
	Aide au collage CONELOG®**				
Base en titane CFAO, couronne et bridge	26 mm			26 mm	Vissage à la main
	Vis de laboratoire CONELOG® Vario SR*, brun anodisé				
Pilier Vario SR, droit	10.6 mm  C4008.1600			10.6 mm  C4008.2000	Vissage à la main
	Vis de laboratoire à tête étroite CONELOG®* , bleu clair anodisé en partie				
COMFOUR® Piliers pour barre, angulé à 17° et 30°	7.8 mm  C4004.1600			7.8 mm  C4004.2000	Vissage à la main

* Les vis de laboratoire ne doivent pas être utilisées sur le patient.

** non disponibles séparément, fournis avec la base en titane CFAO.

Connexion pilier-prothétique

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
			M 1.6		M 2.0	
Article		Vis prothétique de laboratoire pour pilier barre*, brun anodisé				Couple de serrage
	Coiffe de scannage, pour pilier barre					
	COMFOUR® Piliers pour barre droit et angulé à 17° et 30°		3.6 mm J4013.1601		3.8 mm J4013.2001	Vissage à la main
	Analogue de laboratoire pour barre, pour structures sur barre					
		Vis prothétique Vario SR, jaune anodisé				
	Piliers Vario SR droit et angulé à 20° et 30°	4 mm J4005.2004				Vissage à la main
	Analogue de laboratoire Vario SR					
		Vis prothétique pour pilier barre*, uniquement pour la réalisation du modelage à l'aide de la gaine calcinable pour base de collage en titane, Passive-Fit, sur l'analogue de laboratoire pour barre				
	Base de collage en titane pour structure sur barre et coiffe pour base de collage en titane, calcinable, Passive-Fit		5.5 mm J4005.1602		5.5 mm J4005.2002	Vissage à la main

* Les vis de laboratoire ne doivent pas être utilisées sur le patient.

Aperçu Couple de serrage

Article	Instrument	Couple de serrage
Vis de fermeture pour implants	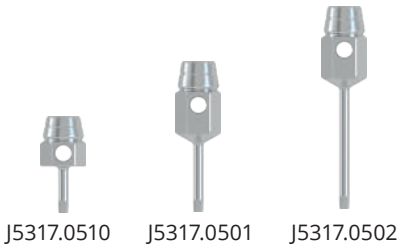 J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503	Vissage à la main**
Pilier de cicatrisation cylindrique, évasées, bottleneck		
Pilier de prise d'empreinte Pilier d'enregistrement de l'occlusion		
Vis de laboratoire Vis de laboratoire à tête étroite		
Piliers provisoires, alliage de titane, couronne et bridge		
Vis de pilier Vis à tête étroite de pilier		20 Ncm*
Pilier Esthomic® droit Pilier Esthomic® angulé 15°/20° Pilier Esthomic®, Inset		
Pilier or-plastique Pilier universel Pilier télescopique		
Pilier Logfit® Base en titane CFAO couronne et bridge		
Bloc titane CFAO, type IAC et ME		

* avec la clé dynamométrique J5320.1030
** En option pour les piliers provisoires en titane: couple de serrage après la phase de cicatrisation 20 Ncm.
Toutes les vis doivent être resserrées 5 minutes après le premier serrage en utilisant le couple adéquat!

	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	Ø 5.0 mm	3.3	3.8	4.3	5.0	6.0
Article	**Instrument**				**Couple de serrage**				
Pilier barre, droit	J5300.0020	J5300.0021		J5300.0025	20 Ncm*				30 Ncm*
Piliers barre, angulé à 17° et 30°									20 Ncm*
Coiffe de scannage, pour pilier barre									Vissage à la main
Coiffe en titane pour pilier barre, couronne/bridge				J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502					
Coiffe pour couronne pour pilier barre, calcinable									15 Ncm*
Coiffe pour structure sur barre, calcinable, soudable, soudable au laser				J5317.0504 J5317.0503					
Base de collage en titane pour structure sur barre, Passive-Fit									
Pilier Locator R-Tx®					20 Ncm*				30 Ncm*
Coiffe de cicatrisation pour pilier barre									Vissage à la main
Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, court, porte-empreinte fermé (bridges/barre)				J5300.0027 J5300.0028					
Pilier sphérique				J5300.0011	20 Ncm*				30 Ncm*
Pilier Locator®				J2253.0001					
Attachement Locator® pour pilier barre									20 Ncm*
Scanbody				J5317.0501 J5317.0502					Vissage à la main
Piliers de numérisation pour scanbody Sirona®									

Toutes les vis doivent être resserrées 5 minutes après le premier serrage en utilisant le couple adéquat!
* avec la clé dynamométrique J5320.1030

Matériaux

Titane Grade 4			
Propriétés (ASTM F67)			
Composition chimique (en %)	O	≤	0.4
	Fe	≤	0.5
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	H	≤	0.015
	Ti		Reste
Propriétés mécaniques	Résistance	≥	550 MPa
	Allongement à la rupture	≥	12 %

Alliage de titane Ti6Al4V ELI			
Propriétés (ASTM F136)			
Composition chimique (en %)	Al		5.5 – 6.5
	V		3.5 – 4.5
	Fe	≤	0.25
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	O	≤	0.13
	H	≤	0.012
	Ti		Reste
Propriétés mécaniques	Résistance	≥	860 MPa
	Allongement à la rupture	≥	10 %

Alliage d'or pour technique de coulée Pilier or-plastique CONELOG®			
Propriétés			
Composition chimique (en %)	Au		60
	Pd		20
	Pt		19
	Ir		1
Propriétés physiques	Intervalle de fusion		1400 – 1490 °C
	Densité		17.5 g/cm³
	Module d'élasticité		136 GPa
	Coefficient de dilatation à la chaleur (25 – 500°C)		11.9 µm/m· °C
	Coefficient de dilatation à la chaleur (25 – 600°C)		12.2 µm/m· °C
	Couleur		blanc
Propriétés mécaniques			étiré
	Dureté HV5	>	215
	Résistance à la tension (Rm)	>	750 MPa
	Limite d'élasticité à 0.2 % (Rp 0.2%)	>	650 MPa
	Allongement à la rupture	>	2 %

Alliage d'or pour technique de coulée Base pour structure sur barre		
Propriétés		
Composition chimique (en %)	Au	60
	Pt	19
	Pd	20
	Ir	1
Propriétés physiques	Densité	17.5 g/cm³
	Couleur	blanc
	Liquidus	1490 °C
	Solidus	1400 °C
	Coefficient de dilatation à la chaleur (25 – 500°C)	12.5 µm/m· °C
	Coefficient de dilatation à la chaleur (25 – 600°C)	12.6 µm/m· °C
	Module d'élasticité	136 GPa
Propriétés mécaniques		durci 700 °C/30 min.
	Dureté HV5	210
	Limite d'élasticité à 0.2 %	450 – 570 MPa
	Allongement à la rupture	min. 10 %
	Résistance à la tension MPa	530 – 650

Alliage d'or pour technique de brasage Base pour structure sur barre		
Propriétés		
Composition chimique (en %)	Au	68.60
	Pt	2.45
	Ag	11.85
	Pd	3.95
	Cu	10.60
	Zn	2.50
	Ir	0.05
	Rh	-
	Ru	-
Propriétés physiques	Couleur	jaune
	Intervalle de fusion	880 – 940 °C
Propriétés mécaniques	**Dureté**	
	adouci par recuit HV5	175
	durci HV5	275
	auto-durci HV5	240

Index Alphabétique

A

Adaptateur de clé à cliquet 27

Adaptateur de démontage CAMLOG® et CONELOG® 23

Adaptateur manuel pour taraud 44

Adaptateur norme ISO 46

Aiguille de nettoyage 48

Analogue de laboratoire Locator® 74

Analogue de laboratoire pour barre, pour structures sur barre 68

Analogue de laboratoire pour modèles coulés 59

Analogue de pilier Locator R-Tx® 72, 73

Analogue de pilier pour ancrage sphérique 72

Analogue d'implant pour barre pour structures sur barre 68

Analogue d'implant pour modèles imprimés et coulés 59

Analogues Logfit® 66

Applicateur ALTApin 53

Attachement Locator® pour pilier barre 70

B

Bagues de protection Locator R-Tx®, blanche 73

Base de collage en titane pour structure sur barre 69

Base en titane CFAO 62

Bloc titane CFAO 64

Boîtier de retention Locator R-Tx® 73

Bone profiler 43

Brochure destinée aux patients 88

Butée de profondeur pour foret calibré PROGRESSIVE-LINE et SCREW-LINE 23, 37

Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote et pré-foret 43

C

Calques d'implant 1.25:1 Implants SCREW-LINE 16

Canule de nettoyage 48

Capuchon d'empreinte Locator® 74

Capuchon d'enregistrement de l'occlusion 59

Capuchon de repositionnement pour pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte fermé 58

Capuchons d'empreinte Locator R-Tx® 72

Carnet de rendez-vous 89

Clé à cardans 46

Clé dynamométrique 78

Clé universelle de contre-couple 47

Coiffe de cicatrisation pour pilier barre 68

Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre 68

Coiffe de scannage, pour pilier barre 68

Coiffe en titane pour pilier barre 68, 69

Coiffe en titane sans rétention pour pilier barre 69

Coiffe pour base de collage en titane 69

Coiffe pour couronne pour pilier barre 69

Coiffe pour structure sur barre 69

Coiffes de prise d'empreinte Logfit® 66

Coiffes en résine Logfit® 66

COMFOUR® Brochure destinée aux patients 88

D

Déconnecteur 81

DIM Analogue® 59

Distributeurs ALTApin 55

E

Embout pour instrument de pose Locator® 79

Espaceur blanc Locator® 75

F

Feuilles de conseils pour patients 88

Fixateur de membrane ALTApin 54

Foret à usage unique ALTApin, norme ISO 54

Foret calibré PROGRESSIVE-LINE 23

Foret calibré SCREW-LINE 37

Foret cortical SCREW-LINE os cortical 37

Foret de profil PROGRESSIVE-LINE Flex 27

Foret pilote 42

Foret pilote SCREW-LINE 42

Foret pointeur 42

Foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE 23

Foret pour mise en place du tube 17

Foret PROGRESSIVE-LINE Flex 27

Fraise à planer 43

Fraise boule 42

Fraise pour l'exposition de la vis de fermeture 43

G

Gaine de maintien pour implants 47

Grille radio, échelle 1.25:1 16
Grille radio, échelle 1.4:1 16
Implants PROGRESSIVE-LINE et SCREW-LINE

Guide tige de guidage pour bone profiler 43

I

Implant PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus 19

Implant SCREW-LINE, Promote® plus 33

Implant factice PROGRESSIVE-LINE 86

Implant factice SCREW-LINE 86

Insert de rétention à lamelles 71

I

Insert de rétention Locator® 75, 76

Insert de rétention Locator® pour angulation élargie 76

Insert de travail Locator® 75

Insert de travail Locator R-Tx® 73

Inserts de rétention Locator R-Tx® 73, 74

Instrument d'insertion 47

Instrument de pose d'implant, pour implants vissés 45

Instrument de pose, long, pour piliers barre droit 79

Instrument de pose pour inserts de retention Locator R-Tx® 80

Instrument de retouche de l'intrados, pour coiffes de barre 82

Instrument de vissage pour le système d'ancrage sphérique 78

Instrument de vissage pour Locator® 79

Instrument de vissage, pour structure sur barre 78

Instrument de vissage pour piliers de prise d'empreinte et coiffes de cicatrisation des structures sur barre 68, 79

Instrument Locator® 79

Instrument pick-up 46

J

Jauge de hauteur gingivale, droite 68

Jauge de parallélisme PROGRESSIVE-LINE 23

Jauge de positionnement 68

Jauge d'angulation Locator® 79

M

Macro modèle PROGRESSIVE-LINE 87

Macro modèle SCREW-LINE 87

Index Alphabétique

M

Maillet chirurgical ALTApin 54

Manche pour bloc titane CFAO, type IAC 64

Manche universel 82

Mandibule avec édentation complète 87

Matrice CM Dalbo®-Plus 71

Modèle de démonstration, Plexiglas 87

Modèle d'orientation pour COMFOUR® 68

O

Ostéotome SCREW-LINE 49, 50, 51, 52

P

Passeport d'implant 88

Patron pour la trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 22

Patron pour la trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 36

Pilier barre 67

Pilier d'enregistrement de l'occlusion 59

Pilier de parallélisme Locator® 79

Pilier de parallélisme SCREW-LINE 44

Pilier de prise d'empreinte 58

Pilier Locator® 74

Pilier Locator R-Tx® 72

Pilier or-plastique 65

Pilier provisoire 60

Pilier universel 65, 77

Piliers de cicatrisation 55

Piliers de numérisation pour scanbody Sirona® 63

Piliers Esthomic® 60, 61

P

Piliers Esthomic®, Inset 61

Piliers Logfit® 66

Piliers télescopiques 77

Pochette de présentation 88

Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin 54

Pointeau ALTApin 54

Poster 89

Pré-foret SCREW-LINE 42

Pré-ostéotome SCREW-LINE 49, 50, 51, 52

Prise en main pour analogue d'implant CAMLOG®/CONELOG® 81

Prolongateur pour foret pour instruments à irrigation interne 41

Prolongateur pour foret (pas pour foret à refroidissement interne) 44

Protection de polissage pour coiffes et bases pour pillier barre 69

S

Scanbody 63

Set ALTApin 53

Set chirurgical
CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 22
CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex 26
CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 36

Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 49, 50, 51, 52

Set de laboratoire Locator® 75

Set de laboratoire Locator® pour angulation élargie 75

Set de pilier pour ancrage sphérique, partie mâle 71

Set de piliers de sélection 83

Set prothétique 80

S

Support de modelage, pour base en titane CFAO 63

Support pour piliers 82

Système Guide douille de guidage 40

Système Guide douille de guidage PROGRESSIVE-LINE 32

Système Guide foret calibré 40

Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE 31, 32

Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE pour Ø 3,8 mm sous préparation 31

Système Guide foret calibré, SCREW-LINE, os cortical 39

Système Guide foret pilote PROGRESSIVE-LINE 30

Système Guide foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE 31

Système Guide instrument de pose 40

Système Guide instrument de pose PROGRESSIVE-LINE 32

Système Guide instrument de vissage, avec embout ISO pour contre angle 41

Système Guide instrument de vissage, manuel/clé dynamométrique 41

Système Guide pilier d'insertion 32, 40

Système Guide poinçon gingival 39

Système Guide poinçon gingival PROGRESSIVE-LINE 30

Système Guide pré-foret PROGRESSIVE-LINE 31

Système Guide set chirurgical, SCREW-LINE 39

Système Guide set de forets pilotes 38

Système Guide tige 41

Système Guide tige PROGRESSIVE-LINE 32

Système Guide trousse chirurgicale CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 30

T

Taraud PROGRESSIVE-LINE 23

Taraud SCREW-LINE 37

T

Tournevis 47, 48, 80, 81

Tournevis à main, hex 48, 81

Tournevis activateur 78

Trousse ALTApin 53

Trousse chirurgicale
CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 22
CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex 26
CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 36

Trousse chirurgicale et prothétique
CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 22
CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 36

Trousse prothétique 80

Trousse prothétique universelle 80

Tube pour guide chirurgical 17

V

Vis à tête étroite pour pilier, hex 70

Vis de fermeture pour implant 55

Vis de laboratoire à tête étroite, hex 70

Vis de laboratoire, pour base en titane CFAO 63

Vis de laboratoire prothétique, pour pilier barre 70

Vis de laboratoire, hex 77

Vis de pilier, pour base en titane CFAO 63

Vis de pilier, hex 77

Vis en plastique pour pilier barre 71

Vis prothétique, pour pilier barre 70

Vis, hex 70

Index Par numéro d'article

05003503	Matrice CM Dalbo®-Plus	71
05003504	Insert de rétention à lamelles	71
07000389	Tournevis activateur	78
08394	Embout pour instrument de pose Locator®	79
	Inserts de rétention Locator R-Tx®	
30001-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, gris	73
30002-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, bleu	73
30003-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, rose	73
30004-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, blanc	74
	Insert de travail Locator R-Tx®	
30012-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm	73
	Boîtier de retention Locator R-Tx®	
30013-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm	73
	Analogue de pilier Locator R-Tx®	
30014-01	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	72
30016-01	Ø 5.0 mm	73
	Capuchons d'empreinte Locator R-Tx®	
30017-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm	72
	Bagues de protection Locator R-Tx®	
30018-01	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm	73
30021-01	Instrument de pose pour inserts de retention Locator R-Tx®	80
	Pilier Locator R-Tx®	
30805-01	Ø 3.3 mm, HG 1.0 mm	72
30805-02	Ø 3.3 mm, HG 2.0 mm	72
30805-03	Ø 3.3 mm, HG 3.0 mm	72
30805-04	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	72
30806-01	Ø 3.8 mm, HG 1.0 mm	72
30806-02	Ø 3.8 mm, HG 2.0 mm	72
30806-03	Ø 3.8 mm, HG 3.0 mm	72
30806-04	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	72
30806-05	Ø 3.8 mm, HG 5.0 mm	72
30807-01	Ø 4.3 mm, HG 1.0 mm	72
30807-02	Ø 4.3 mm, HG 2.0 mm	72
30807-03	Ø 4.3 mm, HG 3.0 mm	72
30807-04	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	72
30807-05	Ø 4.3 mm, HG 5.0 mm	72
30808-01	Ø 5.0 mm, HG 1.0 mm	72
30808-02	Ø 5.0 mm, HG 2.0 mm	72
30808-03	Ø 5.0 mm, HG 3.0 mm	72
30808-04	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	72
30808-05	Ø 5.0 mm, HG 5.0 mm	72
A2002.2000	Tube pour guide chirurgical	17
	Foret pour mise en place du tube	
A2050.2600	Ø 2.6 mm	17
A2050.2800	Ø 2.8 mm	17
A2222.2200	Tube pour guide chirurgical	17
B1012	Foret pointeur	42
	Implant SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant vissé	
C1065.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	33
C1065.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	33
C1065.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	33
C1065.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	33
C1065.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	33
C1065.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	33
C1065.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	33
C1065.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	33
C1065.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	33
C1065.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	33
C1065.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	33
C1065.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	33
C1065.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	33
C1065.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	33
C1065.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	33
C1065.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	33
C1065.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	33
C1065.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	33
C1065.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	33
	Implant SCREW-LINE Promote® plus avec porte implant clipsé	
C1066.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	33
C1066.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	33
C1066.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	33
C1066.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	33
C1066.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	33
C1066.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	33
C1066.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	33
C1066.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	33
C1066.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	33
C1066.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	33
C1066.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	33
C1066.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	33
C1066.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	33
C1066.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	33
C1066.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	33
C1066.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	33
C1066.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	33
C1066.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	33
C1066.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	33
	Implant factice SCREW-LINE	
C1069.3813	Ø 3.8 mm	86
C1069.4313	Ø 4.3 mm	86
	Implant PROGRESSIVE-LINE Promote® plus avec porte implant vissé	
C1085.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	19
C1085.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	19
C1085.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	19
C1085.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	19
C1085.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	19
C1085.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	19

	Implant PROGRESSIVE-LINE Promote® plus avec porte implant vissé	
C1085.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	19
C1085.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	19
C1085.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	19
C1085.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	19
C1085.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	19
C1085.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	19
C1085.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	19
C1085.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	19
C1085.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	19
C1085.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	19
C1085.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	19
C1085.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	19
C1085.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	19
	Implant PROGRESSIVE-LINE Promote® plus avec porte implant clipsé	
C1086.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	19
C1086.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	19
C1086.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	19
C1086.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	19
C1086.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	19
C1086.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	19
C1086.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	19
C1086.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	19
C1086.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	19
C1086.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	19
C1086.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	19
C1086.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	19
C1086.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	19
C1086.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	19
C1086.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	19
C1086.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	19
C1086.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	19
C1086.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	19
C1086.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	19
	Implant factice PROGRESSIVE-LINE	
C1901.3813	Ø 3.8 mm	86
C1901.4313	Ø 4.3 mm	86
	Piliers de cicatrisation, bottleneck	
C2011.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2011.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	55
C2011.3860	Ø 3.8 mm, HG 6.0 mm	55
C2011.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2011.4360	Ø 4.3 mm, HG 6.0 mm	55
C2011.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	55
C2011.5060	Ø 5.0 mm, HG 6.0 mm	55
	Piliers de cicatrisation, évasés	
C2014.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2014.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	55
C2014.3860	Ø 3.8 mm, HG 6.0 mm	55
C2014.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2014.4360	Ø 4.3 mm, HG 6.0 mm	55
C2014.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	55
C2014.5060	Ø 5.0 mm, HG 6.0 mm	55
	Piliers de cicatrisation, cylindriques	
C2015.3320	Ø 3.3 mm, HG 2.0 mm	55
C2015.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2015.3820	Ø 3.8 mm, HG 2.0 mm	55
C2015.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	55
C2015.3860	Ø 3.8 mm, HG 6.0 mm	55
C2015.4320	Ø 4.3 mm, HG 2.0 mm	55
C2015.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	55
C2015.4360	Ø 4.3 mm, HG 6.0 mm	55
C2015.5020	Ø 5.0 mm, HG 2.0 mm	55
C2015.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	55
C2015.5060	Ø 5.0 mm, HG 6.0 mm	55
	Vis de fermeture pour implant	
C2019.3300	Ø 3.3 mm	55
C2019.3800	Ø 3.8 mm	55
C2019.4300	Ø 4.3 mm	55
C2019.5000	Ø 5.0 mm	55
	Système Guide pilier d'insertion	
C2026.3303	Ø 3.3 mm	32, 40
C2026.3803	Ø 3.8 mm	32, 40
C2026.4303	Ø 4.3 mm	32, 40
C2026.5003	Ø 5.0 mm	32
	Pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte fermé	
C2110.3300	Ø 3.3 mm	58
C2110.3800	Ø 3.8 mm	58
C2110.4300	Ø 4.3 mm	58
C2110.5000	Ø 5.0 mm	58
	Pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte ouvert	
C2121.3300	Ø 3.3 mm	58
C2121.3800	Ø 3.8 mm	58
C2121.4300	Ø 4.3 mm	58
C2121.5000	Ø 5.0 mm	58
	Pilier d'enregistrement de l'occlusion	
C2140.3300	Ø 3.3 mm	59
C2140.3800	Ø 3.8 mm	59
C2140.4300	Ø 4.3 mm	59
C2140.5000	Ø 5.0 mm	59
	Pilier universel	
C2211.3300	Ø 3.3 mm	65
C2211.3800	Ø 3.8 mm	65, 77
C2211.4300	Ø 4.3 mm	65, 77
C2211.5000	Ø 5.0 mm	65, 77
	Piliers télescopiques	
C2212.3800	Ø 3.8 mm	77
C2212.4300	Ø 4.3 mm	77
C2212.5000	Ø 5.0 mm	77
	Piliers Esthomic®, droits	
C2226.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2226.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60

Index Par numéro d'article

	Piliers Esthomic®, droits	
C2226.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2226.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60
C2226.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2226.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60
	Piliers Esthomic®, angulés à 15°, type A	
C2227.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2227.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60
C2227.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2227.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60
C2227.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	60
C2227.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	60
	Piliers Esthomic®, angulés à 15°, type B	
C2228.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2228.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2228.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2228.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2228.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2228.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
	Piliers Esthomic®, angulés à 20°, type A	
C2231.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2231.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2231.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2231.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2231.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2231.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
	Piliers Esthomic®, angulés à 20°, type B	
C2232.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2232.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2232.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2232.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
C2232.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 – 2.5 mm	61
C2232.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 – 4.5 mm	61
	Piliers Esthomic®, Inset	
C2235.3320	Ø 3.3 mm, HG 2.0 – 3.3 mm	61
C2235.3820	Ø 3.8 mm, HG 2.0 – 3.3 mm	61
C2235.4320	Ø 4.3 mm, HG 2.0 – 3.3 mm	61
C2235.5020	Ø 5.0 mm, HG 2.0 – 3.3 mm	61
	Pilier provisoire, pour couronne	
C2239.3300	Ø 3.3 mm	60
C2239.3800	Ø 3.8 mm	60
C2239.4300	Ø 4.3 mm	60
C2239.5000	Ø 5.0 mm	60
	Support de modelage CONELOG®, pour base en titane CFAO	
C2242.3302	Ø 3.3 mm	63
C2242.3802	Ø 3.8 mm	63
C2242.4302	Ø 4.3 mm	63
C2242.5002	Ø 5.0 mm	63
	Base en titane CFAO, couronne	
C2242.3308	Ø 3.3 mm, HG 0.8 mm	62
C2242.3320	Ø 3.3 mm, HG 2.0 mm	62
	Base en titane CFAO, couronne	
C2242.3808	Ø 3.8 mm, HG 0.8 mm	62
C2242.3820	Ø 3.8 mm, HG 2.0 mm	62
C2242.4308	Ø 4.3 mm, HG 0.8 mm	62
C2242.4320	Ø 4.3 mm, HG 2.0 mm	62
C2242.5008	Ø 5.0 mm, HG 0.8 mm	62
C2242.5020	Ø 5.0 mm, HG 2.0 mm	62
	Pilier or-plastique	
C2246.3300	Ø 3.3 mm	65
C2246.3800	Ø 3.8 mm	65
C2246.4300	Ø 4.3 mm	65
C2246.5000	Ø 5.0 mm	65
	Set de pilier pour ancrage sphérique, partie mâle	
C2249.3315	Ø 3.3 mm, HG 1.5 mm	71
C2249.3330	Ø 3.3 mm, HG 3.0 mm	71
C2249.3815	Ø 3.8 mm, HG 1.5 mm	71
C2249.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 mm	71
C2249.3845	Ø 3.8 mm, HG 4.5 mm	71
C2249.4315	Ø 4.3 mm, HG 1.5 mm	71
C2249.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 mm	71
C2249.4345	Ø 4.3 mm, HG 4.5 mm	71
C2249.5015	Ø 5.0 mm, HG 1.5 mm	71
C2249.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 mm	71
C2249.5045	Ø 5.0 mm, HG 4.5 mm	71
	Piliers Locator®	
C2253.3310	Ø 3.3 mm, HG 1.0 mm	74
C2253.3320	Ø 3.3 mm, HG 2.0 mm	74
C2253.3330	Ø 3.3 mm, HG 3.0 mm	74
C2253.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	74
C2253.3810	Ø 3.8 mm, HG 1.0 mm	74
C2253.3820	Ø 3.8 mm, HG 2.0 mm	74
C2253.3830	Ø 3.8 mm, HG 3.0 mm	74
C2253.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	74
C2253.3850	Ø 3.8 mm, HG 5.0 mm	74
C2253.4310	Ø 4.3 mm, HG 1.0 mm	74
C2253.4320	Ø 4.3 mm, HG 2.0 mm	74
C2253.4330	Ø 4.3 mm, HG 3.0 mm	74
C2253.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	74
C2253.4350	Ø 4.3 mm, HG 5.0 mm	74
C2253.5010	Ø 5.0 mm, HG 1.0 mm	74
C2253.5020	Ø 5.0 mm, HG 2.0 mm	74
C2253.5030	Ø 5.0 mm, HG 3.0 mm	74
C2253.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	74
C2253.5050	Ø 5.0 mm, HG 5.0 mm	74
	Pilier barre, droit	
C2254.3310	Ø 3.3 mm, HG 1.0 mm	67
C2254.3325	Ø 3.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2254.3810	Ø 3.8 mm, HG 1.0 mm	67
C2254.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	67
C2254.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	67
C2254.4310	Ø 4.3 mm, HG 1.0 mm	67
C2254.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2254.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2254.5010	Ø 5.0 mm, HG 1.0 mm	67
C2254.5025	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	67
C2254.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	67

	Pilier barre, angulé à 17°, type A	
C2256.3325	Ø 3.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2256.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2256.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	67
C2256.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	67
C2256.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2256.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2256.5025	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	67
C2256.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	67
	Pilier barre, angulé à 17°, type B	
C2257.3325	Ø 3.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2257.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2257.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	67
C2257.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	67
C2257.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2257.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2257.5025	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	67
C2257.5040	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	67
	Pilier barre, angulé à 30°, type A	
C2258.3325	Ø 3.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2258.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2258.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	67
C2258.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	67
C2258.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2258.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2258.5035	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	67
C2258.5050	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	67
	Pilier barre, angulé à 30°, type B	
C2259.3325	Ø 3.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2259.3340	Ø 3.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2259.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	67
C2259.3840	Ø 3.8 mm, HG 4.0 mm	67
C2259.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	67
C2259.4340	Ø 4.3 mm, HG 4.0 mm	67
C2259.5035	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	67
C2259.5050	Ø 5.0 mm, HG 4.0 mm	67
	Pilier provisoire, pour bridge	
C2339.3300	Ø 3.3 mm	60
C2339.3800	Ø 3.8 mm	60
C2339.4300	Ø 4.3 mm	60
C2339.5000	Ø 5.0 mm	60
	Base en titane CFAO, bridge	
C2342.3308	Ø 3.3 mm, HG 0.8 mm	62
C2342.3320	Ø 3.3 mm, HG 2.0 mm	62
C2342.3808	Ø 3.8 mm, HG 0.8 mm	62
C2342.3820	Ø 3.8 mm, HG 2.0 mm	62
C2342.4308	Ø 4.3 mm, HG 0.8 mm	62
C2342.4320	Ø 4.3 mm, HG 2.0 mm	62
C2342.5008	Ø 5.0 mm, HG 0.8 mm	62
C2342.5020	Ø 5.0 mm, HG 2.0 mm	62
	Bloc titane CFAO, type IAC	
C2411.3313	Ø 3.3 mm	64
C2411.4313	Ø 3.8/4.3 mm	64
C2411.5013	Ø 5.0 mm	64
	Bloc titane CFAO, type ME	
C2421.3320	Ø 3.3 mm	64
C2421.3820	Ø 3.8 mm	64
C2421.4320	Ø 4.3 mm	64
C2421.5020	Ø 5.0 mm	64
	Piliers Logfit®	
C2550.3810	Ø 3.8 mm, HG 1.0 mm	66
C2550.3825	Ø 3.8 mm, HG 2.5 mm	66
C2550.4310	Ø 4.3 mm, HG 1.0 mm	66
C2550.4325	Ø 4.3 mm, HG 2.5 mm	66
C2550.5010	Ø 5.0 mm, HG 1.0 mm	66
C2550.5025	Ø 5.0 mm, HG 2.5 mm	66
	Scanbody	
C2600.3310	Ø 3.3 mm	63
C2600.4310	Ø 3.8/4.3 mm	63
C2600.5010	Ø 5.0 mm	63
	Piliers de numérisation pour scanbody Sirona®	
C2620.3306	Ø 3.3 mm	63
C2620.3806	Ø 3.8 mm	63
C2620.4306	Ø 4.3 mm	63
C2620.5006	Ø 5.0 mm	63
	Analogue de laboratoire	
C3010.3300	Ø 3.3 mm	59
C3010.3800	Ø 3.8 mm	59
C3010.4300	Ø 4.3 mm	59
C3010.5000	Ø 5.0 mm	59
	DIM® Analogue pour le système d'implants	
C3012.3300	Ø 3.3 mm	59
C3012.4300	Ø 3.8/4.3 mm	59
C3012.5000	Ø 5.0 mm	59
	Analogue de pilier	
C3015.3300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	72
C3015.5000	Ø 5.0 mm	72
	Analogue d'implant	
C3025.3300	Ø 3.3 mm	59
C3025.3800	Ø 3.8 mm	59
C3025.4300	Ø 4.3 mm	59
C3025.5000	Ø 5.0 mm	59
C3709.0010	**Manche universel**	82
	Support pour piliers	
C3709.3300	Ø 3.3 mm	82
C3709.3800	Ø 3.8 mm	82
C3709.4300	Ø 4.3 mm	82
C3709.5000	Ø 5.0 mm	82
	Manche pour bloc titane CFAO, type IAC	
C3720.3300	Ø 3.3 mm	64
C3720.4300	Ø 3.8/4.3 mm	64
C3720.5000	Ø 5.0 mm	64

Index Par numéro d'article

	Vis de laboratoire à tête étroite, hex	
C4004.1600	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	70
C4004.2000	Ø 5.0 mm	70
	Vis à tête étroite pour pilier, hex	
C4004.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	70
C4004.2001	Ø 5.0 mm	70
	Vis de pilier, hex	
C4005.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	77
C4005.2001	Ø 5.0 mm	77
	Vis de laboratoire, hex	
C4006.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	77
C4006.2001	Ø 5.0 mm	77
	Vis de pilier, pour base en titane CFAO	
C4015.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	63
C4015.2001	Ø 5.0 mm	63
	Vis de laboratoire, pour base en titane CFAO	
C4016.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	63
C4016.2001	Ø 5.0 mm	63
	Guide tige de guidage pour bone profiler	
C5002.3300	Ø 3.3 mm	43
C5002.3800	Ø 3.8 mm	43
C5002.4300	Ø 4.3 mm	43
C5002.5000	Ø 5.0 mm	43
	Déconnecteur	
C5300.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, court	81
C5300.1603	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, long	81
C5300.2001	Ø 5.0 mm, court	81
C5300.2003	Ø 5.0 mm, long	81
C5300.9010	Grille radio, échelle 1.25:1	16
C5300.9011	Grille radio, échelle 1.4:1	16
	Implants SCREW-LINE	
C5300.9014	Grille radio, échelle 1.25:1	16
C5300.9015	Grille radio, échelle 1.4:1	16
	Implants PROGRESSIVE-LINE	
	Calques d'implant 1.25:1	
	Implants SCREW-LINE	
C5300.9080	Ø 3.3 mm	16
C5300.9081	Ø 3.8 mm	16
C5300.9082	Ø 4.3 mm	16
C5300.9083	Ø 5.0 mm	16
	Instrument d'insertion	
C5302.3310	Ø 3.3 mm, long	47
C5302.3311	Ø 3.3 mm, court	47
C5302.4310	Ø 3.8/4.3 mm, long	47
C5302.4311	Ø 3.8/4.3 mm, court	47
C5302.5011	Ø 5.0 mm, court	47
C8010.1010	Macro modèle SCREW-LINE	87
C8010.1400	Macro modèle PROGRESSIVE-LINE	87
C8011.1000	Set de piliers de sélection	83
	Modèle de démonstration, Plexiglas	
C8050.1040	mandibule	87
C8070.1020	maxillaire	87
	Coiffe de cicatrisation pour pilier barre	
J2029.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	68
J2029.6000	Ø 5.0 mm	68
	Capuchon de repositionnement pour pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte fermé	
J2111.3300	Ø 3.3 mm	58
J2111.3800	Ø 3.8 mm	58
J2111.4300	Ø 4.3 mm	58
J2111.5000	Ø 5.0 mm	58
	Capuchon d'enregistrement de l'occlusion	
J2112.3300	Ø 3.3 mm	59
J2112.3800	Ø 3.8 mm	59
J2112.4300	Ø 4.3 mm	59
J2112.5000	Ø 5.0 mm	59
	Coiffe de prise d'empreinte pour pilier barre, porte-empreinte fermé (bridges/barre)	
J2129.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, court	68
J2129.4310	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, long	68
J2129.6000	Ø 5.0 mm, court	68
J2129.6010	Ø 5.0/6.0 mm, long	68
J2253.0001	Instrument de vissage pour Locator®	79
J2253.0002	Instrument Locator®	79
J2253.0003	Jauge d'angulation Locator®	79
J2253.0004	Pilier de parallélisme Locator®	79
J2253.0102	Set de laboratoire Locator®	75
J2253.0112	Set de laboratoire Locator® pour angulation élargie	75
J2253.0200	Capuchon d'empreinte Locator®	74
J2253.0340	Analogue de laboratoire Locator®	74
J2253.0401	Espaceur blanc Locator®	75
J2253.0402	Insert de travail Locator®	75
	Insert de rétention Locator®	
J2253.1002	bleu	76
J2253.1003	rose	76
J2253.1005	transparent	75

	Insert de rétention Locator® pour angulation élargie	
J2253.2000	Ø 3.8/4.3/5.0 mm, gris	76
J2253.2002	Ø 3.8/4.3/5.0 mm, rouge	76
J2253.2003	Ø 3.8/4.3/5.0 mm, orange	76
J2253.2004	Ø 3.8/4.3/5.0 mm, vert	76
	Attachement Locator® pour pilier barre	
J2253.4301	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	70
J2253.6001	Ø 5.0 mm	70
	Coiffe pour couronne pour pilier barre	
J2256.4306	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2256.6006	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe pour structure sur barre, calcinable	
J2257.4301	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2257.6001	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe pour structure sur barre, soudable	
J2258.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2258.6000	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe en titane pour pilier barre	
J2259.4301	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, pour couronne	68
J2259.4302	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, pour bridge	69
J2259.6001	Ø 5.0 mm, pour couronne	68
J2259.6002	Ø 5.0 mm, pour bridge	69
	Coiffe en titane sans rétention pour pilier barre, pour bridge	
J2259.4322	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2259.6022	Ø 5.0 mm	69
	Base de collage en titane pour structure sur barre	
J2260.4301	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2260.6001	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe pour base de collage en titane	
J2261.4301	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2261.6001	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe pour structure sur barre, soudable au laser	
J2262.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2262.6000	Ø 5.0 mm	69
	Coiffe pour structure sur barre, calcinable	
J2263.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J2263.6000	Ø 5.0 mm	69
J2269.0003	Jauge de positionnement à 17°	68
J2269.0004	Jauge de positionnement à 30°	68
J2269.0005	Jauge de positionnement à 17°	68
J2269.0006	Jauge de positionnement à 30°	68
	Coiffes de prise d'empreinte Logfit®	
J2551.4300	Ø 3.8/4.3 mm	66
J2551.6000	Ø 5.0 mm	66
	Analogues Logfit®	
J2552.4300	Ø 3.8/4.3 mm	66
J2552.6000	Ø 5.0 mm	66
	Coiffes en résine Logfit®	
J2553.4301	Ø 3.8/4.3 mm, pour bridges	66
J2553.4302	Ø 3.8/4.3 mm, pour couronnes	66
J2553.6001	Ø 5.0 mm, pour bridges	66
J2553.6002	Ø 5.0 mm, pour couronnes	66
	Coiffe de scannage, pour pilier barre	
J2610.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	68
J2610.6000	Ø 5.0 mm	68
	Analogue de laboratoire pour barre, pour structures sur barre	
J3020.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	68
J3020.6000	Ø 5.0 mm	68
	Protection de polissage pour coiffes et bases pour pillier barre	
J3021.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	69
J3021.6000	Ø 5.0 mm	69
	Prise en main pour analogue d'implant CAMLOG®/CONELOG®	
J3025.0010	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	81
J3025.0015	Ø 5.0 mm	81
	Analogue d'implant pour barre pour structures sur barre	
J3025.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	68
J3025.6000	Ø 5.0 mm	68
	Jauge de hauteur gingivale, droite	
J3550.3300	Ø 3.3 mm	68
J3550.3800	Ø 3.8 mm	68
J3550.4300	Ø 4.3 mm	68
J3550.5000	Ø 5.0 mm	68
J3551.0001	Modèle d'orientation pour COMFOUR®	68
J3709.0015	Manche universel	82
	Instrument de retouche de l'intrados, pour coiffes de barre	
J3711.0010	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, planes/cônes	82
J3711.0015	Ø 5.0 mm, planes/cônes	82
J3711.0020	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, siège de vis	82
J3711.0025	Ø 5.0 mm, siège de vis	82
	Système Guide instrument de pose	
J3716.3300	Ø 3.3 mm	40
J3716.4300	Ø 3.8/4.3 mm	40
	Système Guide instrument de pose PROGRESSIVE-LINE	
J3717.3300	Ø 3.3 mm	32
J3717.4300	Ø 3.8/4.3 mm	32
J3717.5000	Ø 5.0 mm	32

Index Par numéro d'article

	Système Guide foret calibré	
J3733.3300	Ø 3.3 mm	40
J3733.4300	Ø 3.8/4.3 mm	40
	Système Guide douille de guidage	
J3734.3303	Ø 3.3 mm	40
J3734.3803	Ø 3.8 mm	40
J3734.4303	Ø 4.3 mm	40
	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE	
J3753.3300	Ø 3.3 mm	32
J3753.4300	Ø 3.8/4.3 mm	32
J3753.5000	Ø 5.0 mm	32
	Système Guide douille de guidage PROGRESSIVE-LINE	
J3754.3301	Ø 3.3 mm	32
J3754.3801	Ø 3.8 mm	32
J3754.4301	Ø 4.3 mm	32
J3754.5001	Ø 5.0 mm	32
	Vis en plastique pour pilier barre	
J4009.1627	M 1.6	71
J4009.2027	M 2.0	71
	Vis prothétique, pour pilier barre	
J4012.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	70
J4012.2001	Ø 5.0 mm	70
	Vis, hex	
J4012.1610	L 10 mm, M 1.6	70
J4012.1615	L 15 mm, M 1.6	70
J4012.1620	L 20 mm, M 1.6	70
J4012.2010	L 10 mm, M 2.0	70
J4012.2015	L 15 mm, M 2.0	70
J4012.2020	L 20 mm, M 2.0	70
	Vis de laboratoire prothétique, pour pilier barre	
J4013.1601	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	70
J4013.2001	Ø 5.0 mm	70
J5002.0005	Prolongateur pour foret norme ISO pour instruments à irrigation interne	41
J5002.0006	pas pour foret à refroidissement interne	44
J5002.0011	Adaptateur norme ISO	46
J5002.0012	Aiguille de nettoyage	48
J5002.0013	Adaptateur de clé à cliquet	27
J5002.0020	Canule de nettoyage	48
	Bone profiler	
J5003.3350	Ø 3.3 mm	43
J5003.4360	Ø 3.8/4.3 mm	43
J5003.5070	Ø 5.0 mm	43
	Fraise pour l'exposition de la vis de fermeture	
J5004.3300	Ø 3.3 mm	43
J5004.3800	Ø 3.8 mm	43
J5004.4300	Ø 4.3 mm	43
J5004.5000	Ø 5.0 mm	43
	Fraise à planer	
J5006.3346	Ø 3.3 mm, Ø 4.6 mm	43
J5006.3852	Ø 3.8 mm, Ø 5.2 mm	43
J5006.4356	Ø 4.3 mm, Ø 5.6 mm	43
J5006.5063	Ø 5.0 mm, Ø 6.3 mm	43
	Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote et pré-foret	
J5015.0007	L 7 mm	43
J5015.0009	L 9 mm	43
J5015.0011	L 11 mm	43
J5015.0013	L 13 mm	43
	Butée de profondeur pour foret calibré PROGRESSIVE-LINE et SCREW-LINE	
J5015.3300	Ø 3.3 mm	23, 37
J5015.3800	Ø 3.8 mm	23, 37
J5015.4300	Ø 4.3 mm	23, 37
J5015.5000	Ø 5.0 mm	23, 37
	Système Guide poinçon gingival	
J5041.3303	Ø 3.3 mm, SCREW-LINE	39
J5041.3304	Ø 3.3 mm, PROGRESSIVE-LINE	30
J5041.3803	Ø 3.8 mm, SCREW-LINE	39
J5041.3804	Ø 3.8 mm, PROGRESSIVE-LINE	30
J5041.4303	Ø 4.3 mm, SCREW-LINE	39
J5041.4304	Ø 4.3 mm, PROGRESSIVE-LINE	30
J5041.5004	Ø 5.0 mm, PROGRESSIVE-LINE	30
J5050.2300	Fraise boule	42
J5051.2000	Foret pilote SCREW-LINE	42
J5051.2003	Foret pilote	42
J5051.2800	Pré-foret SCREW-LINE	42
	Foret cortical SCREW-LINE os cortical	
J5053.3316	Ø 3.3 mm	37
J5053.3816	Ø 3.8 mm	37
J5053.4316	Ø 4.3 mm	37
J5053.5016	Ø 5.0 mm	37
	Taraud SCREW-LINE	
J5054.3309	Ø 3.3 mm	37
J5054.3809	Ø 3.8 mm	37
J5054.4309	Ø 4.3 mm	37
J5054.5009	Ø 5.0 mm	37
	Foret calibré SCREW-LINE	
J5062.3309	Ø 3.3 mm, L 9	37
J5062.3311	Ø 3.3 mm, L 11	37
J5062.3313	Ø 3.3 mm, L 13	37

	Foret calibré SCREW-LINE	
J5062.3316	Ø 3.3 mm, L 16	37
J5062.3807	Ø 3.8 mm, L 7	37
J5062.3809	Ø 3.8 mm, L 9	37
J5062.3811	Ø 3.8 mm, L 11	37
J5062.3813	Ø 3.8 mm, L 13	37
J5062.3816	Ø 3.8 mm, L 16	37
J5062.4307	Ø 4.3 mm, L 7	37
J5062.4309	Ø 4.3 mm, L 9	37
J5062.4311	Ø 4.3 mm, L 11	37
J5062.4313	Ø 4.3 mm, L 13	37
J5062.4316	Ø 4.3 mm, L 16	37
J5062.5007	Ø 5.0 mm, L 7	37
J5062.5009	Ø 5.0 mm, L 9	37
J5062.5011	Ø 5.0 mm, L 11	37
J5062.5013	Ø 5.0 mm, L 13	37
J5062.5016	Ø 5.0 mm, L 16	37
	Système Guide set de forets pilotes	
J5063.3309	Ø 3.3 mm, L 5/9 mm	38
J5063.3311	Ø 3.3 mm, L 5/9/11 mm	38
J5063.3313	Ø 3.3 mm, L 5/9/13 mm	38
J5063.4307	Ø 3.8/4.3 mm, L 5/7 mm	38
J5063.4309	Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9 mm	38
J5063.4311	Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9/11 mm	38
J5063.4313	Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9/11/13 mm	38
J5064.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	38
J5064.4316	Ø 3.8/4.3 mm, L 16 mm	38
	Système Guide set chirurgical, SCREW-LINE	
J5065.3309	Ø 3.3 mm, L 5/9 mm	39
J5065.3311	Ø 3.3 mm, L 5/9/11 mm	39
J5065.3313	Ø 3.3 mm, L 5/9/11/13 mm	39
J5065.3807	Ø 3.8 mm, L 5/7 mm	39
J5065.3809	Ø 3.8 mm, L 5/9 mm	39
J5065.3811	Ø 3.8 mm, L 5/9/11 mm	39
J5065.3813	Ø 3.8 mm, L 5/9/11/13 mm	39
J5065.4307	Ø 4.3 mm, L 5/7 mm	39
J5065.4309	Ø 4.3 mm, L 5/9 mm	39
J5065.4311	Ø 4.3 mm, L 5/9/11 mm	39
J5065.4313	Ø 4.3 mm, L 5/9/11/13 mm	39
J5066.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	39
J5066.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	39
J5066.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	39
	Système Guide foret calibré, SCREW-LINE, os cortical	
J5068.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	39
J5068.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	39
J5068.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	39
J5068.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	39
J5068.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	39
J5068.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	39
J5068.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	39
J5068.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	39
J5068.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	39
J5068.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	39
J5068.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	39
J5068.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	39
J5068.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	39
J5068.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	39
	Foret calibré PROGRESSIVE-LINE	
J5070.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	23
J5070.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	23
J5070.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	23
J5070.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	23
J5070.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	23
J5070.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	23
J5070.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	23
J5070.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	23
J5070.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	23
J5070.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	23
J5070.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	23
J5070.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	23
J5070.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	23
J5070.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	23
J5070.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	23
J5070.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	23
J5070.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	23
J5070.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	23
J5070.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	23
	Taraud PROGRESSIVE-LINE	
J5071.3300	Ø 3.3 mm	23
J5071.3800	Ø 3.8 mm	23
J5071.4300	Ø 4.3 mm	23
J5071.5000	Ø 5.0 mm	23
	Foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE	
J5072.3300	Ø 3.3 mm	23
J5072.3800	Ø 3.8 mm	23
J5072.4300	Ø 4.3 mm	23
J5072.5000	Ø 5.0 mm	23
	Système Guide foret pilote PROGRESSIVE-LINE	
J5074.3305	Ø 3.3 mm, L 5 mm	30
J5074.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	30
J5074.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	30
J5074.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	30
J5074.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	30
J5074.4305	Ø 3.8/4.3 mm, L 5 mm	30
J5074.4307	Ø 3.8/4.3 mm, L 7 mm	30
J5074.4309	Ø 3.8/4.3 mm, L 9 mm	30
J5074.4311	Ø 3.8/4.3 mm, L 11 mm	30
J5074.4313	Ø 3.8/4.3 mm, L 13 mm	30
J5074.4316	Ø 3.8/4.3 mm, L 16 mm	30
J5074.5005	Ø 5.0 mm, L 5 mm	30
J5074.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	30
J5074.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	30
J5074.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	30
J5074.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	30
J5074.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	30
	Système Guide pré-foret PROGRESSIVE-LINE	
J5076.3305	Ø 3.3 mm	31
J5076.3805	Ø 3.8 mm	31
J5076.4305	Ø 4.3 mm	31
J5076.5005	Ø 5.0 mm	31

Index Par numéro d'article

	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE	
J5076.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	31
J5076.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	31
J5076.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	31
J5076.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	31
J5076.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	31
J5076.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	31
J5076.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	31
J5076.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	31
J5076.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	31
J5076.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	31
J5076.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	31
J5076.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	31
J5076.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	31
J5076.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	31
J5076.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	31
J5076.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	31
J5076.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	31
J5076.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	31
J5076.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	31
	Système Guide foret calibré PROGRESSIVE-LINE pour Ø 3,8 mm sous préparation	
J5077.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	31
J5077.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	31
J5077.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	31
J5077.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	31
	Système Guide foret pour os dense PROGRESSIVE-LINE	
J5078.3309	Ø 3.3 mm, L 9 mm	31
J5078.3311	Ø 3.3 mm, L 11 mm	31
J5078.3313	Ø 3.3 mm, L 13 mm	31
J5078.3316	Ø 3.3 mm, L 16 mm	31
J5078.3807	Ø 3.8 mm, L 7 mm	31
J5078.3809	Ø 3.8 mm, L 9 mm	31
J5078.3811	Ø 3.8 mm, L 11 mm	31
J5078.3813	Ø 3.8 mm, L 13 mm	31
J5078.3816	Ø 3.8 mm, L 16 mm	31
J5078.4307	Ø 4.3 mm, L 7 mm	31
J5078.4309	Ø 4.3 mm, L 9 mm	31
J5078.4311	Ø 4.3 mm, L 11 mm	31
J5078.4313	Ø 4.3 mm, L 13 mm	31
J5078.4316	Ø 4.3 mm, L 16 mm	31
J5078.5007	Ø 5.0 mm, L 7 mm	31
J5078.5009	Ø 5.0 mm, L 9 mm	31
J5078.5011	Ø 5.0 mm, L 11 mm	31
J5078.5013	Ø 5.0 mm, L 13 mm	31
J5078.5016	Ø 5.0 mm, L 16 mm	31
	Foret PROGRESSIVE-LINE Flex	
J5079.3300	Ø 3.3 mm	27
J5079.3800	Ø 3.8 mm	27
J5079.4300	Ø 4.3 mm	27
J5079.5000	Ø 5.0 mm	27
	Foret de profil PROGRESSIVE-LINE Flex	
J5080.3300	Ø 3.3 mm	27
	Foret de profil PROGRESSIVE-LINE Flex	
J5080.3800	Ø 3.8 mm	27
J5080.4300	Ø 4.3 mm	27
J5080.5000	Ø 5.0 mm	27
J5300.0011	Instrument de vissage pour le système d'ancrage sphérique, manuel/clé dynamométrique	78
	Instrument de vissage, pour structure sur barre	
J5300.0020	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, court	78
J5300.0021	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, long	79
J5300.0025	Ø 5.0 mm, court	78
	Adaptateur de démontage pour CAMLOG® et CONELOG®	
J5300.0022	Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm	23
	Instrument de vissage pour piliers de prise d'empreinte et coiffes de cicatrisation des structures sur barre	
J5300.0027	Ø 3.3/3.8/4.3 mm	68, 79
J5300.0028	Ø 5.0 mm	68, 79
J5300.0030	Instrument pick-up	46
	Instrument de pose d'implant manuel/clé dynamométrique	
J5300.0031	extra court	45
J5300.0032	court	45
J5300.0033	long	45
	avec embout ISO pour contre-angle	
J5300.0034	court	45
J5300.0035	long	45
	Instrument de pose d'implant avec embout ISO pour contre-angle	
J5300.0036	court	45
J5300.0037	long	45
J5300.0038	Clé à cardans	46
	Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG®	
J5300.0063	SCREW-LINE	36
J5300.0065	PROGRESSIVE-LINE	22
J5300.0071	PROGRESSIVE-LINE Flex	26
	Patron pour la trousse chirurgicale et prothétique CAMLOG®/CONELOG®	
J5300.1068	SCREW-LINE	36
J5300.1070	PROGRESSIVE-LINE	22
	Jauge de parallélisme	
J5300.2000	PROGRESSIVE-LINE	23
	Pilier de parallélisme	
J5300.2028	SCREW-LINE	44

	Trousse chirurgical (sans contenu) CAMLOG®/CONELOG®	
J5300.8916	SCREW-LINE	36
J5300.8917	PROGRESSIVE-LINE	22
J5300.8920	PROGRESSIVE-LINE Flex	26
	Système Guide trousse chirurgicale (sans contenu) CAMLOG®/CONELOG®	
J5300.8919	PROGRESSIVE-LINE	30
	Trousse chirurgicale et prothétique (sans contenu) CAMLOG®/CONELOG®	
J5300.8968	SCREW-LINE	36
J5300.8970	PROGRESSIVE-LINE	22
	Système Guide tige	
J5301.3300	Ø 3.3 mm, SCREW-LINE	41
J5301.3310	Ø 3.3 mm, PROGRESSIVE-LINE	32
J5301.4300	Ø 3.8/4.3 mm, SCREW-LINE	41
J5301.4310	Ø 3.8/4.3 mm, PROGRESSIVE-LINE	32
J5301.5010	Ø 5.0 mm, PROGRESSIVE-LINE	32
J5302.0010	Clé universelle de contre-couple	47
	Gaine de maintien pour implants	
J5302.3300	Ø 3.3 mm	47
J5302.3800	Ø 3.8 mm	47
J5302.4300	Ø 4.3 mm	47
J5302.5000	Ø 5.0 mm	47
	Système Guide instrument de vissage	
J5303.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, manuel/clé dynamométrique	41
J5304.4300	Ø 3.3/3.8/4.3 mm, avec embout ISO	41
	Tournevis, hex	
J5317.0501	court, manuel/clé dynamométrique	47, 80
J5317.0502	long, manuel/clé dynamométrique	47, 81
J5317.0503	long, avec embout ISO	48, 81
J5317.0504	court, avec embout ISO	48, 81
J5317.0510	extra court, manuel/clé dynamométrique	47, 80
J5317.0511	Tournevis à main, hex	48, 81
J5320.1030	Clé dynamométrique	78
	Adaptateur manuel pour taraud,	
J5322.0010	court	44
J5322.0011	long	44
J5330.8500	Trousse prothétique	80
J5330.8600	Set prothétique	80
J5330.8700	Trousse prothétique universelle	80
	Pré-ostéotome SCREW-LINE	
J5417.2800	1.7 – 2.8 mm, droit-convexe	49, 50
	Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE,	
J5418.0020	droit-convexe	49
J5418.0030	angulé-convexe	50
	Ostéotome SCREW-LINE	
J5418.3300	Ø 3.3 mm, droit-convexe	49
J5418.3310	Ø 3.3 mm, angulé-convexe	50
J5418.3800	Ø 3.8 mm, droit-convexe	49
J5418.3810	Ø 3.8 mm, angulé-convexe	50
J5418.4300	Ø 4.3 mm, droit-convexe	49
J5418.4310	Ø 4.3 mm, angulé-convexe	50
J5418.5000	Ø 5.0 mm, droit-convexe	49
J5418.5010	Ø 5.0 mm, angulé-convexe	50
	Pré-ostéotome SCREW-LINE	
J5419.2800	1.7 – 2.8 mm, droit-concave	51, 52
	Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE,	
J5420.0020	droit-concave	51
J5420.0030	angulé-concave	52
	Ostéotome SCREW-LINE	
J5420.3300	Ø 3.3 mm, droit-concave	51
J5420.3310	Ø 3.3 mm, angulé-concave	52
J5420.3800	Ø 3.8 mm, droit-concave	51
J5420.3810	Ø 3.8 mm, angulé-concave	52
J5420.4300	Ø 4.3 mm, droit-concave	51
J5420.4310	Ø 4.3 mm, angulé-concave	52
J5420.5000	Ø 5.0 mm, droit-concave	51
J5420.5010	Ø 5.0 mm, angulé-concave	52
J8070.2050	Mandibule avec édentation complète	87
M1000.0050	Distributeurs ALTApin, 1 pièce	55
M1000.0100	Distributeurs ALTApin, 3 pièces	55
M5100.0010	Applicateur ALTApin, droit	53
M5100.0030	Applicateur ALTApin, angulé 90°	53
M5100.0050	Pointeau ALTApin	54
M5100.0070	Fixateur de membrane ALTApin	54
M5100.0100	Maillet chirurgical ALTApin	54
M5200.0010	Applicateur ALTApin, droit, partie travaillante	53
M5200.0055	Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin	54
M5500.0050	Foret à usage unique ALTApin, norme ISO	54
M5600.0110	Set ALTApin	53
M5600.0210	Trousse ALTApin	53

Documentation complémentaire

Des renseignements complémentaires sur les Produits CONELOG®
sont disponibles dans les Documentations suivantes :

- Catalogue produits CONELOG®
- Modes d'emploi CONELOG®
- Notices d'utilisation CONELOG®
- Consignes de préparation
- Camlog literature overview
- Camlog and science

Ces documents sont disponibles auprès du représentant Camlog de votre pays.

Consultez également :
https://ifu.camlog.com
www.camlog.com

Référence

[1] Conserva E. Initial stability after placement of a new buttress threaded implant. A case series study. implants. 2019(3): 24-28.
[2] Ruppin J. One-year clinical experience with Progressive-Line implants. EDI journal. 2020(4): 54-63.
[3] Semper-Hogg W, Kraft S, Stiller S, Mehrhof J, Nelson K. Analytical and experimental position stability of the abutment in different dental implant systems with a conical implant-abutment connection. Clin Oral Investig 2010;17(3): 1017-23.
[4] Semper Hogg W, Zulauf K, Mehrhof J, Nelson K. The influence of torque tightening on the position stability of the abutment in conical implant-abutment connections. Int J Prosthodont 2015;28: 538-41.

Noms de marque et copyright

Les noms de marque (marques déposées) ne sont pas spécialement indiqués. L'absence d'une telle indication ne permet PAS de conclure qu'il s'agit d'une marque non protégée. Ce document, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Vous pouvez télécharger le contenu relatif à un usage conforme, mais toute modification ou reproduction du contenu sont interdites. Toute exploitation en dehors des limites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord préalable écrit de CAMLOG Biotechnologies GmbH et est soumise à des sanctions légales.

CE 0123

N° d'article J8001.0010 Rev. 07 07/2021

+E219J800100101B

+$007011310 9BR

Headquarters
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Suisse
Teléphone +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com

Fabricant des produits CAMLOG® / CONELOG® : ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Allemagne

biohorizons camlog